

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 10 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

14.10.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **16.10.2019** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetlenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **16.10.2019** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun K. RAHAN
Mali Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	MİKROBİYOLOJİ.BESİ YERİ / EMB AGAR	200	ADET				
2	MİKROBİYOLOJİ.BESİ YERİ / KOYUN KANLI AGAR	300	ADET				
3	MİKROBİYOLOJİ.BESİ YERİ / MÜLLER HİNTON AGAR	350	ADET				
4	PEDİATRİK JELLİ TÜP PEDİATRİK	300	ADET				
5	PEDİATRİK EDTALİ TÜP PEDİATRİK	200	ADET				
6	MEZÜR 500 ML.	2	ADET				
7	MEZÜR 1000 ML.	2	ADET				
8	EA-50 PAPNICOLAOU	6	LİTRE				
9	BORİK ASİT TOZ	1	KG				
10	HARRİS HEMOTOKSİLEN HAZIR BOYA	6	LİTRE				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAMESİ

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdlh.saglik.gov.tr/tr/bicn/ali/030>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA


TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

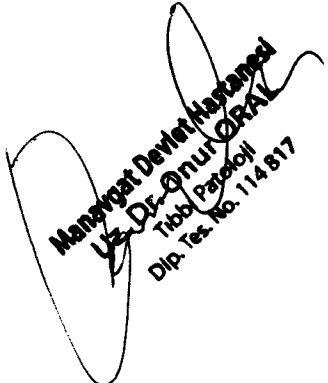
KULLANIMA HAZIR BESİYERLERİ(Koyun Kanlı Agar, EMB Agar. Mueller Hinton Agar) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Besiyerleri kurumayı ve transport sırasında kontaminasyonu önleyecek şekilde steril edilmiş ambalajlarda bulunmalıdır.
2. Besiyerlerinin kalınlığı kurumayı önleyecek şekilde en az 4 mm kalınlıkta olmalıdır.
3. Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş olduğu UBB kaydı olmalıdır.
4. Besiyerleri dehidratasyonu ve kontaminasyonu önleyecek şekilde 10'luk steril ambalaj içinde olmalıdır.
5. Her ambalajın üzerinde besiyerlerinin üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası, besiyerinin adı ve içeriği yazmalıdır.
6. Besiyerlerinin miadı +2 ile +4 C'de en az 2 ay olmalıdır.
7. Firma, ambalajın içinde son kullanma tarihinden önce kontamine olduğu veya bozulduğu takdirde yeniden ücretsiz besiyeri vereceğini taahhüt etmelidir.
8. Malzeme teslimatında besiyerlerinde kuruma, kontaminasyon ve buhar birikimi olmamalıdır.
9. Üretici firma besiyeri üretimindeki her lot numarası için kalite kontrol sertifikası sunabilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Dzm.Dr. Mediha COŞAR
Dip.T. No:79133
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.


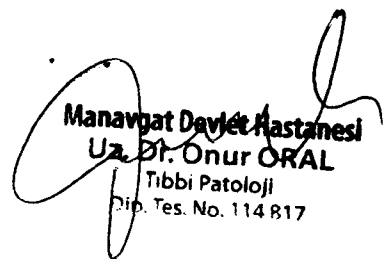
HARRİS HEMATOKSİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Patoloji labaratuvarlarında patolojik preparatların nükleer detayının boyanması için kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Orjinal rengine sıvı halde ve tortusuz olacaktır.
- 3.Kullanıma hazır formda olacaktır.
- 4.Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.
- 5.Analiz sertifikasıyla teslim edilmelidir, sorunsuz boyama özelliğinde olmalı, son kullanım tarihi üzerinde olmalıdır.


Mamışat Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Onur ÖZALP
Tıbbi Patoloji
Dip. Tez. No: 114 817

EA 50(AZUR. EOZİN.50) PAPNICOLAOU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Polychromatic azur eozin 50 solüsyonu özellikte olmalıdır.
- 2.Papanicolau yönteminde kullanılabilmelidir.
- 3.Sıvı ve solüsyon halinde özellikli olmalıdır.
- 4.Cam veya plastik şişe ambalajlarda olmalıdır.
- 5.Oda ısısında saklanabilmeli ve uzun miadlı olmalıdır.
- 6.Alkolle birlikte kullanılabilmelidir.Dehidratasyon aşamalarında da boya solmamalıdır.
- 7.Kimyasal içerikleri (specification) özelliklerinin ve solüsyonlarının içeriklerini,oranlarını detaylı olarak göstermelidir.
- 8.Hücre boyamalarında intermedial ve parabazal hücrelerden stoplazma mavi,yeşil,süperfisial hücreler ve stoplazma penbe renkte yeterli kontrasta boyanmalıdır.


Manavgat Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Onur ORAL
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No. 114 817

ÖLÇEKLİ CAM KAPLAR (MEZÜR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEZÜR (500ML)

1. Borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.
2. A kalite standartlarına uygun olmalıdır.
3. Conformity grup sertifikasına sahip olmalıdır.
4. Hekzagonal cam tabanlı olmalıdır.
5. 500ml hacimli olmalıdır.
6. Uzun formlu olmalıdır.
7. Üzerinde ayrıntılı olarak dereceler çizgilerle belirtilmelidir.

MEZÜR (1000ML)

1. Borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.
2. A kalite standartlarına uygun olmalıdır.
3. Conformity grup sertifikasına sahip olmalıdır.
4. Hekzagonal cam tabanlı olmalıdır.
5. 1000ml hacimli olmalıdır.
6. Uzun formlu olmalıdır.
7. Üzerinde ayrıntılı olarak dereceler çizgilerle belirtilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi

UZ. Dr. Onur ORAL

Tıbbi Patoloji

Dip. Tes. No. 114 817

PEDİATRİK EDTALİ TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 0,5 ml kan alabilmelidir.
- Tüpler Polietilen Teraftalat (PET) malzemeden imal edilmiş ve santrifüje dayanıklı olmalıdır.
- Tüpler antikoagülan olarak EDTA içermeli ve bu antikoagülan, kanı dilüe etmemek için kuru sprey formda, tüplerin iç yüzeyine kaplı halde olmalıdır.
- Kapaklar mor veya pembe renkli olmalıdır.
- Tüplerin üzerinde etiket olmalıdır.
- Tüplerin üzerindeki etikette sterilite işareti, son kullanma tarihi ile lot numarası olmalıdır.
- Tüpleri her ambalaj paketlerinde; sterilite işareti, kod-lot numarası ve miadı, üretici firma adı ve adresi, şematik kısa kan alma klavuzunu da içeren bir etiket olmalıdır.
- Laboratuarda standardizasyon sağlanması, tüpün geri kaçması, iğnenin holder'dan çıkması, v.b gibi kullanım sırasında oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla Tüpler her marka kan alma iğnesi ve holder ile uyumlu olmalı, kan alma sırasında oluşabilecek olumsuzluklara neden olmamalıdır. Tüm malzemeler en az 1 yıl miadlı olmalıdır, malzemeler laboratuvarın isteğine göre parti parti teslim edilmelidir. Özelliği gereğince ambalajı açıldığında bozuk olduğu anlaşılabilecek malzemeler firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir. Sözleşme süresi içerisinde gerektiğinde firma tarafından daha uzun miadlılar ile değiştirilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Fatma ÖZKAN
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı
Dip Tes. No.: 136476 / 103970

PEDİATRİK JELLİ TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 0,5 ml kan alabilmelidir.
- Tüpler Polietilen Teraftalat (PET) malzemeden imal edilmiş ve santrifüje dayanıklı olmalıdır.
- Kapaklar mor veya pembe renkli olmalıdır.
- Tüplerin üzerinde etiket olmalıdır.
- Tüplerin üzerindeki etikette sterilite işareti, son kullanma tarihi ile lot numarası olmalıdır.
- Tüpleri her ambalaj paketlerinde; sterilite işareti, kod-lot numarası ve miadı, üretici firma adı ve adresi, şematik kısa kan alma klavuzunu da içeren bir etiket olmalıdır.
- Laboratuarda standardizasyon sağlanması, tüpün geri kaçması, iğnenin holder'dan çıkması, v.b gibi kullanım sırasında oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla Tüpler her marka kan alma iğnesi ve holder ile uyumlu olmalı, kan alma sırasında oluşabilecek olumsuzluklara neden olmamalıdır. Tüm malzemeler en az 1 yıl miadlı olmalıdır, malzemeler laboratuvarın isteğine göre parti parti teslim edilmelidir. Özelliği gereğince ambalajı açıldığında bozuk olduğu anlaşılabilecek malzemeler firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir. Sözleşme süresi içerisinde gerektiğinde firma tarafından daha uzun miadlılar ile değiştirilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Fatma ÖZKAN
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı
Dip Tes. No: 136476 / 103970

BORİK ASİT TEKNİK ŞARTNAME

- 1/ Toz seklinde olmalı
- 2/ 1kg ambolajlarda olmalı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Cemile Hacer OZCAN
Başhekim Yardımcısı