



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 1282
KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

15/06/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 19/06/2023 saat 10:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan Temin usulu alın yapılacaktır alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna mutlaka 19/06/2023 tarihi saat 10:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatin.alma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNİYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASIN TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	ASANSÖR ÜST KAPI MAKARASI ALIMI	5	ADET			
2	60*120*600 KUTU PROFİL	6	ADET			
3	40*60*600 KUTU PROFİL	2	ADET			
4	BETON PLAKA	6	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TL)						

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:



ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

ASANSÖR ÜST KAPI MAKARASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (5 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun kalitede üretilmiş olmalıdır
2. Ürün 47 mm çapa sahip olmalıdır
3. Ürün çelik tek kanal genişliği oval derinlikli ve 3 mm olmalıdır
4. Ürün rulman merkez çap 6 mm olmalıdır
5. Ürün kasnak genişliği 9 mm olmalıdır
6. Ürün rulman merkezinde 12 mm çapında 11 mm uzunluğunda kasnak bulunmalıdır
7. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

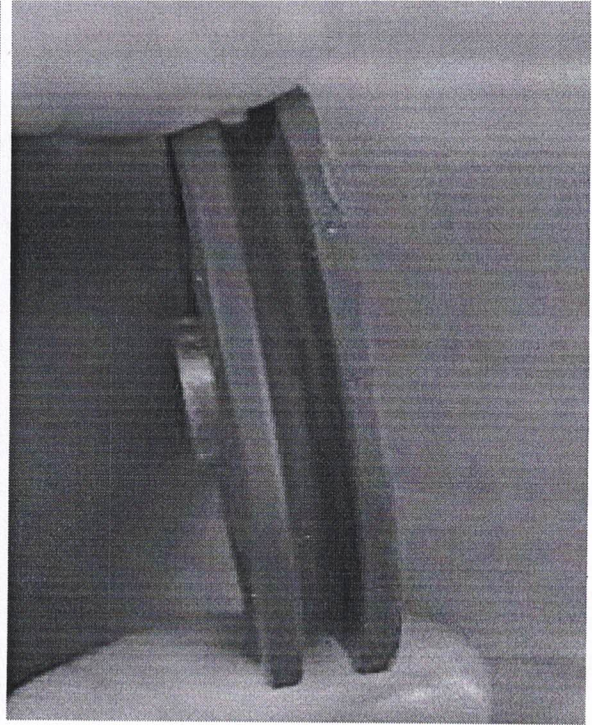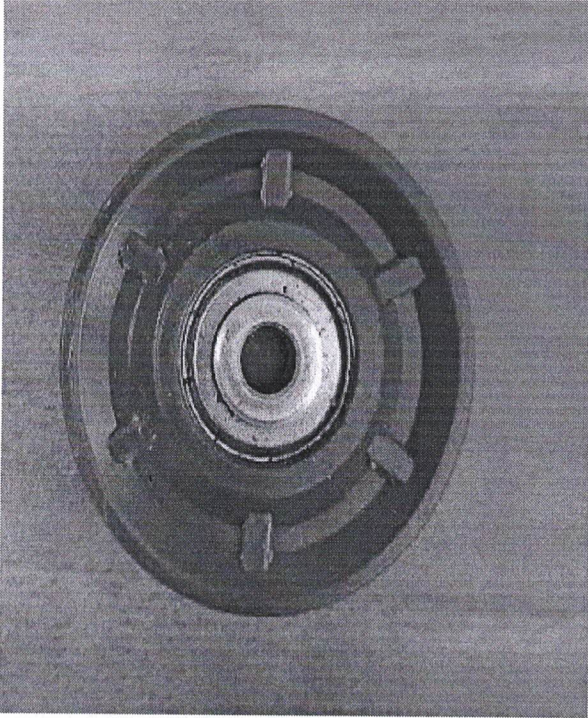

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.
Elektronik Müh.

A. 60x120x600 KUTU PROFİL ŞARTNAMESİ (6 ADET)

1. Kutu profiller TS, TSE ve DIN standartlarına uygun ve 6 metre standart boylarda üretilmiş olmalıdır.
2. Kutu profiller belirtilen kalite standartlarında ve ölçülerde olmalıdır
3. Birinci sınıf kalite olmalı ve temiz olup, lekeli ve paslı olmamalıdır. Düzgün olup eğilmiş ve burkulmuş olmamalıdır.
4. Kutu profiller paslanmaya karşı boyanmış olarak teslim edilmelidir
5. Orijinal malzemeden yapılmış olup hurdadan yapılan imalatlar kabul edilmeyecektir.
6. Kutu profiller et kalınlığı 4 mm ve 60x120x600mm ebatlarında olmalıdır
7. Malzeme hastanenin belirleyeceği noktaya teslimi yapılacak ve bu iş için fazladan ücret ödenmeyecektir.

B. 40x60x600 KUTU PROFİL ŞARTNAMESİ (2 ADET)

1. Kutu profiller TS, TSE ve DIN standartlarına uygun ve 6 metre standart boylarda üretilmiş olmalıdır.
2. Kutu profiller belirtilen kalite standartlarında ve ölçülerde olmalıdır
3. Birinci sınıf kalite olmalı ve temiz olup, lekeli ve paslı olmamalıdır. Düzgün olup eğilmiş ve burkulmuş olmamalıdır.
4. Kutu profiller paslanmaya karşı boyanmış olarak teslim edilmelidir
5. Orijinal malzemeden yapılmış olup hurdadan yapılan imalatlar kabul edilmeyecektir.
6. Kutu profiller et kalınlığı 2,5 mm ve 40x60x600mm ebatlarında olmalıdır
7. Malzeme hastanenin belirleyeceği noktaya teslimi yapılacak ve bu iş için fazladan ücret ödenmeyecektir.

C. BETOPAN PLAKA (6 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün kalınlığı en az 18 mm olmalıdır
3. Ürün ebatları 125x250 cm olmalı, 1. Sınıf defosuz olmalıdır
4. EN 324 – 1 standartlarına uygun üretilmiş hasarsız olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Alihan ERGÖY
Biyomedikal Elektrik
Elektronik Müh.