

T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 129  
KONU: 9 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIM

04/02/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **07/02/2019** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımımız **Birim Bedel** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **07/02/2019** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

~~Harun KARAHAN~~  
İ. M. Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	CANLANDIRMA ÇANTASI ( MAVİ KOD ÇANTASI )	1	ADET				
2	PAGER ÇAĞRI CİHAZI ( TELEMEDİC GP2009N SİSTEMİNE UYUMLU )	1	ADET				
3	LAM ARŞİV DOLABI	2	ADET				
4	KASET BLOK ARŞİV DOLABI	1	ADET				
5	ACİL MÜDAHALE ARABASI	3	ADET				
6	TEKERLEKLI SERUM ASKISI	5	ADET				
7	DUVAR TİPİ TELEFON	1	ADET				
	YAZICI	20	ADET				
9	KANEPE	6	ADET				
<b>GENEL TOPLAM</b>							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şetale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

## MAVİ KOD ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 60(+5) x 43(+5) x 24(+5) cm ölçülerinde olmalıdır.
2. Çanta imperteks malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Çanta içi 3 bölümden oluşmalıdır.
4. Mavi Kod Çantası fonksiyonel olmalı, ön ve arka gövde üzerinde 2 adet büyük, yan gövdeler üzerinde 2 adet küçük ve kapakta 1 adet büyük cep bulunmalıdır.
5. Tüm cepler üzerinde şeffaf kartvizitlikler olmalıdır.
6. Çanta içi bölümlerde tıbbi malzemelerin tespit edilebileceği lastik şeritler bulunmalı, Ampül tutucu ise aynı anda en az 50 adet farklı büyüklükteki ampülleri sabit şekilde taşıyabilmelidir. Yetişkin kapağında kanül veya enjektörlerin sabitlenebildiği lastik şeritler bulunmalıdır.
7. Çanta içinde farklı ölçülerdeki entübasyon tüpleri koyabilmek için 2 adet cep olmalıdır. Ayrıca çanta duvarlarına tıbbi ekipmanların sabitlenebileceği 5 cm lik lastik şerit dikilmiş olmalıdır.
8. Çanta içinde muhafaza edilen malzemeleri korumak için darbe emici malzeme kullanılmış olmalıdır.
9. Çanta içi seperatörle ile bölünebilmelidir.
10. Çanta elde veya omuzda taşımaya uygun olmalıdır.
11. Çantanın diri durması için duvarları sert pvc ile desteklenmiş olmalıdır.
12. Çantayı saran reflektör bant olmalıdır.

Nuray Çiğdem  
Ateş

## 1. LAM ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.1. Paslanmaz metal malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 1.2. Lam arşivlenmesi amacı ile kullanılacaktır.
- 1.3. Bir çekmece yaysız 220, yaylı 120 preparat alabilmelidir.
- 1.4. Bir dolap 10 üniteden oluşmalıdır.
- 1.5. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 1.6. Dolabın kolay taşınabilmesi için altı tekerlekli olmalıdır.
- 1.7. Bir üniteye 12 çekmece bulunmalıdır.

## 2. KASET BLOK ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 2.1. 20 çekmecedan oluşmalıdır.
- 2.2. Her çekmecedey 12 bölme olmalıdır.
- 2.3. Fırın boya ile boyanmış ve paslanmaz özellikte olmalıdır.
- 2.4. Her çekmecedey etiket bulunmalı ve çekmeceler kolayca açılıp kapanmalıdır.
- 2.5. Her çekmecedey yaysız en az 400 blok alabilmelidir.
- 2.6. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 2.7. Dolabın kolay taşınabilmesi için altı tekerlekli olmalıdır.

Mühürleşmiş ve taslatılmış  
Uzm. Dr. Gamze DÖNMEZ  
Diy. Tıp. No: 4661

### ACİL MÜDAHALE ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Arabanın tüm yüzeyi kolay temizlenebilir hijyenik bir materyalden yapılmış olmalıdır.
- 2) Tüm yüzey kırılmaya ve bükülmeye karşı dayanaklı olmalıdır.
- 3) Arabanın üst tablası 50X60 cm( $\pm$  1cm) ebatlarında ve konulan malzemelerin düşmemesi için düz olmalıdır.
- 4) Arabanın üst tablasını muhafaza edebilmek için şeffaf silinebilen koruyucusu olmalıdır.
- 5) Arabada ilaç hazırlığında kullanılacak araba üst tablası altına gizlenebilen istenildiğinde kolayca açılabilen bölüm olmalıdır.
- 6) Arabada sadece teker bağlantı yerinde çelik iskelet kullanılmış olmalıdır.
- 7) Arabanın gerekli tıbbi malzemelerin konulacağı 5 adet çekmecesine olmalıdır.
  - 2 ( iki ) adet küçük boy: 7,5x44,5x54,5 cm ( $\pm$ 1 cm)
  - 2 (iki ) adet orta boy: 16x44,5x54,5 cm ( $\pm$  1 cm)
  - 1 ( bir ) adet büyük boy: 25x44,5x54,5 cm ( $\pm$  1 cm)
- 8) Çekmeceler ray sistemi ile çalışmalı ve ray sistemleri kaliteli olmalı ve kolay kapanmalıdır.
- 9) Araba çekmece içlerinde ilaç ve kullanılacak diğer malzemeleri koyabilmek için gerekli ölçülerde bölümler ve bu bölümleri de bölebilmek için ayrılar olmalıdır.
- 10) Çekmecenin ortasında açıp kapamamak için ergonomik ve çekmece ile bütünlük içinde olan tutma yerileri olmalıdır.
- 11) Arabanın üstünde araba ile aynı malzemedan üretilmiş itmek için el tutamaç yeri olmalıdır.
- 12) Araba çekmeceleri mühür kilit mekanizması ile kilitlenebilmelidir.

Melik Adem Büyüklü

✓

- 13) Kilit mekanizması ileri doğru basılıp yukarı kaldırıldığında kilitlenebilir özellikte, mekanizmayı aşağı doğru indirmek suretiyle kilit mekanizması açılabilir özellikte olmalıdır.
- 14) Her araba ile birlikte 50 adet mühür kilit birlikte verilmelidir.
- 15) Arabanın 360° dönebilen 12 cm ( $\pm 1$  cm) çapında 4 adet tekerleği olmalı bu tekerleklerden ön tarafta olan iki tanesinde sabitleme fren tertibatlı özelliği olmalıdır.
- 16) Tekerlek aşınmaya ve darbeye dayanıklı dolgu tekerlek olmalıdır. Tekerlek tutucu forklar çelikten olmalıdır
- 17) Arabanın üst düzeyine gelecek şekilde monte edilmiş, 30 x 35 cm ( $\pm 5$  cm) üç değişik şekilde ayarlanabilen defibilatör/monitör rafı ve emniyet kemeri olmalıdır.
- 18) Arabanın sağ arka tarafında en az iki kancası bulunan yüksekliği ayarlanabilen serum askısı olmalıdır.
- 19) Arabada 1 ( bir ) adet en az 3 lt oksijen tüp taşıyıcısı olmalıdır.
- 20) Arabada 1 ( bir ) adet resüsitasyon bordu, bu bordun takıldığı tutucular olmalıdır.
- 21) Resüsitasyon bordu arabanın arka kısmına monte edilmiş olmalıdır.
- 22) Arabanın en geniş ölçüleri dıştan dışa 61 cm ( $\pm 3$  cm) x 79 cm. ( $\pm 3$  cm) olmalıdır.
- 23) Arabanın yerden yüksekliği ( yerden el tutamacının üstüne kadar ) 110 cm ( $\pm 3$  cm) olmalıdır.
- 24) Arabanın 2 (iki ) yıl garantisi olmalıdır
- 25) Arabanın 10 ( on ) yıl yedek parça ve bakım garantisi olmalıdır.

## TEKERLEKLİ SERUM ASKISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Serum askısının dört adet serum kancası bulunmalıdır.

Serum askısının yüksekliği ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

Dış gövde en az krom - nikel kaplamalı çelik borudan imal edilmiş olmalıdır.

Serum askısı 5 ayaklı olmalıdır.

Serum askısının beş ayağı dökümden olmalı ve devrilmeyi önleyecek, şekilde dizayn edilmelidir.

Kendi etrafında 360 derecede dönebilen hareketli 75x25 rulmanlı, ikisi frenli ,üçü frensiz olmak üzere 5 adet dayanıklı sarhoş tekeri olmalıdır.

Ayak çapı 550 mm olmalıdır.

Ayarlanabilir yüksekliği kontra vidalı değildir.


Serum askısı fabrikasyon hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır.

Bu süre içinde imalat, malzeme ve işçilik hataları giderilmelidir.

Üretici firmanın TSE hizmete yeterlilik bilgisi olmalıdır.

Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığında onaylı satış sonrası hizmete yeterlilik belgesi olmalıdır.

Üretici firma ISO 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.

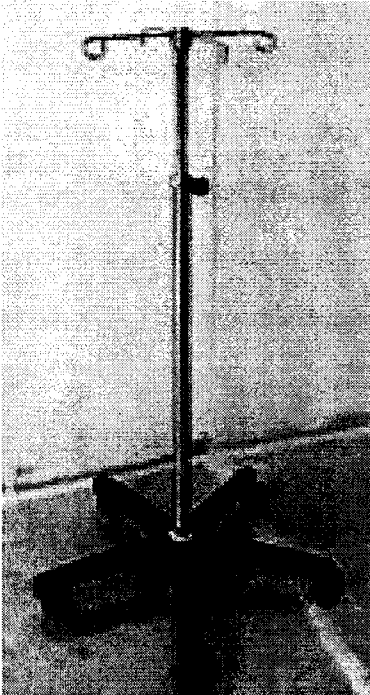

## DUVAR TİPİ TELEFON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Duvara monte edilebilir olmalıdır
- 2.0,40 metreden 3 metreye kadar uzayabilen esnek kablo
- 3.Kamusal telefon şebekelerinde çalışır olmalıdır
- 4.Dış ortam sesini azaltma özelliği ile birlikte üstün ses niteliğine sahip olmalıdır
- 5.En az iki yıl garantisi olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi  
Emine AYCI  
Ameliyathane Sorumlu Hemsire

Manavgat Devlet Hastanesi  
Dr. Ferit GÖK  
Tıbbi Neşimci Sorumlu  
Dip Tes. No: 09398



TC Sağlık Bakanlığı

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Manavgat Devlet Hastanesi**  
**TEKNİK ŞARTNAME FORMU**

**1- Mono Lazer yazıcı**

- 1.1) Satın alınacak sarf malzemelerinin hiç bir yerinde üretim ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, boya hatası, kabartı ve deformasyon olmamalıdır.
- 1.2) Teklif edilen tüm cihazlar (özel olarak belirtilenler hariç), 220V 50Hz şebeke geriliminde çalışacak şekilde, en az 110 – 240 V AC, 50-60 Hz  $\pm$ 2 Hz frekanslarında ve ayrı bir dönüştürücüye gerek olmadan çalışacaktır. Cihazlar şebekede meydana gelebilecek dalgalanmalardan etkilenmeyecektir.
- 1.3) Cihazın kopya hızı A4 kâğıt için dakikada en az 18 adet çekim olacaktır
- 1.4) Cihaz Windows, Pardus ve en az bir Linux dağıtımının sürümlerine uyumlu olacak ve sürücülerini ile birlikte verilecektir.
- 1.5) Cihaz, Türkçe karakterleri tam olarak destekleyecektir.
- 1.6) Teklif edilen cihaz, mono Lazer Yazıcı, fonksiyonlarına sahip olacaktır.
- 1.7) Cihazın baskı yapacağı kâğıt boyutları, A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Özel boyut kâğıt standartlarına uygun olacaktır.
- 1.8) Cihaz, kasetten otomatik kâğıt beslemeli olacaktır ve tepsinin en az 150 (yüz elli) sayfa kâğıt
- 1.9) Cihaz la birlikte enerji besleme kabloları, USB bağlantı kablosu, Network kablosu (en az 3m patch kablo) ve diğer standart aksesuarları verilecektir.
- 1.10) Cihazla birlikte gerekli kurulum medyaları(CD vb.) verilecektir. Garanti kapsamı süresince cihaz sürücülerini Yüklenicinin resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.
- 1.11) Cihazın baskı teknolojisi Lazer/LED olacaktır.
- 1.12) Cihaz belleği en az 1 GB olacaktır.
- 1.13) Toner, drum varsa developer ve fırın ünitelerinin her biri toplamda orjinal ve standart üzerinde gelenler dahil en az 70.000 (yetmişbin) çekimlik olacak şekilde teslim edilecektir. Yedek verilecek her bir ünite orijinal ambalajında olacaktır. Üretici firma tarafından sarf malzemelerinin çekim kapasiteleri ve teslim tarihinden itibaren en az iki yıl raf ömrü olduğu belgelendirilecektir.
- 1.14) Cihazlar her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik titreşimlerden veya benzeri etkenlerden etkilenmeyecek şekilde taşınmaya uygun ve tüm fonksiyonlarıyla çalışması için gereken aksesuarlarıyla orijinal ambalajı içerisinde olacaktır.
- 1.15) Sürekliliği sağlamak için cihazın uygun bir noktasına, projenin adı, yüklenici firmanın adı, telefon ve faks numarası (alan kodu ile birlikte), çağrı merkezinin numarası, garanti başlangıç ve bitiş tarihleri bilgilerini içeren PVC kaplı en az 70×70 mm ebadındaki bir form (yırtılmayacak, yazılan bilgiler silinmeyecek ve kolayca çıkmayacak özellikte) yapıştırılacaktır.
- 1.16) Aksesuar listesi, orijinal Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve garanti belgesi, cihazların ambalajlarına naylon kılıf içerisinde konulacaktır.

*M. Kemal Süleyman*



## KANEPE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nano Teknolojisi ile üretilmiş olacaktır.
2. İskelet Profil olacaktır.
3. Bonel yay sistemi olacaktır.
4. Süngeri 32 dansite takviyeli olacaktır.
5. Ayakları metal olacaktır.
6. Döşemelik kumaşı, serteks tay tüyü kumaş ve leke tutmaz özellikte olacaktır.
7. Kirlent Her Kanepe İçin 2 adet olacaktır.
8. Kanepe ebatları 2.30\*90 cm olacaktır.

Birgöl Tirok  
Acil Servis Sorumlusu  
Bilal

## KANEPE 3'lü TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İskeleti demir profil olmalıdır.
2. Altı bazalı, sırt kısmı yatırılarak yatak haline getirilebilir olmalıdır.
3. Kanepeler ile birlikte 2 adet kırılent verilecektir.
4. Kol dayanaklarının kumaş kaplı yumuşak malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
5. Kumaşı silinebilir olmalıdır.
6. KOLTUK HALİ ÖLÇÜLERİ • Oturum Derinliği 50-60cm aralığında, Oturum Yüksekliği 40-45cm aralığında, Yükseklik (Sırt Dahil) 75-85cm aralığında, Boy (Dıştan Dışa) 180-200cm aralığında, En (Dıştan Dışa) 90-100cm aralığında olmalıdır
7. Kanepelerin montajı ve aksesuarları firma tarafından ücretsiz ve şartnameye uygun olarak tamamlanarak kullanılabilir vaziyette teslim edilecektir.
8. Rengine muayene komisyonu karar verecektir.
9. Kanepeler için en az 2 yıl süreli garanti verilecektir.
10. Garanti süresi içinde kullanım hatası dışında kalan, imalat hataları sonucunda ortaya çıkan her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye aittir.
11. Şartname esaslarına uygun olmayan işler/imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.

İmza  
Uzun