

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 155
KONU: 7 KALEM ORTOBEDİ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

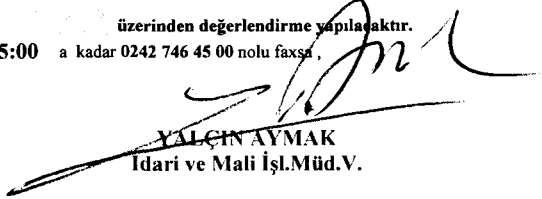
12.02.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **12.02.2020** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **12.02.2020** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **YALÇIN AYMAK** İdari ve Mali İşl.Müd.V. m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.


YALÇIN AYMAK
İdari ve Mali İşl.Müd.V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DİZ REVİZYON FEMORAL KOMPONENT ÇİMENTOLU TİTANYUM KAPLAMASIZ	1	ADET	AP4030			
2	DİZ PRİMER TİBİAL KOMPONENT ANATOMİK VEYA DEĞİL KENDİNDEN STEMLİ KANATLI/VİDALI/PEKLİ SABİT ÇİMENTOLU TİTANYUM KAPLAMASIZ	1	ADET	AP2800			
3	DİZ REVİZYON TİBİAL İNSERT REVİZYON AMAÇLI HAREKET KISITLAMALI UHMW POLİETİLEN	1	ADET	AP4190			
4	DİZ REVİZYON TİBİAL BLOK VİDALARI DAHİL MEDİAL,LATERAL FUL-ÇİMENTOSUZ TİTANYUM	2	ADET	AP4280			
5	DİZ REVİZYON TİBİAL KAMA/YÜKSELTİCİ(VİDALAR DAHİL) MEDİAL,LATERAL FUL-ÇİMENTOSUZ TİTANYUM	2	ADET	AP4300			
6	DİZ REVİZYON FEMORAL VE TİBİAL STEMLER TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ TİTANYUM KAPLAMASIZ	2	ADET	AP4110			
7	DİZ REVİZYON FEMORAL BLOK(VİDALAR DAHİL) DİSTAL/POSTERIOR-ÇİMENTOSUZ TİTANYUM	5	ADET	AP4140			

GENEL TOPLAM

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

REVİZYON DİZ PROTEZİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * FEMORAL COMPONENTLER HEKİMİN DOĞRU SEÇİMİNİ VE BU SEÇİMİN HASTA ÖZELLİKLERİNE UYUMUNU SAĞLAMAK AMACI İLE SAĞ VE SOL OLMAK ÜZERE SİZE C M/L 60mm A/P 53.5mm SİZE D M/L 64mm A/P 57.5mm SİZE E M/L 68mm A/P 61.5mm SİZE F M/L 72mm A/P 65.5mm SİZE G M/L 76.5mm A/P 70.5mm SİZE LARDA (ÖLÇÜLERDE) OLMALIDIR.
- * FEMORAL COMPONENTLER ZİMALLOY-DAN COBALT,CROMİUM ,MOLYBDENUM ALLOY'DAN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- * FEMORAL COMPONENTLERİN HAREKET KABİLYETİ 0 İLE 95 DERECE ARASINDA OLMALIDIR.
- * FEMORAL COMPONENTLERİN FİKSASYONU TAM OLARAK SAĞLAYABİLMESİ İÇİN CEMENTLİ VE PECK' Lİ OLMALIDIR.
- * FEMORAL COMPONENTLER DE BAĞ KORUYAN COMPONENTE ORANLA KONDİL BÖLGESİNDE DAHA KÜÇÜK KAVİSLERE SAHİP OLMALI BU KISITLANDIRILMIŞ HAREKET KONDİL ÜZERİNDE 7 DERECELİK VARUS - VALGUS AÇISI DAHİL OLMAK ÜZERE GENİŞ BİR HAREKET ALANININ OLUŞMASINI SAĞLAMALIDIR.
- * İNSETLER (SURFACE) İN YÜZEY GENİŞLİĞİ 3 FARKLI SİZE 'DA OLMALI SİZE YELLOW M/L 66 mm A/P 42 mm SİZE GREEN M/L 74 mm A/P 46 mm SİZE BLUE M/L 82 mm A/P 51 mm OLMALIDIR.
- * İNSETLER'İN KALINLIKLARI 5 FARKLI SİZE 'DA 9 - 10 - 12 -14 - 17 mm OLMALIDIR.
- * İNSETLER FAZLALAŞTIRILMIŞ A/P SABİTLİĞİ İÇİN ANTERİOR CONSTRAINED OLMALI VE PROXİMAL YÜZEYE 6 DERECELİK DIŞARIDAN ROTASYONUNUN SAĞLANABİLMESİ İÇİN ANATOMİK ROTASYONLU OLMALIDIR.
- * TİBİAL COMPONENTLER GÖZENEKLİ KAPLANMIŞ VEYA KAPLANMAMIŞ , PORLU VEYA PORSUZ OLMALIDIR.
- * TİBİAL COMPONENTLER TİVANİUM Tİ 6AI-4V ALLOY METARİYAL YAPISINA SAHİP OLMALIDIR.
- * TİBİAL COMPONENTLER HEKİMİN DOĞRU SEÇİMİNİ VE BU SEÇİMİN HASTA ÖZELLİKLERİNE UYUMUNU SAĞLAMAK AMACI İLE 6 FARKLI SİZE 'DA OLMALIDIR. SİZE 3 M/L 66 mm A/P 42 mm SİZE 4 M/L 66 mm A/P 46 mm SİZE 5 M/L 74 mm A/P 46 mm SİZE 6 M/L 74 mm A/P 50 mm SİZE 7 M/L 82mm A/P 51mm SİZE 8 M/L 82 mm A/P 54 mm
- * TİBİAL COMPONENTLER'E İSTEĞE GÖRE WEDGE TAKILABİLMELİ WEDGE 'LER HALF WEDGE 16 - 26 DERECE THIRD WEDGE 22 DERECE FULL WEDGE 7 DERECE HALF BLOK'LAR 5 - 10 mm OLMALI VE TİBİAL COMPONENTLE FİKSASYONU MEDİAL VEYA LATERAL DEN 2 VİDA İLE SAĞLANMALIDIR.
- * FEMORAL VE TİBİAL STEM UZATMALARI OFFSET VEYA STRAİGT SEÇENEKLİ OLMALIDIR. STEM UZUNLUKLARI 145 mm VE 200 mm ÇAPLARI İSE 10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-22-24 mm OLMALIDIR.
- * PATELLAR COMPONENTLERİN YAPISI POLYETHİLEN MATERYALDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- * 1PATELLAR COMPONENTLER SEÇİLEN FEMORAL VE TİBİAL COMPONENTLERE TAM UYUMUNUN SAĞLANABİLMESİ İÇİN 4 FARKLI SİZE VE KALINLIK SEÇENEKLERİ İÇERMELİDİR. SİZE 29mm * 8.0mm SİZE 32mm * 8.5mm SİZE 35mm * 9.0mm SİZE 38mm * 9.05mm
- * İHALEYİ KAZANAN FİRMA OPERASYONDAN 3 GÜN ÖNCE HABERDAR EDİLECEK FİRMA OPERASYON İÇİN GEREKLİ ÇAKMA SETİ VE DELİCİ KESİCİ MOTORLARI OPERASYONDAN ÖNCE VERMEK ZORUNDADIR.
- * TÜM İMPLANTLAR GAMMA METODU İLE STERİL EDİLMİŞ , İÇ İÇE GEÇİRİLMİŞ ÜÇ AYRI PAKETLİ OLMALI VE EN DIŞ PAKETİN İÇERİSİNDE STANDARTLARA UYGUN BASILMIŞ,ÜRÜNLERİN: KATALOG , LOT , ÜRÜN İSİMLERİ VE BİLGİLERİNİ İÇEREN 4 ADET YAPIŞKANLI ETİKET OLMALIDIR.
- * TÜM İMPLANTLAR TÜV , CE , STANDARTLARI BELGELERİNE SAHİP OLMALIDIR.
- * TÜM İMPLANTLAR MR (MAGNETIC REZONANS) GÖRÜNTÜLEME SIRASINDA ÇEKİM GÜCÜNDEN ETKİLENMEMELİDİR.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Ali...
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 92075

Manavgat Devlet Hastanesi
Yusuf...
Dip. Tes. No: 110293
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Ali...
Dip. Tes. No: 81447
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

1-DİZ REVİZYON FEMORAL KOMPONENT REVİZYON AMAÇLI FEMORAL KOMPONENT-ÇİMENTOLU CoCr/TİTANYUM KAPLAMASIZ

1(BİR) ADET SUT:AP4030

2-DİZ PRİMER TİBİAL KOMPONENT (ANATOMİK VEYA DEĞİL) KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS. SABİT-ÇİMENTOLU CoCr/TİTANYUM KAPLAMASIZ

1(BİR) ADET SUT:AP2800

3-DİZ REVİZYON TİBİAL İNSERT REVİZYON AMAÇLI TİBİAL İNSERT-HAREKET KISITLAMALI UHMW POLİETİLEN

1(BİR) ADET SUT:AP4190

4-DİZ REVİZYON TİBİAL BLOK (VİDALARI DAHİL) MEDİAL, LATERAL / FULL-ÇİMENTOSUZ CoCr/TİTANYUM

2(İKİ) ADET SUT:AP4280

5-DİZ REVİZYON TİBİAL KAMA/YÜKSELTİCİ (VİDALARI DAHİL) MEDİAL, LATERAL / FULL-ÇİMENTOSUZ CoCr/TİTANYUM

2(İKİ) ADET SUT:AP4300

6-DİZ REVİZYON FEMORAL VE TİBİAL STEMLER TÜM BOYLAR-ÇİMENTOSUZ CoCr/TİTANYUM KAPLAMASIZ

2(İKİ) ADET SUT:AP4110

7-DİZ REVİZYON FEMORAL BLOK (VİDALARI DAHİL) DİSTAL / POSTERIOR - ÇİMENTOSUZ CoCr/TİTANYUM (BEŞ) ADET SUT:AP4140

Manavgat Devlet Hastanesi
Nispetiye Mahallesi
Dip. Tes. No: 80057
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Nispetiye Mahallesi
Dip. Tes. No: 80057
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. İbrahim ÇEKAN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 82075