

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

1759

KONU: 13 KALEM TEMİZLİK VE GİYECEK MALZEMESİ ALIM

27/09/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **03/10/2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **03/10/2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KOMPOZİT BURUNLU KIŞ AYAKKABISI	14	ADET				
2	KOMPOZİT BURUNLU YAZ AYAKKABISI	14	ADET				
3	ELEKTİRİKÇİ İŞ AYAKKABISI	6	ADET				
4	TOZ MASKESİ	20	ADET				
5	LASTİK ÇİZME	6	ADET				
6	YAĞMURLUK	3	ADET				
7	ÇAPAK GÖZLÜĞÜ	5	ADET				
8	REFLEKTÖRLÜ YELEK	14	ADET				
9	KULAKLIK TIKACI	8	ADET				
10	KESİLMEZ DİRENÇLİ ELDİVEN	2	ADET				
11	MONTAJ ELDİVENİ	50	ADET				
12	ŞEFFAF GÖZLÜK	14	ADET				
13	ANTİ STATİK KAPLAMALI ELDİVEN	6	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESLERİ


KOMPOZİT BURUNLU KIŞ AYAKKABISI (14 Adet)

1. Süet deri olmalıdır.
2. Kompozit burun koruyucu olmalıdır.
3. Antistatik, şok emicili ve SRC kaymaz PU taban olmalıdır.
4. Terleme ve aşınma dirençli iç astar olmalıdır.
5. %100 metal içermeyen yapılı olmalıdır.
6. CE, EN ISO 345-346-347 uygun olmalıdır.
7. Ağırlık: 1 tek 42 numara 520 gram olmalıdır.
8. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.



KOMPOZİT BURUNLU YAZ AYAKKABISI (14 Adet)

1. Süet deri olmalıdır.
2. Kompozit burun koruyucu olmalıdır.
3. Antistatik, şok emicili ve SRC kaymaz PU taban olmalıdır.
4. Terleme ve aşınma dirençli iç astar olmalıdır.
5. %100 metal içermeyen yapılı olmalıdır.
6. CE, EN ISO 345-346-347 uygun olmalıdır.
7. Ağırlık 1 tek (42 numara) maksimum 520 gram olmalıdır.
8. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

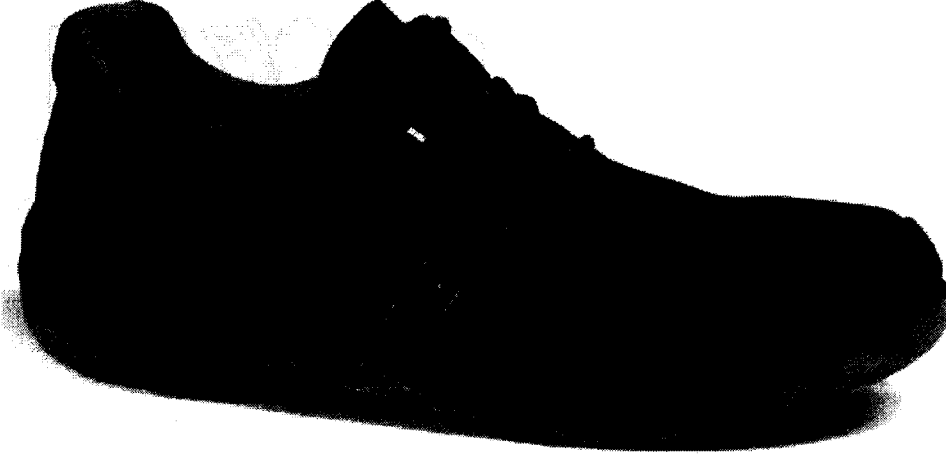

ELEKTRİKÇİ İŞ AYAKKABISI (6 Adet)

1. Süet deri olmalıdır.
2. Kompozit burun koruyucu olmalıdır.
3. Antistatik, şok emicili ve SRC kaymaz PU taban olmalıdır.
4. Terleme ve aşınma dirençli iç astar olmalıdır.
5. %100 metal içermeyen yapılı olmalıdır.
6. EN 20345 standardına uyumlu olmalıdır.
7. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

TOZ MASKESİ (20 Adet)

1. Toz - sıvı - gaz - kötü koku ve kaynak dumanı engelleyici olmalıdır.
2. İç ve dış polipropilen katmanlar ile kuvvetlendirilmiş olmalıdır.
3. Doğal kauçuk esnek bağlantı kuşakları olmalıdır.
4. Polietilen kaplı metal burun aparatı olmalıdır.
5. En 149 standardına uyumlu olmalıdır.
6. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

LASTİK ÇİZME (6 Adet)

1. Çelik burunlu ve çelik taban koruyuculu olmalıdır.
2. Yüzey ve taban yağa dayanıklı olmalıdır.
3. Su geçirmez özellikte olmalıdır.
4. Elektrostatik deşarj özellikte olmalıdır.
5. 10.000 V'ye kadar elektriğe dayanıklı olmalıdır.
6. EN 340 standardına uyumlu olmalıdır.
7. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

A. YAĞMURLUK (3 Adet)

1. Minimum 0.3 mm / 300 mc su geçirmez olmalıdır.
2. Fermuar ve su geçirmeyi ekstra önleyici fermuar ve çitçitli kapama olmalıdır.
3. İki büyük kapaklı cep olmalıdır.
4. Daraltma ipli kapüşon olmalıdır.
5. Su ve rüzgâr geçirmeyi önleyen iç konçlu kollar olmalıdır.
6. En 343 standardına uyumlu olmalıdır.
7. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

ÇAPAK GÖZLÜĞÜ (5 Adet)

1. Çerçeve naylon, kaymaz burun pedli olmalıdır.
 2. Sap yukarı aşağı ileri geri ayarlanabilir olmalıdır.
 3. Lens polikarbonat (hard coated) - Kalınlık: 2,2 mm olmalıdır.
 4. Koruma faktörü: 45 mt/sn uv radyasyon %99 380 nm Güneş ışığına karşı koruyucudur.
 5. Optik faktör devamlı kullanıma uygun olmalıdır.
 6. Çalışma sıcaklığı -5 & +55 derece uygun olmalıdır.
 7. Çerçeve CE EN 166 uygun olmalıdır.
 8. Lens: CE EN 172
 9. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.
1. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

REFLEKTÖRLÜ YELEK (14 Adet)

1. Yüksek görünürlükte sarı %100 Polyesterden olmalıdır.
 2. Kumaş hafif esnek ve nefes alabilir özellikte olmalıdır.
 3. Bel bölgesinde iki reflektörlü bant kullanılmış olmalıdır.
 4. Fermuarlı olmalıdır.
 5. En 471 standardına uyumlu olmalıdır.
 6. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.
1. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

KULAKLIK TIKACI (8 Adet)

1. Kordonlu kulak tıkacı yıkanabilir özellikte olmalıdır
2. Tıkaçların kullanım aralarında temiz kalması ve korunması için kayış klipsi saklama torbası bulunmalıdır
3. Kaybolmaya karşı koruma ve ürünün gerektiğinde el altında olmasını sağlayan kordonu bulunmalıdır
4. Nem direnci ve diğer PPE ile uyumlu olmalıdır

5. Kulak tıkaçları yeniden kullanılabilir ve bastırma gerektirmez.
6. Yerleştirme kolaylığı için parmak kavrama tasarımı bulunmalıdır
7. Sinyal gürültü oranı $Snr = 25$ Db olmalıdır
8. EN 352-1, EN 352-2 standartlarına uygun olmalıdır
9. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

KESİLMEZ DİRENÇLİ ELDİVEN (2 Adet)

1. Yüksek derecede koruma gerektiren her türlü montaj işleminde kullanılabilir olmalıdır.
2. Avuç içi malzemesi yarma deri olmalıdır.
3. El üstü malzemesi koton kumaş olmalıdır
4. En 388 normuna uyumlu olmalıdır.
5. Tutuş, dokunma hassasiyeti ve hava geçirgenliği hassas olmalıdır.
6. CE Sertifikalı
7. %100 nefes alabilir dikişsiz astarlı olmalıdır.
8. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

MONTAJ ELDİVENİ (50 Adet)

1. Kaplama malzemesi köpük nitril siyah olmalıdır
2. Silikon içermemelidir
3. 360° hava geçirgenliği bulunmalıdır.
4. Micro-cup kaymaz kavrama özelliğine sahip olmalıdır
5. El yorgunluğunu azaltıcı ve konforu artırıcı özelliğe sahip olmalıdır
6. Milimetrede en az 18.000 aşındırıcı sürtünme döngüsüne dayanabilecek dayanıklılığa sahip olmalıdır.
7. 89/686/AET, EN420 ve EN388 sayılı EN standartlarına uygun olmalıdır
8. Adetlere ait bedenler numune değerlendirmesinden sonra belirlenecektir.
9. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

ŞEFFAF GÖZLÜK (14 Adet)

1. Kulaklık ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Düz ayarlanabilir sapa sahip olmalı, kaymayan lastik uçlar bulunmalıdır
3. UV radyasyona karşı koruma sağlamalıdır
4. Numaralı gözlüklerin de üzerinde kullanılabilmelidir
5. Anti-Scratch & Anti-Fog kaplama bulunmalıdır
6. Ürün düşürmeye karşı dayanıklı ve dağılmaz camlara sahip olmalıdır
7. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

ANTI STATİK KAPLAMALI ELDİVEN (6 Adet)

1. Kaplama malzemesi köpük nitril olmalıdır
2. Antistatik özelliğe sahip en az 7 boy ve 2 kaplama çizgisine sahip olmalıdır
3. 360° hava geçirgenliği bulunmalıdır.
4. Micro-cup kaymaz kavrama özelliğine sahip olmalıdır
5. El yorgunluğunu azaltıcı ve konforu artırıcı özelliğe sahip olmalıdır
6. Milimetrede en az 18.000 aşındırıcı sürtünme döngüsüne dayanabilecek dayanıklılığa sahip olmalıdır.
7. 89/686/EEC, EN420 ve EN388 sayılı EN standartlarına uygun olmalıdır
8. Adetlere ait bedenler numune değerlendirmesinden sonra belirlenecektir.
9. Numune hastane teknik ekibi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

MANAVGAT DEVLET HASTANE-
Alev Nazan AKINAGIBAS
İnceleme Teknikleri