

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 122
KONU: 8 KALEM ORTOPEDİ SARF MALZEME ALIMI

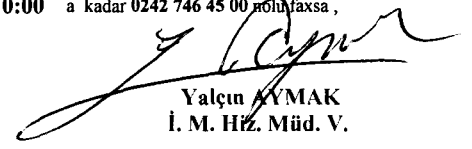
19/02/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ f (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **20/02/2019** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **Birim Bedel** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **20/02/2019** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 no.lu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.


Yalçın KAYMAK
İ. M. HİZ. Müd. V.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	FEMORAL STEM	1	ADET				
2	ASETABULAR CUP TİTANYUM ÇİFT	1	ADET				
3	ASETABULAR LİNER	1	ADET				
4	ASETABULAR VİDA TÜM BOY	1	ADET				
5	FEMORAL BAŞ 28 MM	1	ADET				
6	FEMORAL BAŞ 32 MM	1	ADET				
7	FEMORAL BAŞ 36 MM	1	ADET				
8	ASETABULAR SERAMİK	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

KARE KESİT FEMORAL STEMLİ TOTAL KALÇA PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARE KESİT ÇİMENTOSUZ FEMORAL STEM

- 1) Stem ISO 5832-11 ve ASTM 1295 Standartlarına uygun Ti6Al7Nb alaşımından üretilmiş olmalıdır.
- 2) Femoral stem, femoral kanala tam uyum sağlaması açısından en az 14 değişik boy seçeneği içermelidir.
- 3) DKÇ zemininde kullanılabilmesi için özel boylar da içermelidir.
- 4) Standart ofset lerin dışında gereğinde kullanılması için Lateral Ofset seçeneği bulunmalıdır.
- 5) Stem rotasyonel stabiliteyi en iyi şekilde sağlayabilecek şekilde dörtgen kesitli olarak tasarlanmış olup, 1/3 proximali plazma sprej üzeri hidroxyapatit kaplı olmalıdır
- 6) Femoral stem yekpare olmalıdır.
- 7) Femoral stem -3 den başlayıp 1 mm büyüyerek +9 kadar gitmelidir.
- 8) Stemin trokanterik bölgede 5 adet yumuşak doku tutturmak için deliği olmalıdır.
- 9) Stem baş koniği 12/14 taper olmalıdır.
- 10) Ürün Gama inert, gazplasma veya EO sterilizasyonla steril edilmiş olmalıdır.

ÇİMENTOSUZ ASETABULAR KOMPONENT VE POLİETİLEN LINER

- 1) Acetabular Cup ISO 5832-2 ve ASTM F 1185 standartlarına uygun Titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
- 2) Acetabular Component vidalı olmalı, osteonekroz nedeniyle 2 den fazla vida deliği bulunmamalıdır. En küçük 40 mm den başlayıp 68 mm. ye kadar 2 şer mm. aralıklarla artarak giden boylarda olmalıdır.
- 3) Acetabular Cup 'ın üzeri tamamen titanium plazma kaplı olmalıdır.
- 4) Polietilen Insert , UHMW – PE özelliğinde ISO 5834-2 Standartlarında üretilmiş olmalıdır. Nötral 10 ° ve 15 ° açılı seçenekleri bulunmalıdır.
- 5) Insert kalınlığı 46 mm . nin üzerindeki boylar için 28 mm. ; 40-42-44 size' lar için 22 mm başa uyumlu olmalıdır. Genç Hastalar için Metal veya Ceramik İnsert seçeneği bulunmalıdır.
- 6) Ürün ISO 9001, CE ve FDA Standartlarına haiz olmalıdır.
- 7) Sarf ürünlerin tamamı Gamma Sterilizasyonda sterilize edilmiş vaziyette; çok sağlam iki katlambalajında ve paket üzerinde lot numarası yazılı olacak şekilde teslim edilmelidir.

COCR FEMORAL BAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Femoral baş Co Cr malzemeden (ASTM F 799 ve ISO 5832/12) üretilmiş olmalıdır.
- 2) Femoral başlar 22 mm, 26 mm, 28 mm, 32 mm dış çap seçeneklerine sahip olmalıdır.
- 3) Boyun uzunluğu seçenekleri -3, 0, +4, +8, +12, +16 olarak 6 farklı boyda olmalıdır.
- 4) 12/14 taper özellikte olmalıdır.
- 5) Femoral başlar uluslararası standart belgelere (ISO, CE, FDA v.b.) sahip olmalıdır.
- 6) Ürün Gama inert, gazplasma veya EO sterilizasyonla steril edilmiş olacaktır. İç içe iki kat steril ambalajla paketlenmelidir.

ASETABULAR KOMPONENT VİDASI

- 1) Asetabular komponenti kemiğe sabitlemek amacıyla kullanılmalıdır.
- 2) Titanyum asetabular komponent ile kullanıma uygun olan titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3) Vida boyları 15mm - 60 mm aralığında 9 farklı seçeneğe sahip olmalıdır.
- 4) Vida çapları 6.0 mm - 6,5 mm aralığında olmalıdır.
- 5) Ürün Gama inert, gazplasma veya EO sterilizasyonla steril edilmiş olacaktır. İç içe iki kat steril ambalajla paketlenmelidir.

AP2050 FEMORAL STEM 1 ADET
AP1490 ACETABULAR CUP 1 ADET
AP1610 ACETABULAR LINER 1 ADET
AP1670 VİDA 3 ADET
AP1730 28MM CERAMİK HEAD 1 ADET
AP1780 32MM CERAMİK HEAD 1 ADET
AP1840 36MM CERAMİK HEAD 1 ADET
AP1650 CERAMİK LINER 1 ADET

Manavgat Devlet Hastanesi
Dr. Y. S. ÖZGÖRGEN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Dr. Y. S. ÖZGÖRGEN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mete ÖZGÖRGEN
Dip. Tes. No.: 81447
Ortopedi ve Trav. Uzm.