

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

-198

KONU: 9 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

24/02/2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **25/02/2021** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **25/02/2021** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	REFRAKTOMETRE CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR PİL	6	ADET				
2	TIBBİ MONİTÖR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	1	ADET				
3	ALIN İŞİĞİ ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	2	ADET				
4	RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ KOLİMATÖR AMPUL DUYU	1	ADET				
5	RADYOGRAFİ CİHAZI ROTOR KARTI	1	ADET				
6	HAVA TABANCASI BAŞLIĞI (HORTUMSUZ)	1	ADET				
7	HASTANEMİZDE KULLANILAN TJ693 MODEL 9702057 SERİ NOLU JENERATÖR İÇİN 3MT 12 MM'LİK YAKIT DÖNÜŞ HORTUMU ALIM	1	ADET				
8	ORTA BOY ÇUBUKLU GÜNİSİ TERMOSTATI ALIMI	1	ADET				
9	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK A BLOK ISITMA HATTINA SİRKÜLASYON POMPASI ALIM (MONTAJ DAHİL)	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com


MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
REFRAKTOMETRE CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR PİL
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AA HR6 tip şarj edilebilir kalem pil olacaktır.
2. 1,2 volt 1,900 mAh değerinde olacaktır.
3. Piller üzerinde yukarıdaki değerler yazılı olacaktır.
4. Yeni üretim olacak, rafta uzun süre beklemiş ürün olmayacaktır.
5. En az 6 ay garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
6. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
7. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
8. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
9. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
10. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

15.02.2021
Uz. Dr. Ömer ÖZTÜRK
Göz Hast. Uzmanı

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
TIBBİ MONİTÖR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Zondan Marka ZD120E model monitör cihazına uyumlu olacaktır.
2. 12 Volt - 2,6 Ah/20hr değerinde olacaktır.
3. + ve - uçları soket takılabilir olacaktır
4. Yeni üretim ürün olacaktır. Ölçüleri aşağıda çizimde gösterildiği gibi olacaktır.
5. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
6. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
7. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
8. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
9. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
10. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

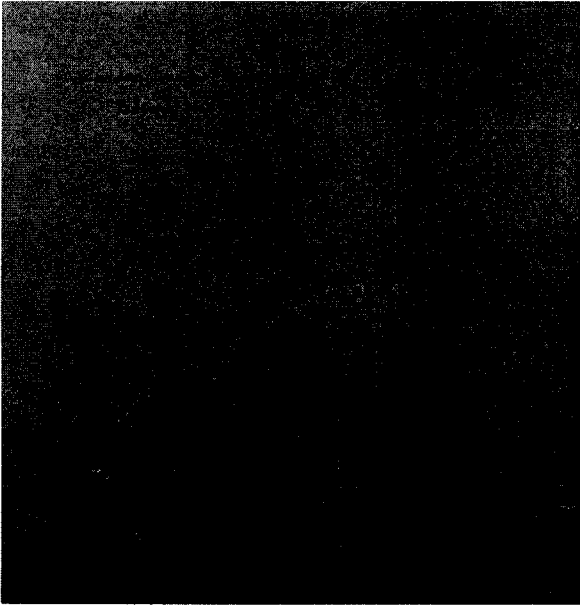

15.02.2021
Ayşe ÇİÇEK ÇİN
Dahiliye Ser. Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
ALIN IŞIĞI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Batarya 3.7 volt 2600 mAh değerlerinde olacaktır.
2. Ürün orijinal, sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
3. Yeni üretim olacak, rafta uzun süre beklemiş ürün olmayacaktır.
4. Ürün 1 yıl garantili olacaktır.
5. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
6. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
ÜBB'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

18.02.2021
Uz. Dr. Onur PAKIR
KBB Uzmanı

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ KOLİMATÖR AMPUL DUYU
TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Siemens marka AL02 II 10092604 model numaralı kolimatöre uygun olacaktır.
2. En az 6 ay garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
3. İğne uçlu halojen ampul kullanımına uygun olacaktır.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
6. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
7. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
8. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.



23.02.2021
Soner YAZICI
Radyoloji Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
RADYOGRAFİ CİHAZI ROTOR KARTI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fuji film marka FDR D-EVO SUITE model röntgen cihazına uygun olacaktır.
2. En az 6 ay garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
3. Kartın montajı anlaşmalı bakım firmamız tarafından yapılacaktır.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin, UBB barkod numarası yazılı faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
6. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
7. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
8. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.



23.02.2021

Soner YAZICI

Radyoloji Sor.

SİRKÜLASYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi pompa dairesinde bulunan 2 adet 1.5 kw değerindeki sirkülasyon pompasının mevcut yerinden demontajının yapılması, yerine aşağıda asgari özellikleri belirtilen 2 adet pompanın montajının yapılarak sistemin devreye alınması ve çalışır durumda tesliminin yapılması işlerini kapsar.

B. GENEL ŞARTLAR

Pompa değişimi yapacak firmanın;

1. Firma teklif vermeden önce mahalde keşif yapmalı, teknik servis nezaretinde mevcut sistemi yerinde inceledikten sonra yer gördü belgesi düzenlemelidir
2. ISO 9001:2015 veya 14001:2015 Kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır
3. TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır
4. Yüklenici yapacağı /yaptıracağı işlemler esnasında her türlü iş ve işçi sağlığı güvenliği için emniyet tedbirlerinden sorumlu olacaktır
5. Yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliği 6331n sayılı kanun hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır
6. Yüklenici firma yapılacak işlemler sırasında oluşabilecek her türlü iş kazasından ve bunlardan meydana gelecek maddi vb. zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır

Yukarıda belirtilen maddeleri karşılaması ve belgelendirmesi gereklidir.

C. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Firma işe başlamadan önce hastane Teknik Birimi ile irtibata geçmelidir. Yapılacak işler teknik servis sorumlusu veya teknik servis sorumlusunun görevlendirdiği teknisyen gözetiminde yapılacaktır.
2. Yapılacak planlama dâhilinde mesai saatleri veya mesai saatleri dışı çalışma için hastane idarece belirlenecek zaman diliminde çalışmalıdır.
3. Yapılacak planlama dâhilinde mesai saatleri veya mesai saatleri dışı çalışma için hastane idaresinden onay alınmalı, mesai saatleri dışında yapılacak işlemlerde de gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alınması firma yükümlülüğünde olacaktır.
4. Değişim sonrası sökülen malzemelerin belirlenen alana taşınması ve alanın temizlenmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır
5. İşlemi biten alanın temizlenmesi, kullanıma hazır hale getirilmesi devreye alınması ve pompaların amper değerleri kontrol edildikten sonra işlemin tamamlanması işleri firma sorumluluğunda olacaktır.
6. Yüklenici firma, değişim işlerinden sonra düzenleyiciyi raporları kendisi tanzim edecektir. Bu formları doldurduktan sonra refakat eden hastane teknik personelinin de imzasıyla idareye teslim edecektir.
7. İdarenin bilgisi dışında yapılan değişim işi kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Yapılacak değişim işleri esnasında kullanılması gereken her türlü teknik, temizlik vs. malzeme araç ve gereçlerin temini firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.

Adnan ERSOY
[Signature]

9. Yklenici firmadan temin edilmiř malzemeler, malzeme ve iřilik hatalarına karřı fatura tarihi esas alınarak en az 2 yıl garantili olacaktır.

D. ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Pompa gc en az 1 kw en fazla 2.5kw aralıęında olmalıdır
2. Pompa giriř ıkıř ebadı DN65 olmalıdır
3. Pompa tek hız kademeli veya pompa zerinden ayarlanabilir 3 kademeli olmalıdır
4. Pompalar salyangoz kısmıyla beraber montajı yapılmalıdır
5. Salyangoz flanř aralıęı 34 cm olmalıdır
6. Salyangoz su giriř ıkıř ebatları 60 mm olmalıdır
7. Pompa akıř hızı en az 680 lt/dk veya 40 m3/sa olmalıdır
8. Pompa TSE ve CE standartlarına uygun olarak retilmiř olmalıdır
9. Pompa en az IP 54 koruma sınıfına sahip olmalıdır
10. 380v 50 Hz voltaj/frekans deęerlerinde alıřmaya uygun 3 fazlı olmalıdır
11. Sistem zerinde en az 6 bar basın retebilecek kapasitede olmalıdır
12. Pompa sistemi -10 +110 derece arası kullanıma uygun olmalıdır
13. İzolasyon sınıfı en az Class F olmalıdır
14. Salyangoz sfero dkm veya pik dkm olarak imal edilmiř olmalıdır

Adnan E. 1507
X. 1507