



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 9817703 / 934.01 3444
KONU : 10 KALEM AYADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

15/01/2024

SAYIN

Hastanemizin ihtivacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 18/01/2024 saat 12:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetkenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 7- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 8 Doğrudan Temin usulü alın yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 9 Bu teklife davet mektubuna mutlak 18/01/2024 tarihi saat 12:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 BİYOMEDİKAL DEPO DAHİLİ : 1511
---	--

Cavit CESUR
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü V.

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	SEDYE HAREKET PİSTONU HİDROLİK (KENMAK MARKA)	4	ADET			
2	TENS ELEKTROD ARA KABLOSU	60	ADET			
3	TIBBİ MONİTÖR TANSİYON MODÜLÜ MOTORU	2	ADET			
4	KARYOLA KUMANDASI	10	ADET			
5	NEBULİZATÖR SU HAZNESİ(HAZNENİN ALTINDAKİ PARÇA İLE BİRLİKTE)	2	ADET			
6	DEFİBİLATOR CİHAZI ŞARJ EDEBİLİR BATARYA	1	ADET			
7	ULTRASONOGRAFİ YÖNETİM KONSOLU TRACK BALL-İMLEÇ DENETİM TOPU SÜNGERİ	2	ADET			
8	YANA KAYAR FOTOSELLİ KAPI İÇİN KONTROL KARTI VE TRAFO ALIMI	1	ADET			
9	ULTRASON GİRİŞİ DİTECH MARKA FOTOSELLİ KAPI MEKANİZMA DEĞİŞİMİ	1	ADET			
10	DOĞUM SALONU GİRİŞİ MEDUSA MARKA FOTOSELLİ KAPI TAŞIYICI TEKERLEK ALIMI	2	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalayasm.gov.tr/IFrames/Manavgat/DH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

OTOMATİK FOTOSELLİ KAPI ŞARTNAMESİ

MEKANİZMA VE MOTOR GRUBU:

1. Kapıların hareketini sağlayan kayış sistemi, tek motor ile çalışmalıdır. Motorların garantisi 5 yıl olacaktır.
2. Motor endüstriyel kullanıma uygun A.C. 3 fazlı tip olmalıdır. Kapının sessiz çalışması için motorların üzerinde redüktör olmamalıdır.
3. Mekanizmanın çalışma gerilimi 230 V. (A.C.), 50 Hz. olmalı ve voltaj değişmelerine karşı en az % 10 tolerans göstermelidir.
4. Mekanizma -20 °C ile 65 °C ortam sıcaklığında çalışmaya uygun olmalıdır.
5. Mekanizmanın enerjisi 150 W olmalıdır. Kanat kapanma gücü 150 N olmalıdır. Kapasite günlük 1500 açılımdan fazla olmalıdır.
6. Kapıların kapalı ve elektronik kilitli kalması dijital selektör vasıtasıyla sağlanarak, kapalı (Devre Dışı), otomatik (bütün sistem devrede) , açık (kapı açık durumda), tek yönlü (hareket ünitesi tek yönlü devrede), gece (dışarıdan kilitli, içeriden düğme ile açılabilir durumda) fonksiyonlarını içermelidir.
7. Mikroprosesör ünitesi arızası , radar ve fotosel arızası kayış gevşeme ve kopma hali ile aşırı yük ve kanatların açılırken ve kapanırken herhangi bir engelle karşılaşması halinde mekanizma üzerinde bulunan dijital selektör göstergesi ile arızayı ve yerini belirtecektir. Mekanizma devreye girdiğinden otomatik olarak açma kapama mesafelerini tayin edecektir.
8. Kapı açık kalma süresi, kanat açılma ve kapanma hızı dijital selektör vasıtasıyla ayarlanabilir olmalıdır. Ayarlanan açık kalma süresi 0-30 sn. arasında olmalıdır.
9. Mekanizmalarda ayarlanabilir minimum beş değişik açılım aralığı olmalı ve giriş trafik sıklığına göre istenen aralık seçilebilmelidir.
10. Çift kanat kapılarda kapının açılma hızı 1400 mm/sn, tek kanat kapılarda 700 mm/sn olmalıdır.
11. Güvenlik amacı ile kapıların açılma hızı kapanma hızına göre daha hızlı olmalıdır.
12. Kapanma işleminden sonra mekanizma kanatları daimi minimum 4 kg.lık bir güçle iterek kanatların tam olarak kapanmasını ve kesin sızdırmazlığını sağlamalıdır.
13. Mekanizma minimum 2x90 kg.lık kanatlar ile çalışabilir olmalıdır. (Tek kanat için 120 Kg. taşıma kapasitesi olacaktır.)
14. Mekanizma fren ve yavaş hareket alanları ayarlanabilir olmalıdır. (5 ile 50 cm. arasında)
15. Kapının kapanma ve açılma güçleri ile açılma ve kapanma hızları birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilmelidir. Bu sayede kapı kapanırken herhangi bir engelle karşılaşması durumunda zarar vermeden otomatik olarak açılabilir.
16. Çarpma sonucu hareketli kanatların raydan çıkmasını önleyecek sistemler sahip olmalıdır. (Her bir kanat ray üzerinde 59 mm çapında 4 adet ve 35 mm çapında 2 adet tekerlek ile taşınacaktır. Bunlardan 4 tanesi aşağı raya 2 tanesi yukarı raya basacaktır.) Tekerleğin üzerinde hareket ettiği ray aşındığı zaman değiştirilebilir (modüler) olmalıdır.
17. Mekanizmaya arıza veya bakım durumunda kolay müdahale edilmesi için mekanizma kapağı üstten tırnaklı olarak yerleştirilmiş olup aletsiz bir şekilde el ile açılabilir.
18. Mekanizma içerisinde elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak akü sistemi bulunmalıdır.
19. Elektrik kesilmelerinde hareketli kanatlar manuel açılabilir.
20. Mekanizma 32 bit mikroişlemci kontrollü olacaktır. İstendiği takdirde tüm kapılar merkezi bilgisayar sistemine bağlanabilme özelliğine sahip olacaktır. Merkezi bilgisayardan kapıların tüm fonksiyonları ve ayarları yapılabilecek, kapıların konumu (açık veya kapalı) ve arıza durumunda arızanın nerede olduğu görülebilmelidir.
21. Kapının periyodik (günlük, haftalık, aylık...) açılım adetleri mikro-işlemci üzerinde kaydedilmeli ve istenildiğinde teknik servis tarafından bu verilere ulaşılabilmelidir.

FOTOSEL:

22. Kapı kanatları üzerinde, yerden 110 cm. yükseklikte 1 adet fotosel kullanılacak olup, kapı kapanırken araya bir engel girmesi durumunda kapı otomatik olarak geri açılacak ve engel ortadan kalkıncaya kadar kapanmamalıdır. İstenmesi durumunda 2. emniyet fotoseli de bağlanabilmelidir.

RADAR VE DİĞER AÇMA OPSİYONLARI:

23. Kapının açılması her iki yönden radar ile olmalıdır. İstenmesi durumunda kapının açılması şifreli anahtar, el yaklaşım sensörü veya diz dirsek butonu ile yapılabilmelidir.
24. Radar canlı ve cansız cisimlerden aynı oranda etkilenebilen mikrodalga sistemi ile çalışacaktır.
25. Radar hassasiyet ayarları, gücü ve taradığı alan dijital selektör yardımıyla yapılmalıdır.
26. Mekanizmaya gerektiğinde FM alıcı, verici sistemiyle teçhiz edilerek kablosuz uzaktan kumanda imkanı verecektir. Bu uzaktan kumanda üzerinden kapının tüm fonksiyonları kontrol edilmelidir.

ALÜMİNYUM PROFİLLER VE CAM:


27. Kullanılacak alüminyum isteğe uygun renkte elektrostatik toz boya ile yapılacaktır.
28. Kanatlarda kullanılacak profiller minimum 1.5 mm et kalınlığında ve 40 mm genişliğinde, mekanizma kasasında kullanılacak profil ise minimum 5 mm et kalınlığında 100 mm yüksekliğinde olmalıdır.
29. Kanat köşelerinde alüminyum profiller siyah takozlar ile birbirine bağlanmalıdır.
30. Kanat bileşiminde kullanılacak fitiller ile tam sızdırmazlık sağlanmalıdır.
31. Tüm hareketli ve sabit kanatlarda idare isteği doğrultusunda 10 mm kalınlığında şeffaf veya süt lamine cam kullanılmalıdır.
32. Camlar doğramaya özel EPDM fitiller sızdırmazlığı temin edilerek monte edilmelidir.

GENEL:

33. Firmaların her türlü imalat ve montaj hatalarına yönelik 2 sene ücretsiz bakım ve onarım hizmeti; ve garanti dışında kalacak maddelerde ücreti mukabilinde olmak üzere sisteme yönelik her türlü yedek parça 10 yıl süre ile temin etme ve saha uygulamalarını yapabilme alt yapısına sahip olmaları gerekmektedir.
34. Firmalar daha önce yaptıkları otomatik fotoselli kapı imalatlarıyla ilgili iş deneyimlerini ilgili kurumlardan aldıkları en az işin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesi ve/veya referans mektubu ile belgelemek zorundadır.
35. Üretici firma ve kapıya ait TSE, ISO 9001, CE ve TUV belgeleri olacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu


Muzaffer ÇINAR
Elektrik Teknisyeni

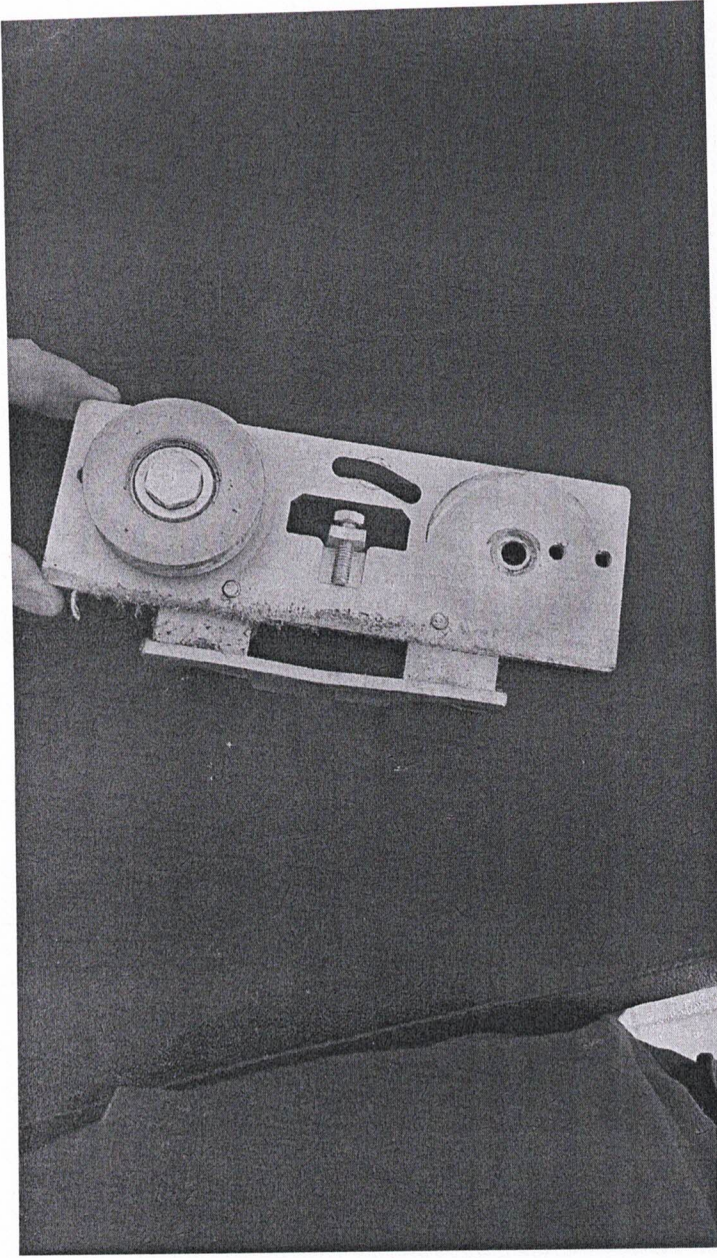

DOĞUM SALONU GİRİŞİ MEDUSA MARKA OTOMATİK KAPI TAŞIYICI TEKERLEK

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmüş KURT
Teknik Birim Sorumlusu


Muzafer ÇAKAR
Elektrikçi

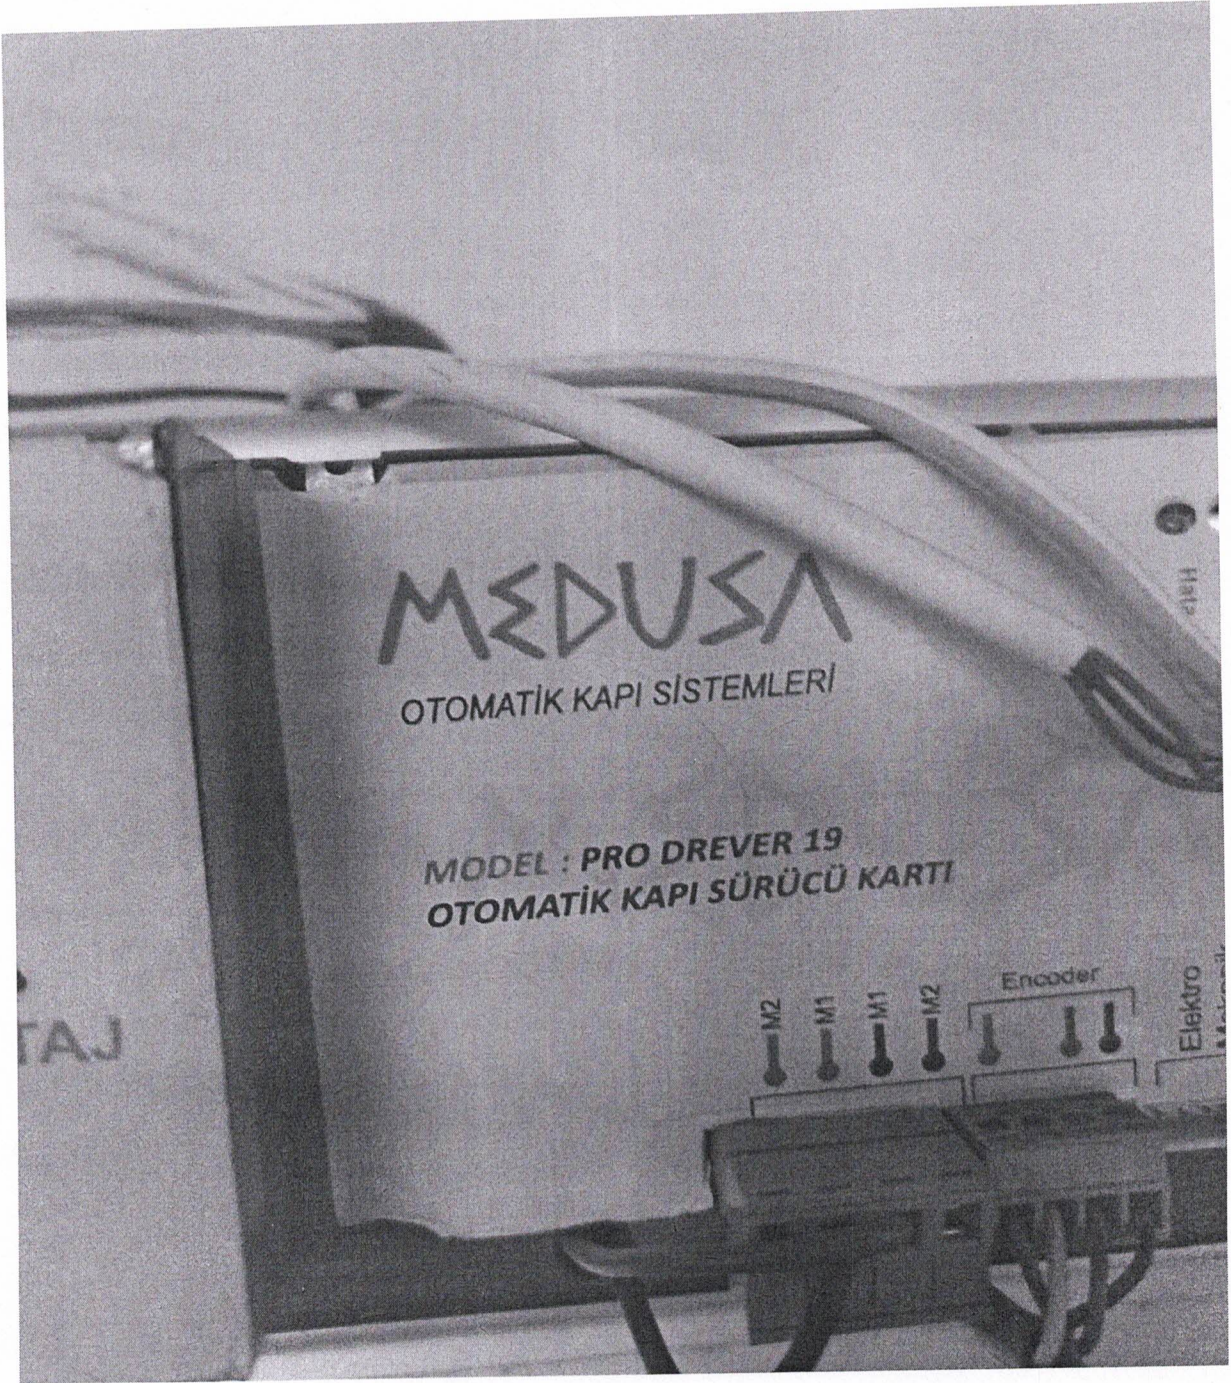

ACİL SERVİS CPR OTOMATİK KAPI KONTROL KARTI VE TRAFOSU :

Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TANIRBAS
İnşaat Teknikeri

Hoşun AYSAR
Elk. *[Signature]*

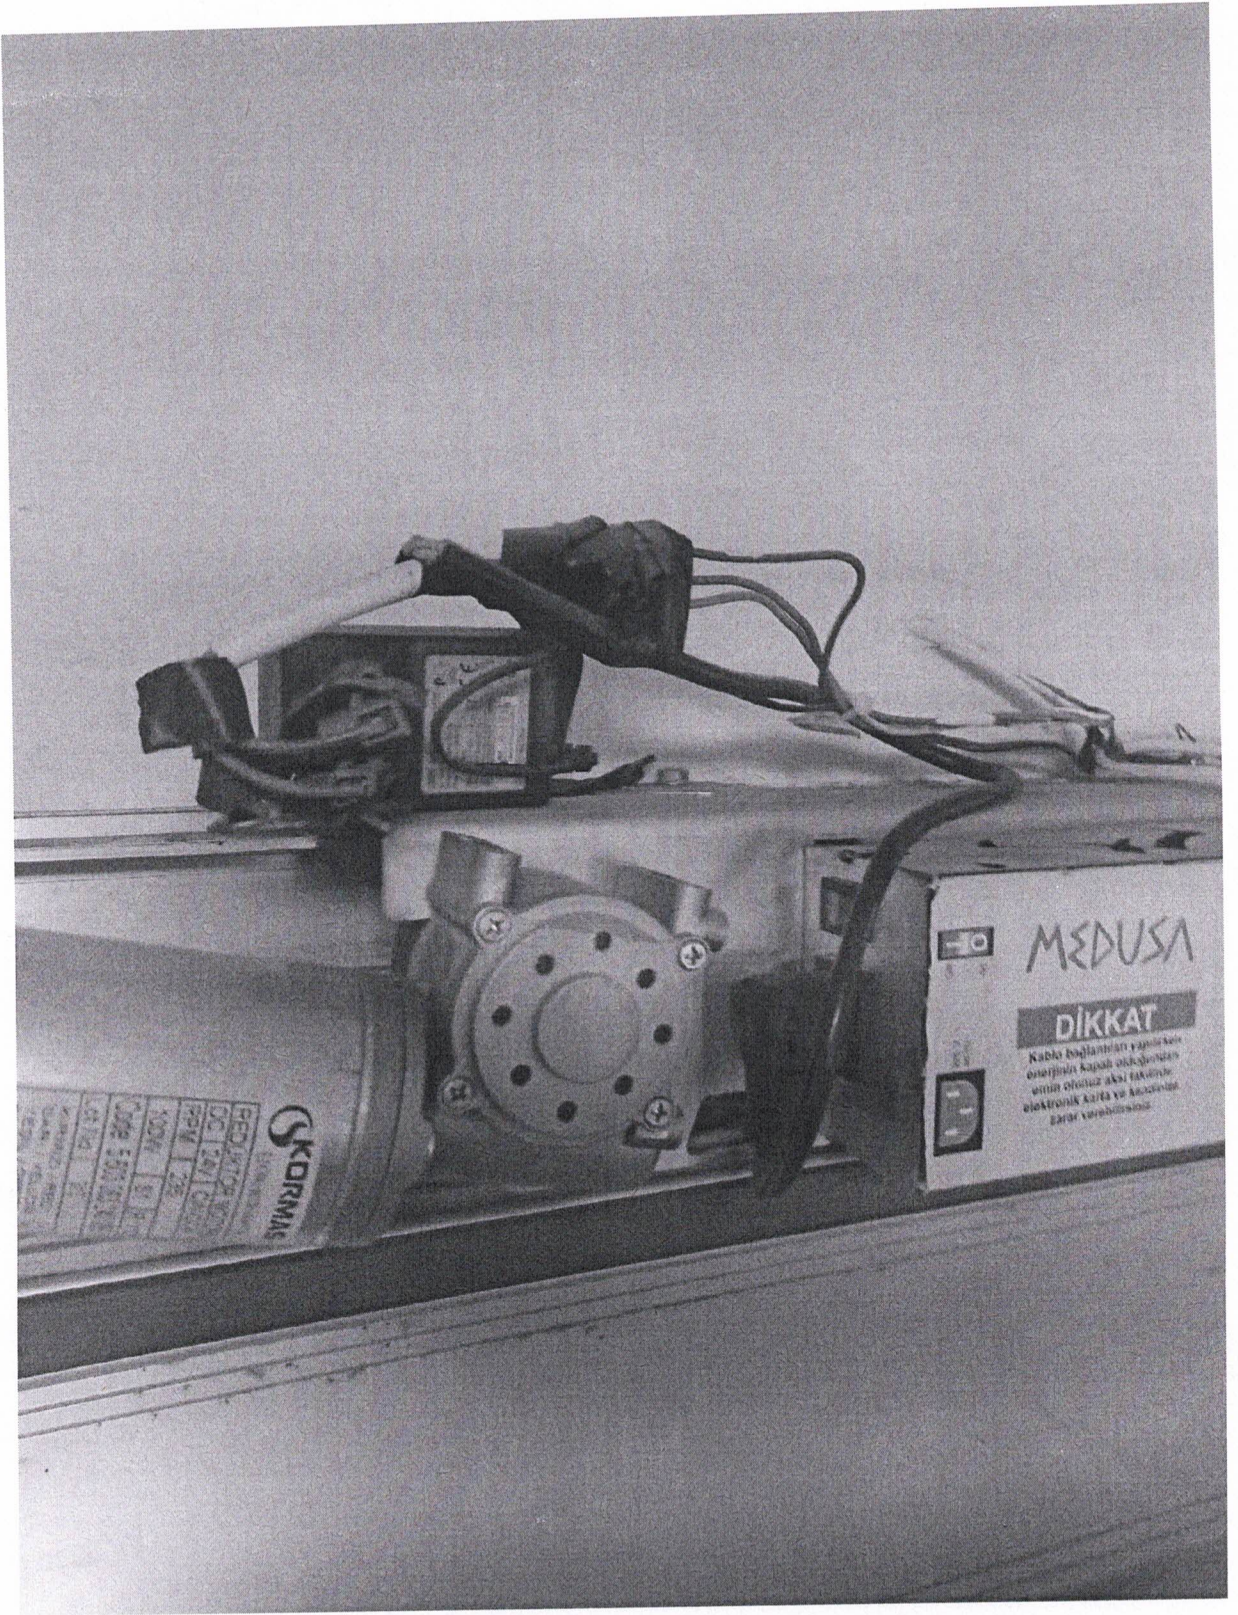

Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TAN AĞIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

Hozeyin AUSA
E.



Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TANIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

Hocanın Auzar
E. Y. T. K.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
NEBULİZATÖR SU HAZNESİ (HAZNENİN ALTINDAKİ PARÇA İLE BİRLİKTE)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. HİKONEB marka, 906 S model NEBULİZATÖR CİHAZINA uyumlu olmalıdır.
2. Su haznesinin oturduğu , cihazla birleştiği yerdeki siyah parça ile birlikte verilecektir.haznenin oturduğu kısım kırık olduğu için hazneyi görmemektedir.
3. En az 6 ay garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
6. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
7. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
8. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

19.12.2023
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

19.12.2023
Osman YILMAZ
Biyomedikal Tek.

19.12.2023
Yasemin ÖZCAN
Acil Servis Soru

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
DEFİBRİLLATÖR CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BURDICK marka, MEDIC 5 model DEFİBRİLLATÖR CİHAZINA uyumlu olmalıdır.
2. 24 VOLT şarj edilebilir özellikte olmalıdır. 10 x11x4 cm ölçülerinde olmalıdır.4 uçlu yaklaşık 5 cm uzunluğunda kablolu soketi olmalıdır.
3. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
6. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
7. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
8. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

19.12.2023
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

19.12.2023
Osman YILMAZ
Biyomedikal Tek.

19.12.2023
Münevver ARDA AYDIN
Genel Cer. Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
ULTRASONOGRAFİ YÖNETİM KONSOLU TRACK BALL - İMLEÇ DENETİM TOPU SÜNGERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TOSHIBA marka, APLIO 500 model EKOKARDİYOĞRAFİ CİHAZINA uyumlu olmalıdır.
2. Denetim topunun hareket etmesini sağlamalıdır. Talep edilen malzemenin montajı hastanemiz biyomedikal atölyesi tarafından yapılacaktır.
3. En az 6 ay garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
6. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
7. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
8. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

19.12.2023
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

19.12.2023
Osman YILMAZ
Biyomedikal Teknikeri

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

KARYOLA KUMANDASI

TEKNİK ŞARTNAME

1. El kumandası Universal 4 motorlu yataklarda (MESPA,KENMAK,IŞIK KARDEŞLER , DOLSAN, YÜKSELİŞ) kullanılabilir olmalıdır.Standart pozisyon verebilme fonksiyonlarını yerine getirmelidir.
2. En az bir yıl garantili olmalıdır.
3. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
4. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
5. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
6. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
7. UBB'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

19.12.2023
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Mühendisi

19.12.2023
Osman YILMAZ
Biyomedikal Tek.

19.12.2023
Tolga ÖZTİN
Biyomedikal Teknikeri


MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
TIBBİ MONİTÖR TANSİYON MODÜLÜ MOTORU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TMS marka, FX1 model TIBBİ MONİTÖR cihazına uyumlu olmalıdır.
2. 12 Volt olmalıdır.
- 3.
4. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
5. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
6. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TITUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
9. TITUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

20.12.2023
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

20.12.2023
Tolga ÖZTİN
Biyomedikal Teknikeri

20.12.2023
Keziban ZEDELİ
Yoğun Bakım Sor.

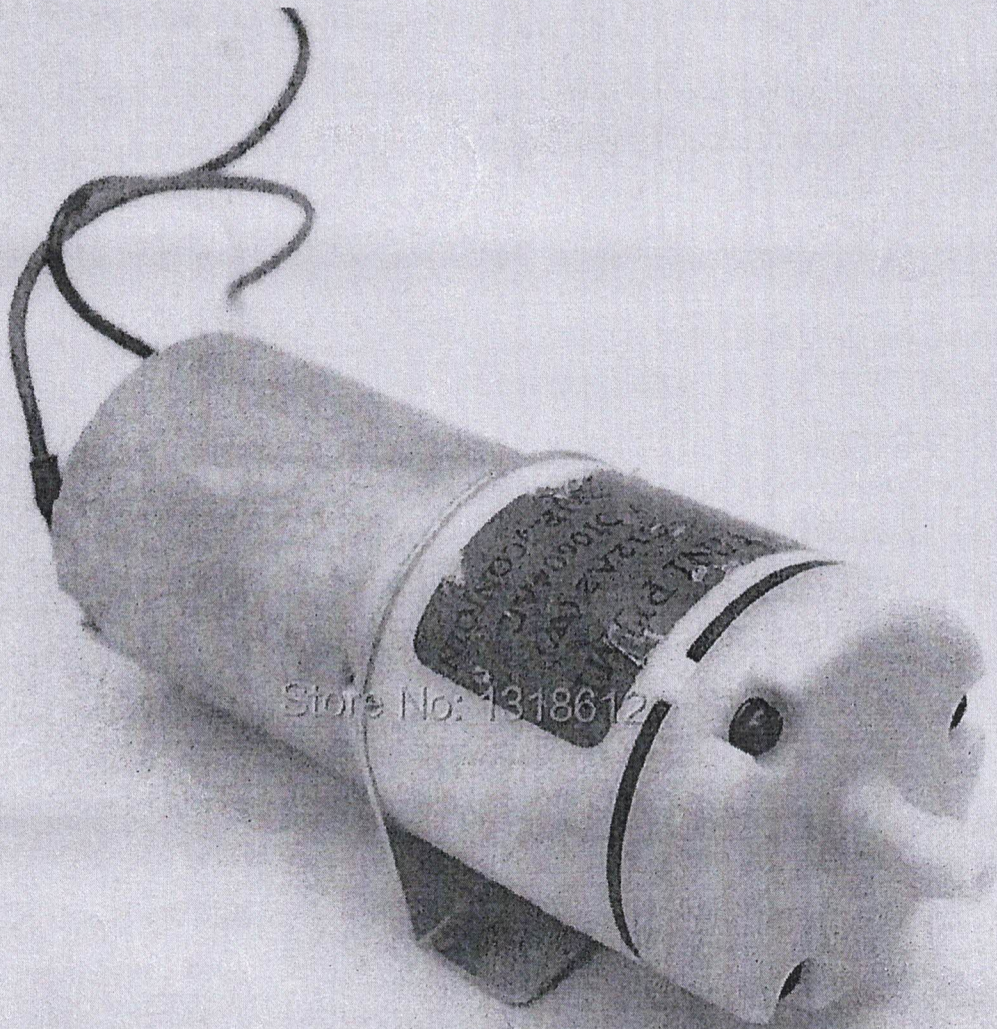

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
TENS ELEKTROT ARA KABLOSU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. FİZYOMED marka,FİZYOTENS 6000 model TENS CİHAZINA uyumlu olmalıdır.
2. Kablo uzunluğu en az 2 metre olmalıdır.
3. Kablonun + / - kutuplarının ayırt edilmesi için uçlar farklı renkte olmalıdır.
4. Kablo alkol , dezenfektan vb. gibi ürünlerle temizlenmeye dayanıklı malzeme yapısına sahip olmalıdır.
5. En az 1 yıl garantili, orijinal sıfır, hiç kullanılmamış ürün olacaktır.
6. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
7. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
8. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
9. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
10. TİTUB/ÜTS'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

21.12.2023
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Müh.

21.12.2023
Fatma AVCI BEDEŞ
Fizik Tedavi Sal.Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
SEDYE HAREKET PİSTONU HİDROLİK (KENMAK MARKA)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KENMAK marka K034T model hasta transfer sedyesine uyumlu olmalıdır.
2. Talep edilen piston 300 N değerinde olmalıdır.
3. Pistonun boyu açık halde yaklaşık 51 cm olmalıdır.
4. En az bir yıl garantili olmalıdır.
5. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
6. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
9. UBB'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

21.12.2023
Şerife ÖZCAN
Biyomedikal Mühendisi

21.12.2023
Tolga ÖZTİN
Biyomedikal Tek.

21.12.2023
Yasemin ÖZCAN
Acil Ser. Sor.