



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 3841
KONU : 9 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

02/04/2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/e (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **04/04/2024** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **04/04/2024** tarihi saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 TEKNİK SERVİS DAHİLİ : 1407 - 1406
---	--

Cavir CESUR
İdari ve Mali İşler Müdürü V.


				BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	KLEMENS 3 NO	50	ADET			
2	KLEMENS 4 NO	50	ADET			
3	0,75 KABLO	400	METRE			
4	5 WATT 6500 K E 14 AYNA ÜSTÜ ARMUT AMPUL	250	ADET			
5	ERKEK FİŞ (UPS'Lİ 90 DERECE)	100	ADET			
6	ERKEK FİŞ (UPS'Lİ YUVARLAK)	50	ADET			
7	SIVA ÜSTÜ PRİZ	25	ADET			
8	HAREKET SENSÖRLÜ AMPUL	50	ADET			
9	SIVA ÜSTÜ ZİL BUTONU	10	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antaliasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>


BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kase imzalı teklifler değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

KLEMENS NO:3 (50 ADET)

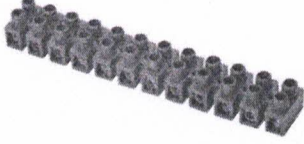

KLEMENS NO:4 (50 ADET)

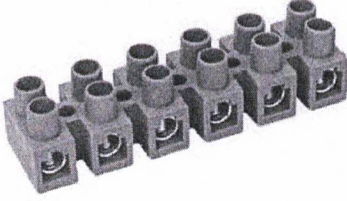

2*0,75 KABLO(400 MT)

*0,75 KORDON YASSI KABLO

TAM BAKIR

TAM KESİT--TAM METRAJ

TSE

YASSI KABLO

2*0,75 MM KABLO

YIRTILMAZ DIŞ İZOLELİ 1. KALİTE KABLO
BAKIR KABLO

Manavgat Devlet Hastanesi
Abdullah Çirlik
Mühür (Elektrik)


Manavgat Devlet Hastanesi
Dürmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

AYNA ÜSTÜ (E14)ARMUT AMPUL (250 ADET)


5 WATT 6500 K (E14) ARMUT AMPUL-BEYAZ IŞIK

ERKEK FİŞ (UPSLİ,90 DERECE)(100 ADET)

ERKEK FİŞ (UPSLİ YUVARLAK)(50ADET)

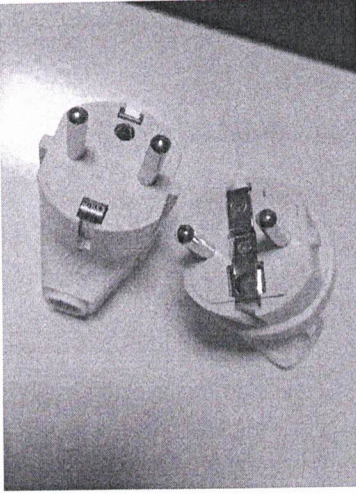

SIVA ÜSTÜ PRİZ TOPRAKLI(25ADET)

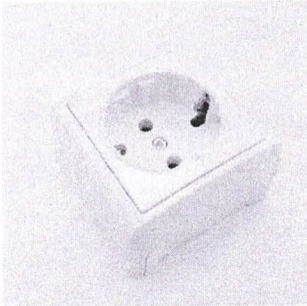


Manavgat Devlet Hastanesi
Abdullah CİRİK
Memur (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmüş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

HAREKET SENSÖRLÜ AMPUL(50ADET)

12 WATT 220 VOLT




Gerilim: 220-240 V

Işık Akısı (Nominal): 740 lm

Çalışma Sıcaklığı: -20 °C ~ +40 °C
Enerji Verimliliği Sınıfı: A+
Dim Özelliği: Dim edilemez.
Ürün Ömrü (Anma): 15.000 saat
Renk Sıcaklığı: BEYAZ (6000K)
Nominal Güç: 12 W
Ürün Ölçüleri: 60x110 mm
Cıva Miktarı: Cıva içermez.
Duy Tipi: E-27

SIVA ÜSTÜ ZİL BUTONU(10 ADET)

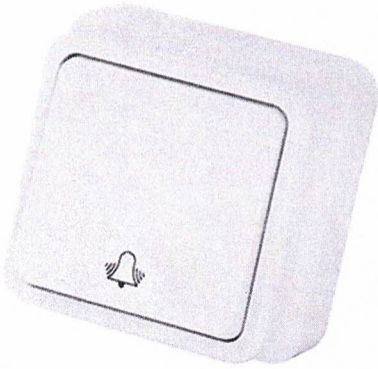

Manavgat Devlet Hastanesi
Abdullah CIRIK
Memur(Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmus KURT
Teknik Birim Sorumlusu