



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

3844

KONU : 5 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

02/04/2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **04/04/2024** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **04/04/2024** tarihi saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 TEKNİK SERVİS DAHİLİ : 1407 - 1406
---	--

Cavir CESUR
İdari ve Mali Hizmetler Müdür V.

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	M 12*1000 MM TİJ	5	ADET			
2	M12 DÜZ PUL	500	GRAM			
3	M16 SOMUN	50	ADET			
4	PİMLİ KOLTUK TEKERLEĞİ	200	ADET			
5	SİLİNDİRLİ GÖMME KAPI KİLİDİ	50	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE VERİLEN ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.


<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışındaki alanlar kase imzalı teklifler değerlendirilmez dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com

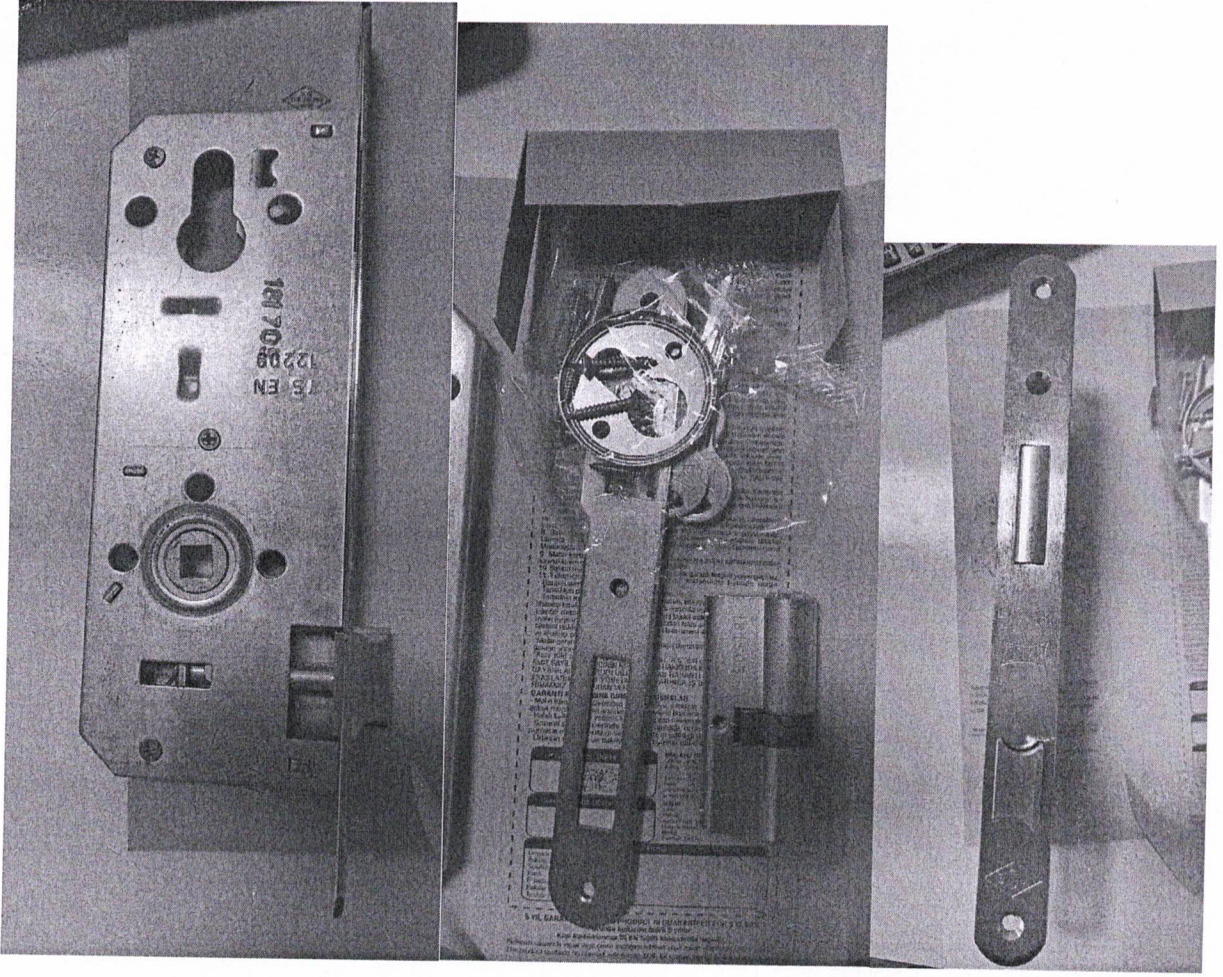

NOT:

Talep edilen malzemeden bir adet numune idareye teslim edilmeli, numune hastanede bulunan kapılara uyum sağlayıp sağlamadığı teknik servis tarafından kontrol edildikten sonra uygunluk verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
TANIRAGIRBAS
İnşaat Teknikeri



Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Bölüm Sorumlusu

Kale 152R Silindirli Rozet Delikli Nikel Oval Dış Kapı 40 mm Kilit



Manaygat Devlet Hastanesi
Burmüş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

PİMLİ OFİS KOLTUK TEKERLEĞİ(PLASTİK)(200 ADET)

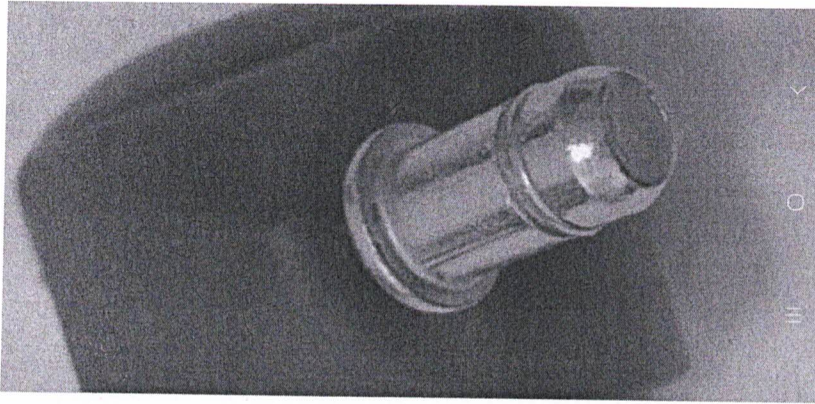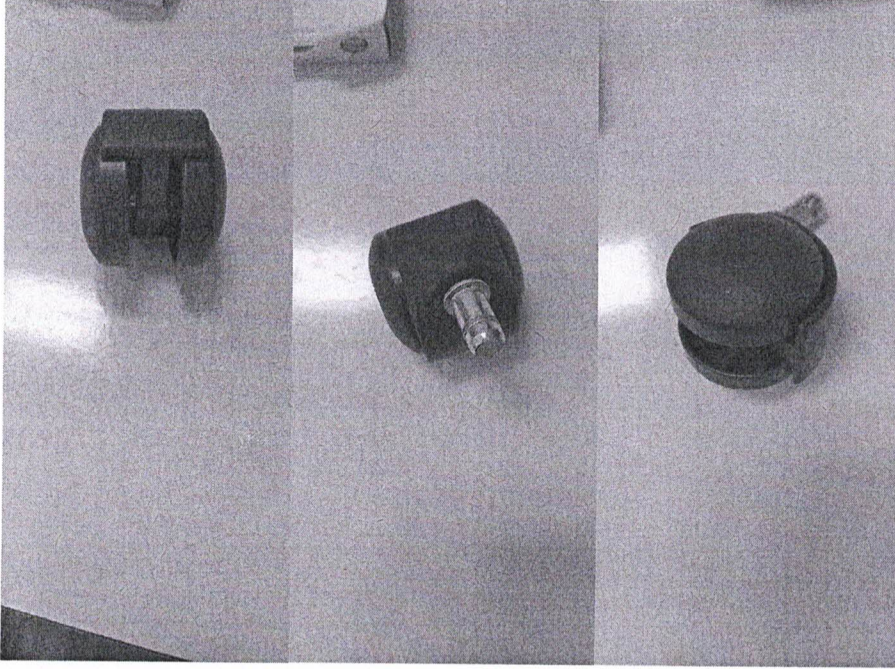

Ürün Özellikleri;



- Tekerlek çapı: 50 mm
- Tekerlek genişliği (tekerlek başına) : 17 mm
- Pim ölçüsü: 11 mm
- Ağırlık kapasitesi (adet başına): 35 kg
- Ürün yüksekliği: 68 mm
- Renk: Siyah

Manavgat Devlet Hastanesi
Alev Nazan TAN AGIRBAŞ
İnşaat Teknikeri

Manavgat Devlet Hastanesi
Dursun KURT
Teknik Birim Sorumlusu

M16 SOMUN (50 ADET)


M12 TİJE UYGUN OLACAK.

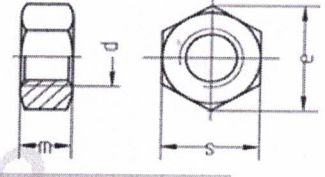	DIN 934 ISO 4032 ALTİKÖŞE SOMUN											
d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	
m	2,40	3,20	4,70	5,00	6,50	8,00	10,00	13,00	16,00	19,00	24,00	
e	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	18,90	21,10	26,75	32,95	39,55	50,85	
s	5,50	7,00	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00	24,00	30,00	36,00	46,00	

M12*1000 MM TİJ (5 ADET)

M12x1000 Mm Saplama Galvanizli Gijon Rot Tij Başsız Civata

Ürün Ölçüsü	1metre
Model	Vida
Çift Taraflı Vida	Evet
Paket İçi Adet	1 Adet
Çap	12 cm
Renk	Gri
Malzeme	Çelik

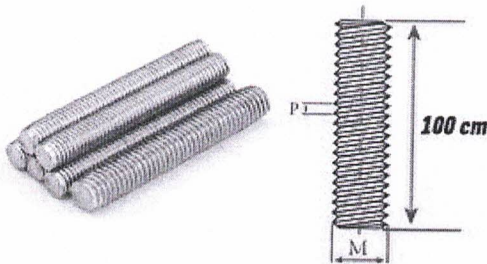


Ölçü: mm (milimetre)					
(M)	(P)	(M)	(P)	(M)	(P)
Metrik	Dış Adımı	Metrik	Dış Adımı	Metrik	Dış Adımı
M3	0.5	M14	2	M30	3.5
M4	0.7	M16	2	M33	3.5
M5	0.8	M18	2.5	M36	4
M6	1	M20	2.5	M39	4
M8	1.25	M22	2.5	M42	4.5
M10	1.5	M24	3	M45	4.5
M12	1.75	M27	3	M48	5

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan SAHİN
Sürekli İşçi (Sihhi Tesisat)

Manavgat Devlet Hastanesi
Dünyasız RURT
Teknik Birim Sorumlusu

METAL DÜZ PUL(M12)(50 ADET)

M12 TİJE UYGUN OLACAK.



FLAT WASHER
DÜZ PUL
SCHEIBEN

Technical Informations. / Teknik bilgiler.

Thread size / Arma çapı	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39
Hole dia / Delik çapı	d1	3,2	4,3	5,3	6,4	7,6	8,4	10,5	13	15	17	19	21	25	28	31	31	37	40
	max.	3,38	4,48	5,48	6,62	7,82	8,62	10,77	13,27	15,27	17,27	19,33	21,33	25,33	28,33	31,39	34,62	37,62	40,62
Outside dia / Dış çap	d2	7	9	10	12	14	16	20	24	28	30	34	37	39	44	50	56	60	72
	min.	6,64	8,64	9,64	11,57	13,37	15,57	18,48	23,48	27,48	29,48	33,58	36,38	38,38	43,38	49,38	55,36	58,8	70,8
Thickness / El kalınlığı	h	0,3	0,8	1,0	1,6	1,6	1,6	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0
	+/-	0,05	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6
Weight / Ağırlık	g/p	0,119	0,308	0,443	1,02	1,39	1,33	3,57	6,27	8,62	11,3	14,7	17,2	18,3	32,3	42,3	53,8	75,3	92,1

Values are given in millimeters. / Değerler milimetre olarak verilmiştir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan ŞAHİN
Sürekli İşçi (Sıhhi Tesisat)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmış KURT
Teknik Birim Sorumlusu