

T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 4 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

21/04/2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **26/04/2021** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **26/04/2021** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN  
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

| S.NO         | MALZEMENİN ADI                               | MİKTARI | BİRİMİ | SUT KODU /<br>TEKNİK<br>ŞARTNAME | MARKA / MODEL / U.B.B<br>KODU | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|--------------|----------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 1            | SMEAR FIRÇASI                                | 2.500   | ADET   |                                  |                               |             |              |
| 2            | SOĞUK BLOK (PCR COOLER)                      | 2       | ADET   |                                  |                               |             |              |
| 3            | OTOMATİK PİPET STANDI (MİKROPİPET<br>STANDI) | 3       | ADET   |                                  |                               |             |              |
| 4            | PCR TÜP (0,2 ML-SEKİZLİ PİPET)               | 44,000  | ADET   |                                  |                               |             |              |
| GENEL TOPLAM |                                              |         |        |                                  |                               |             |              |

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA


TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

## STERİL SMEAR FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1- Fırça hasta serviksindeki endoserviks ve ektoserviks kısımlarındaki hücrelerin optimal olarak alınabilmesi için dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Uygulamada maksimum kültür alması için temas uçları ortada en uzun kenarlara doğru simetrik olarak iki yönlü kısalan fırça şeklinde olmalıdır.
- 3- Fırçanın sap uzunluğu 16-20 cm olmalıdır.
- 4- Fırça dokuya zarar vermemesi için yumuşak yapıda olmalıdır.
- 5- Tek kullanımlık steril paketlerde olmalıdır.
- 6- Paket üzerinde üretim, son kullanım tarihi ve barkod numarası olmalıdır.
- 7- Ürünler en az 2 ( iki ) yıl miadlı olmalıdır. Miad bitimine en az 3 ay kala değişimi yapılmalıdır.
- 8- Bozuk ve deforme olmuş ürünler yenileriyle değiştirilmelidir.
- 9- Smear fırçaları hastanemiz kadın doğum uzmanları tarafından kullanışlı olmadığı tespit edildiğinde yeni ürünle değişimi yapılmalıdır.

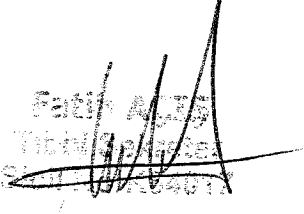A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'Fatih ALİŞ' at the top, 'Tıbbi Mikrobiyoloji' in the middle, and 'Sıhhi Müdürlüğü' at the bottom.

## PCR COOLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.PCR soğutucu 1 sat boyunca 0°C (-20°C'de 2 saat ön soğutma ile) numune sıcaklığını korumalı ve daha sonra sıcaklık 7°C'yi aştığında renk değiştirmeli.
2. Rengi değişimi ile, PCR soğutucu 7°C sıcaklık tavanını ne zaman aşıldığını göstermelidir. Hassas numunelerin korunması, taşınması ve depolanması ve reaksiyonların güvenli şekilde durdurulması için gereklidir.
- 3.Özel koni konturu ile numunelerin donmasını engellemelidir.
- 4.0,2 ml, 0,5 ml reaksiyon tüpleri /PCR tüpleri, tüp şeritleri, PCR plakları için uygun olmalıdır.
- 5.PCR soğutucu 96 oyuklu olmalıdır.


İstanbul T.C. Hastanesi  
Doç. Dr. N. N. COŞAR  
Tıp Fak. No: 79133  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı



## OTOMATİK PİPET STANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 4 adet pipet taşıma tablası olmalıdır.
2. Kullanımda yer ve hacim tasarufu sağlamalıdır.
3. Stand polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
5. Değişik model ve markalı pipetlere uyumlu taşıma tablasına sahip olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. Mediha COŞAR  
Dp.Tes.No:79133  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.



## PCR T P TEKNİK  ZELLİKLERİ

1. Saf propilen(PP)'den  retilmiř 8 mikrot pl , beyaz PCR řeritleri halinde olmalıdır.
2. Mikrot pler 0,2 ml hacminde olmalıdır.
3. Roche Light Cycler 96 cihazına uyumlu, cihazın  stten okuma yapabilmesine olanak saęlayan stripler olmalıdır.
4. Mikrot pler hızlı ve homojen ısı transferi saęlayan ultra ince duvarlara sahip olmalıdır. DNaz, RNaz, DNA ve endotoksin i ermemelidir.
5. Mikrot pler, numune buharlařmasını azaltacak sıkı kapaklar i ermelidir.
6. Mikrot p kapakları 8'li, řeffaf olmalı, DNaz-RNaz- insan DNA'sı i ermemeli, kolay a ılıp sıkı kapanabilmelidir.
7. Teklif edilen  r n denendikten sonra kabul edilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. Alihan COřAR  
Diyadin Telefon: 79133  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı