

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -445
KONU: 21KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM

09/04/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **12/04/2019** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **12/04/2019** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks, m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.
- 11- Teknik şartnamede numune istenen kaleler için numune gönderilecektir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Harun KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	AIRWAY NO : 2 BEYAZ	20	ADET				
2	AIRWAY NO : 3 YEŞİL	100	ADET				
3	WREP KAĞIDI 26X26 CM	10.000	ADET				
4	WREP KAĞIDI 56X26 CM	7.000	ADET				
5	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:5,5	1	ADET				
6	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:6	1	ADET				
7	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:6,5	1	ADET				
8	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:8	5	ADET				
9	ELDİVEN STERİL NO: 8 CERRAHİ	600	ADET				
10	ELDİVEN ANTİALLERJENİK NO: 8 CERRAHİ PUDRASIZ	500	ADET				
11	FOLEY SONDA NO: 16	200	ADET				
12	DOUBLE J KATETER 4,7 F 26MM	50	ADET				
13	BİPOLAR KESİCİ LOOP	30	ADET				
14	KARACİĞER SÜTURU 40MM 1/2 NO:0	12	ADET				
15	KARACİĞER SÜTURU 40MM 1/2 NO:1	24	ADET				
16	STAPLER DAİRESEL DST ÇAPI 28-31-34 MM KARTUŞU	2	ADET				
17	DÜZ KAPATICI KESİCİ STAPLER 80-4,8 MM KARTUŞU	2	ADET				
18	DÜZ KAPATICI KESİCİ STAPLER 80-4,8 MM	2	ADET				
19	DÜZ KAPATICI KESİCİ STAPLER 80-3,8 MM KARTUŞU	2	ADET				
20	DÜZ KAPATICI KESİCİ STAPLER 80-3,8 MM	2	ADET				
21	KANAMA DURDURUCU(BAKRİ) BALON	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

20 KALEM TIBBİ SARF MALZEME GENEL HÜKÜMLERİ

- Alımı yapılması istenilen ürünler acil ihtiyaç olup, firmalar siparişi takiben en geç 10 gün içerisinde ürünleri faturasıyla birlikte Tıbbi Sarf Depo-Eczane'ye teslim etmelidirler.
- Fatura üzerinde ilgili malzemenin adı, barkodu, son kullanım tarihi, Sut kodu, firma tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- Ürünler ÜTS'de kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- 5., 6., 7., 8., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. Kalemlerde numune değerlendirilmesi yapılacaktır.

1-2. Kalem Air way No:2 ve no:3 Teknik Özellikleri

1. İhtiyaç listesinde yazılan ölçülerde olmalıdır.
2. Travma oluşturmeyen yumuşak ve şeffaf bir malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Kolay yerleştirmeyi sağlayan kıvrıma sahip olmalıdır.
4. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalıdır.
5. Aspirasyon kateter geçişine uygun ısırma bloğuna sahip olmalıdır.
6. Dişleri hasardan koruyan esnek bir yapıya sahip olmalıdır.
7. Non -steril tek tek paketlenmiş olmalıdır.

3.-4. Kalemler Wrap Kağıdı 26*26, 56*26 Teknik Şartnamesi

- 1.Buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
- 2.Mertekaresi 60gr.(+/- 3) ağırlığında olmalıdır.
- 3.Paketleme ve sterilizasyon esnasında açma süreçlerinde hiçbir kat bırakmayacak yumuşaklığa ve esnekliğe sahip olmalıdır.
- 4.Ambalajın hiçbir yüzeyinde kesinlikle tüylenme ve tiftiklenme olmamalıdır.
- 5.Çift kat ambalaj içinde olmalıdır.İlk ambalaj plastik poşet olmalı,ikinci ambalaj dayanıklı karton paket olacak, depo yerleştirmesinde kutular ezilmeyecek sağlamlıkta olacaktır.
- 6.Paket içindeki wrap kağıtları (büyük boy kağıtlar) sadece bir yönde katlanacaktır.
- 7.Paket içindeki wrap sayısı paket üzerine mutlaka yazılacak,paketler bir kişinin rahatça taşıyabileceği ağırlıkta ve sayıda olacaktır.

5.-6.-7.-8.Kalemler Trakeosomi Kanülü (Plastik) 5,5-6-6,5-8 numaralar Teknik Şartnamesi

1. Kanül toksit olmayan şeffaf termoplastik PVC den imal edilmiş olmalıdır.
2. Kafi düşük basınç yüksek hacim özelliğine ek olarak yumuşak ve trakeal mukozaya daha az zarar veren Soft Seal yapıda ve en az temas edecek özel profil kesimli olmalıdır.
3. Kaniilün açısı uygun yerleşimi sağlamak için 105 derece olmalıdır.
4. Kanülün tam yerinde olduğunun tesbiti için radyopak çizgisi olmalıdır.
5. Kanülün içindeki mandreni kanüle tam oturmalı ve sağa yada sola çevirerek çıkarılmalıdır.
6. Kanüllerin istenen numaraları bulunmalıdır.
7. 15 mm'lik tüm standart bağlantılara uymalıdır.
8. Kanülün içindeki madrende quidewire'in içinden geçebileceği bir tünel olmalıdır.



9. Yoğun bakımda trakeostomi açılan hastaların kanüllerinin değişim için mardan içerisinde mutlaka quidewire deliği olmalıdır.

9.KALEM STERİL ELDİVEN No:8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ


1. Pudralı olmalıdır,
2. Eldivenin lateks protein içeriği, kullanıcının doğal kauçuk lateks alerji riskini ve ön hassasiyetini minimize etmek amacıyla 50 ug/gr'dan küçük olmalıdır. Tip IV hızlandırıcı kimyasallara karşı allerji oluşumu riskini önlemek amacıyla da Thiuram ve MBT hızlandırıcı kimyasalları içermemelidir. Bu hususlar için eldiven kimyasal içerik testi ve akredite laboratuvar test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
3. Lateks' ten imal edilmiş olmalıdır.
4. Kolayca açılabilen dış paket, iç paketin steril kalmasını sağlamalı ve eldivenleri zararlı ozan ışınlarından korumalıdır,
5. İç paketler, eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır.
6. İç paketlerde eldivenin boyu ve markası yazılı olmalıdır.
7. Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
8. En fazla 100 adetlik kutularda teslim edilmelidir.
9. Gerilme ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır

10.KALEM STERİL ELDİVEN no:8 PUDRASIZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Pudrasız olmalıdır,
2. Eldivenin lateks protein içeriği, kullanıcının doğal kauçuk lateks alerji riskini ve ön hassasiyetini minimize etmek amacıyla 50 ug/gr'dan küçük olmalıdır. Tip IV hızlandırıcı kimyasallara karşı allerji oluşumu riskini önlemek amacıyla da Thiuram ve MBT hızlandırıcı kimyasalları içermemelidir. Bu hususlar için eldiven kimyasal içerik testi ve akredite laboratuvar test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
3. Gerilme ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır,
4. Lateks' ten imal edilmiş olmalıdır.
5. Kolayca açılabilen dış paket, iç paketin steril kalmasını sağlamalı ve eldivenleri zararlı ozan ışınlarından korumalıdır,
6. İç paketler, eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır.
7. İç paketlerde eldivenin boyu ve maskası yazılı olmalıdır.
8. Paketler üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
9. En fazla 100 adetlik kutularda teslim edilmelidir.

11.KALEMLER FOLEY SONDA no:16 2 YOLU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Katater balonlu ve iki yollu olmalıdır,
2. Silikon ve lateks karışımından(silikolateks) yapılmış olmalıdır. Bu hammaddenin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır,
3. Doğal lateksten yüksek moleküler ağırlıklı bir silikon bileşikte saflaştırılarak elde edilmiş olmalıdır,
4. Anhidroz, kimyasal olarak çapraz bağlı olmalıdır,
5. Non allerjen olmalıdır
6. Hem ısıya hem eskimeye oldukça dayanıklı olmalıdır,
7. Fizyolojik olarak zararsız olmalıdır,
8. Suyu emmemeli, hidrofobik olmalıdır. Bu sayede kan, kan pıhtısı, serum, idrar vs. dahil olmak üzere suda çözünen veya su içeren yapışkan özellikte maddelerin ürünün yüzeyi üzerinde kalıntı yapmaması ve birikimi önlemiş olmalıdır,
9. Dış yüzey ve lümenin iç yüzeyi sabit olarak sürekli ince bir silikon tabakası ile kaplı olması, silikon sürekli terleyip ayrılma özelliğinde olmalı, bu sayede silikon yüzey aktif deterjanlarla yıkansa ve yok olsa bile otomatik olarak lateks materyali dışına terlediği için kendini yenilemelidir,

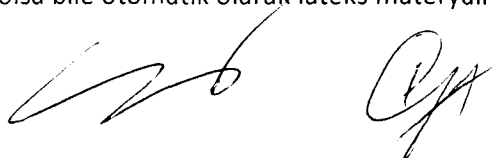

10. İki yoldan birisi idrar torbasına bağlanacak şekilde hunili, birisi de balonu şişirme yolu olmalıdır,
11. Balon şişirme valvi luer ve luer uyumlu şırınga uçlarına uyumlu olmalıdır,
12. Ürün tekli steril ambalajlarda ve tek kullanımlık olmalıdır,
13. Kataterin boyu yaklaşık en az 40 cm. + 1 cm olmalıdır ,
14. Dış çapı 6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. Ve 22 ch olmalıdır,
15. Balon kapasiteleri 30-50 ml olmalıdır.Balon homojen olarak şişebilmelidir.
16. Uluslararası standartlara uyumlu olmalıdır.
17. Ürün orjinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde ve iç steril ambalaj üzerinde son kullanım tarihi ürünün boyu vede lot numarası yazılı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ecz Ezgi TOPÇU OTAY
Dip Tes. No: 49742

Manavgat Devlet Hastanesi
CHAYATILAY
Mal Kayıt ve Kont. Yet.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

KANAMA DURDURUCU BALON ŞARTNAMESİ

- 1- Doğum sonrası kanama kontrolünde ve yönetiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Uterun boşluğu içinde hızlıca tampon sağlayabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Normal yada sezeryan doğumu sonrasında kullanılabilir olmalıdır.
- 4- Balon % 100 silikondan imal edilmiş olmalı kesinlikle latex içermemelidir.
- 5- Ürün bir pakette set halinde olmalı ve bir adet 60 cc lik şeffaf şırıngası set içinde hazır bulunmalıdır.
- 6- Kanamanın durdurulmasını gözlemlemek için şişirildikten sonra balonun distal ucunda açıkta kalacak şekilde bir drenaj kanalı bulunmalıdır. Balon 500 ml şişirildikten sonra distal uçtaki drenaj kanalı 2 cm den daha az olmayacak şekilde dışarıda kalabilmeli ve kanama takibi yapılabilmesini sağlayabilir özellikte olmalıdır.
- 7- Balonun maksimum şişirme hacmi 500 ml. Olmalı ve şişirildiğinde uterus anatomisine uyumlu bir şekil almalıdır.
- 8- Distal ucuna yakın bir konumda balonun yerleşik olduğu line hattı 24 fr çapında 54-58 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 9- Orijinal paketlerde üretici firma ismi, üretim tarihi, sterilizasyon miadı ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
M. Z. Z.
Dip. 153. IV. 87377

(Handwritten signature)

Manavgat Devlet Hastanesi
Ahmet K. KUL
Dip. 153. IV. 87377
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.

Ayşe DOĞANAY
A. Doğanay