



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 6 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

5.09.2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/e (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **11.09.2024** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetkenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9 Bu teklife davet mektubuna mutlaka **11.09.2024** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN
MALZEMELER
HAKKINDA DETAYLI
BİLGİ ALMAK İÇİN

TELEFON : 0 242 746 11 17
AYNİYAT BİRİMİ
DAHİLİ : 1367

Mehmet Faysal GÜNAŞAN
İdari ve Mali İşler Müdürü

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	3*C63A W.O. SİGORTA	2	ADET			
2	ENT-KT-33-C12 KONTAKTÖR	2	ADET			
3	25 KVAR KONDANSATÖR	2	ADET			
4	20'LİK PPRC T	50	ADET			
5	20'LİK PPRC MANŞON	50	ADET			
6	20'LİK PPRC BORU	40	METRE			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antaliasm.gov.tr/frames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışımda atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		


İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik AĞ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com

KONTAKTÖR(2ADET)

(ENTES MARKA VE MUADİLİ) ENT-KT-33-C12 ENTES

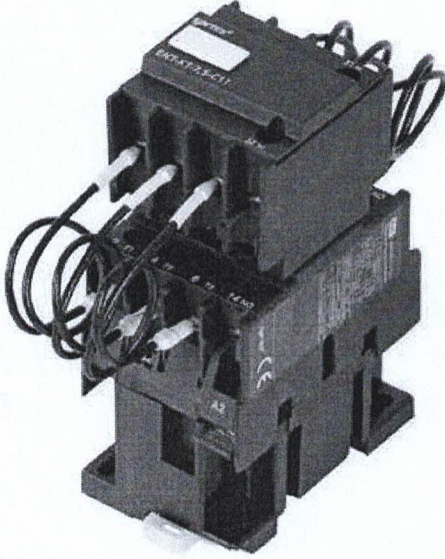


25 KVAR KONDANSATÖR(2 ADET)

ENTES VEYA SCHNEİDER MARKA



Sadık Engin
ELEKTRİK

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Bim Sorumlusu

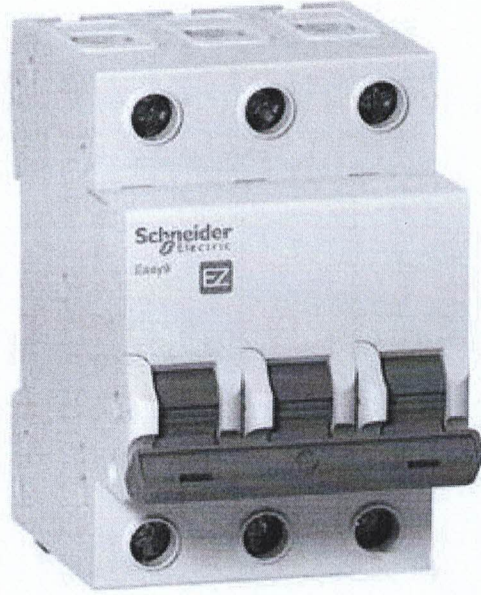

3*C63A W.O. SİGORTA (2 ADET)

SCHNEIDER MARKA

NOT: MALZEMELER MEVCUT TRAFO KOMPANZASYON PANOSUNA UYUM SAĞLAYABİLMESİ İÇİN
ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ BİREBİR UYUMLU OLMALIDIR. MALZEME UYGUNLUK ONAYI
TEKNİK BİRİM TARAFINDAN VERİLECEKTİR.


Sadık ~~Erdoğan~~ ~~Elk. Tek~~
Elk. Tek

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmış KURT
Teknik Birim Sorumlusu


20'LİK PPRC T (50 ADET)



20'LİK PPRC MANŞON(50 ADET)

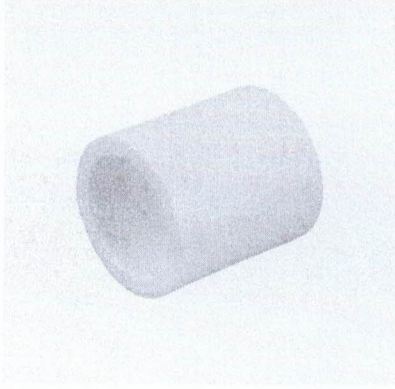

20'LİK PPRC BOR(40METRE)

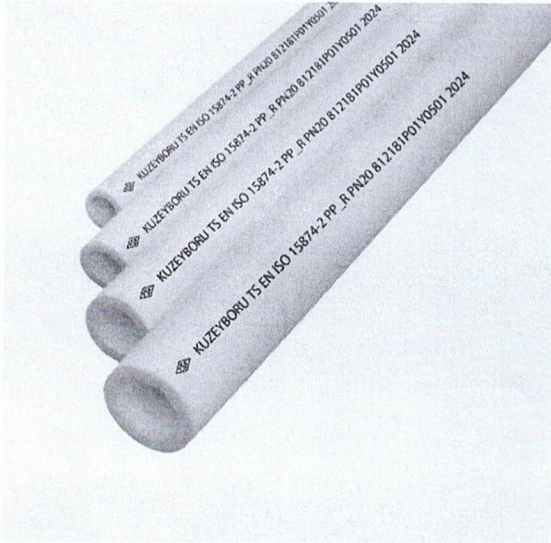

Manavgat Devlet Hastanesi
Dogan SAHİN
Üreklilisi (Sani Tesisat)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmış KURT
Teknik Birim Sorumlusu