

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 563
KONU: 5 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

08/06/2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **10/06/2020** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **10/06/2020** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.
- 11- 5. KALEM NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.NUMUNE GÖNDERMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Harun KARAHAHAN
Mali Mali Hiz. Müd.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	İDRAR VE GAİTA ÖRNEK TAŞIMA ÇANTASI	2	ADET				
2	KAN TUPU TAŞIMA ÇANTASI	2	ADET				
3	KAPAKLI TEMİZ ÇAMAŞIR TAŞIMA ARABASI(150 LİTRE)	1	ADET				
4	KAPAKLI KİRLİ ÇAMAŞIR TAŞIMA ARABASI(150 LİTRE)	2	ADET				
5	SENSÖRLÜ SIVI SABUNLUK	23	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

İDRAR VE GAITA ÖRNEK TAŞIMA SETİ ŞARTNAME

Çanta şeklinde taşınabilir olmalıdır.

Taşıma kulpu hareketli olmalı, kulp kapandığı zaman kapağın içine gömülü olmalıdır.

Çanta kitlenebilir özelliğe sahip olmalıdır.

Çantanın üst , ön ve arka tarafında "İdrar ve Gaita Örnek Taşıma Seti " ibaresi yer alan sarı renk baskılı etiket olmalıdır.

Üzerinde güvenlik uyarı yazıları olmalıdır.

Kutu rengi sarı olmalıdır.

Kapak ve gövdesi birbirine monteli en az 180 hareketli olmalıdır.

Örneklerin set içinde oynamaması ve devrilmemesi için dik yerleştirilebilir yataklı sistem olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Barış SİMSEK
Dip. Teş. No: 08414 89785
Anesteziyoloji ve Rean. Uzm.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mehmet Emin SÖNMEZ
Dip. No: 01023617 Teş. No: 94377
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa Kemal KAYA
Dip. Teş. No: 08414 89785
Anesteziyoloji ve Rean. Uzm.

KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Çanta boyutları 32 x 17 x 16 cm ölçülerinde olmalıdır.
- Kan tüpleri çanta şeklinde taşınabilir olmalıdır.
- Çanta karpunun yukarı doğru kalkabilir ve kapandığında çantaya uyumlu olarak kapanmalıdır.
- Çantanın ön ve arka kısmına suya dayanıklı “Kan Tüpü Taşıma Çantası” etiketleri yer almalıdır.
- Çanta üzerinde ürün hususunda gerekli uyarıların bulunduğu etiketler yer almalıdır.
- Çantanın kilitlenebilir özelliği bulunmalıdır.
- Çanta rengi kırmızı olmalıdır.
- Çanta içerisinde 100 adetlik kan tüpü taşıma sporu bulunmalıdır.
- Çanta içerisinde bulunan sporun çantadan bağımsız şekilde kullanılabilir olmalıdır.
- Çanta içerisine kan tüplerinin dikey olarak yerleştirmeye uygun olmalıdır.



[Handwritten signature]

Mınavcı Doktor Hastanesi
Uzm.Lt.w...
DİG.İT...
Anesteziyoloji

AMEZ
F-377
UZMAN



KAPAKLI TEMİZ ÇAMAŞIR TAŞIMA ARABASI 150 LT

1. Arabanın gövdesi komple dökme plastikten min.82*57*80 H Cm ebatında olmalıdır.
2. Üzerine plastik Min. 3 M kalınlığında kapak tutma kulbu bulunmalıdır.
3. Kapak arabaya menteşe sistemi ile bağlanmış olmalıdır.
4. Araba 150 lt. kapasiteye sahip olmalıdır.
5. Tabanda sızdırma boşaltma vanası olmalıdır.
6. Bu plastik konteynır iskeleti min. 25*1.5 mm mobilya borusundan yapılmış, alt kısmı çepeçevre borularla birleştirilmiş olmalıdır. Aana gövde arabaya tabandan komple kapsmalıdır.
7. Arabanın sağında 1 adet itme kolu olmalıdır.
8. Alt çerçeveye 4 adet tablalı min. 100 mm çapında 1 frenli ,3 frensiz bilyalı tekerlekler bağlanmış olmalıdır.
9. Araba fırın boyası ile boyandıktan sonra 120 derecede fırınlanmış olmalıdır.
10. Pedallı olmalıdır.
11. Pedal ile rahat açılabilmelidir.
12. Araba mavi renkte olmalıdır.

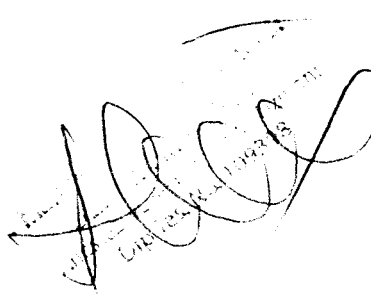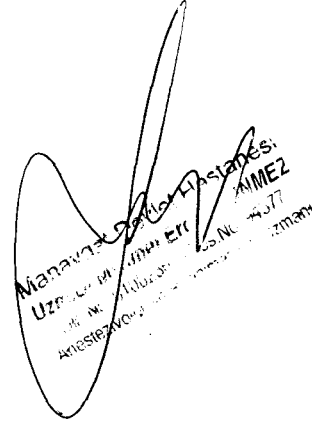

Mianan...
Uzm...
Antes...
KIMEZ
4377

KAPAKLI KİRLİ ÇAMAŞIR TAŞIMA ARABASI 150 LT

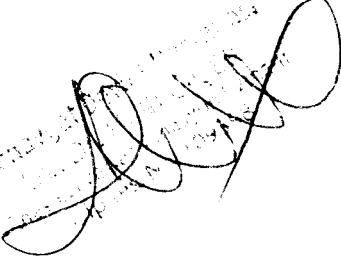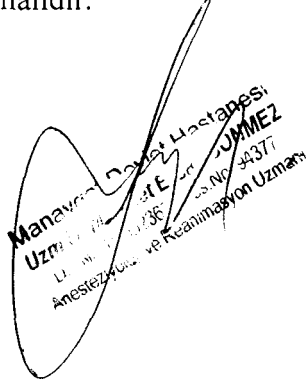1. Arabanın gövdesi komple dökme plastikten min.82*57*80 H Cm ebatında olmalıdır.
2. Üzerine plastik Min. 3 M kalınlığında kapak tutma kulbu bulunmalıdır.
3. Kapak arabaya menteşe sistemi ile bağlanmış olmalıdır.
4. Araba 150 lt. kapasiteye sahip olmalıdır.
5. Tabanda sızdırma boşaltma vanası olmalıdır.
6. Bu plastik konteynir iskeleti min. 25*1.5 mm mobilya borusundan yapılmış, alt kısmı çepeçevre borularla birleştirilmiş olmalıdır. Aana gövde arabaya tabandan komple kapsamalıdır.
7. Arabanın sağında 1 adet itme kolu olmalıdır.
8. Alt çerçeveye 4 adet tablalı min. 100 mm çapında 1 frenli ,3 frensiz bilyalı tekerlekler bağlanmış olmalıdır.
9. Araba fırın boyası ile boyandıktan sonra 120 derecede fırınlanmış olmalıdır.
10. Pedallı olmalıdır.
11. Pedal ile rahat açılabilmelidir.
12. Araba kırmızı renkte olmalıdır.



Manavratı, Deneysel Uygulama
Uzmanı, Dr. E. Y. YUMMEZ
Lisans No: 24377
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

SENSÖRLÜ SIVI SABUNLUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Fotosel kontrolü olmalı ve el teması olmadan sıvı sabun vermelidir.
- 2-Paslanmaz çelik olmalıdır.
- 3-Sabun miktarı ayarlanabilir olmalıdır.
- 4-Hijyenik kolay temizlenebilir gövdesi olmalıdır.
- 5-Duvara monte edilebilir olmalıdır.
- 6-Elektrikle çalışır olmalı ve adaptörü cihaz içerisinde dahili olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilecektir.
- 8-Cihaz montajı firma tarafından yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Semra GEDİK ÖĞÜZ
Diyaliz Sorumlu Hemşiresi