

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -576

KONU: 3 KALEM YEDEK PARÇA VE AVADANLIK ALIM

10.06.2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **12.06.2020** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **12.06.2020** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTA ISITMA BLANKETİ TAM BOY YETİŞKİN	15	ADET				
2	SICAKLIK-NEM TAKİP ÖLÇÜM SİSTEMİ (BUZDOLABI DERECESESİ)	20	ADET				
3	SICAKLIK-NEM TAKİP ÖLÇÜM SİSTEMİ ODA TİPİ ISI-NEM ÖLÇER CİHAZI)	20	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

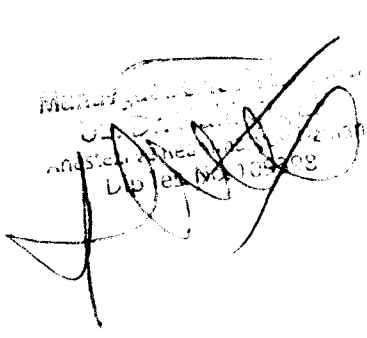
TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

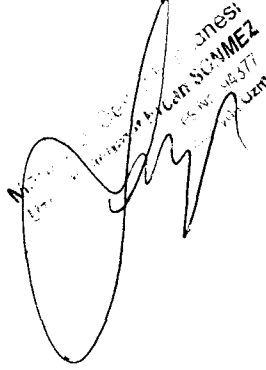
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

ODA TİPİ SICAKLIK VE NEM ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dijital Olmalıdır.
2. LCD ekranlı olmalıdır.
3. Dereceler Beyaz renkte olmalıdır.
4. Sıcaklık ölçüm aralığı -50°C + 70°C olmalıdır.
5. Ekran çözünürlüğü sıcaklık için $0,1^{\circ}\text{C}$ olmalıdır.
6. Sıcaklık hassasiyeti : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ olmalıdır.
7. Nem ölçüm aralığı **10 - 99%** olmalıdır.
8. Ekran çözünürlüğü nem için % 1 olmalıdır.
9. Nem hassasiyeti : $\pm \% 3$ olmalıdır.
10. Min – Max Değer hafızası olmalıdır. Reset tuşu ile değerler sıfırlanabilmelidir.
11. En az **11 x 10 x 2 cm** boyutlarında olmalıdır.
12. Cihaz ekranında aynı anda saat ve tarih görünmelidir. Tarih yıl, ay ve gün olarak yazmalıdır. Haftanın günleri de ekranda yazmalıdır.
13. Saat alarmı ve saat başı alarm özelliği olmalıdır
14. Cihaz 1 adet 1,5V AAA pil ile çalışmalıdır.
15. Duvara asılabilmesi veya ayağı üzerinde durabilmelidir.
16. Sıcaklık ve Nem değerleri büyük olarak görünmelidir
17. **Ürünlerle birlikte kalibrasyon sertifikası verilmelidir.**


Mustafa Kemal
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaokul Öğretmeni
Diyadin Mahallesi
Lise 105200


Mustafa Kemal
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaokul Öğretmeni
Diyadin Mahallesi
Lise 105200

BUZDOLABI ISI TAKİP DERECEİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bu buzdolabı termometresi iki farklı ortamın sıcaklık değerini ölçebilmeli.

IN/OUT yazan buton ile bu değerler arasında geçiş yapılabilirmeli.

IN yazan ekran cihazın kendisinin bulunduğu yani oda sıcaklığını, OUT yazan ekran ise kablonun olduğu yerin yani dış ortamın sıcaklığını göstermeli.

°C/°F butonları arasında geçiş yapılabilirmeli.

Cihaz okunaklı bir LCD ekrana sahip olmalı

Dış ortam yani sensörün bulunduğu yere alt ve üst limitler için sesli alarm kurabilmeli

Cihaz Max ve Min ölçtüğü sıcaklık değerlerini hafızasında tutabilmeli.

Cihazın göstergesinin bulunduğu bölüm; mıknatısları sayesinde metal bir yere tutturulabilmeli.

Cihazın dış sensörünü ölçeceğiniz yerde herhangi bir yere sabitlemeniz için, cihaz ile birlikte cırt cırtlı sabitleyici gelmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Barış SİNCEK
Dış Tıp Uzm. 110414-99785
Anesteziyoloji ve Rean Uzm.


Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. Mehmet Ercan SÖNMEZ
Dış No: 11007265 / Tes. No: 94377
Anesteziyoloji ve Rean Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Uzm.Dr. İbrahim ÇELİK
Dış No: 11007265 / Tes. No: 94377
Anesteziyoloji ve Rean Uzmanı

ÜST ISITICI BLANKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Isıtıcı blanketin bir yüzü alüminyum içerikli metalize ışın yayma özellikli, sıcak hava akışı olmadan bile, hastanın radyan vücut ısını yansıtan, hastayı dış ortamdan izole ederek hipotermiden koruyan bir sisteme sahip olabilmelidir.
2. Isıtıcı blanket latex içermemeli ve dokuma olmayan non-woven yapıya sahip olmalı, polipropilen, polietilen ve alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
3. Isıtıcı blanket yanmaya karşı(alev almayan) standartlarda imal edilmiş olmalıdır.
4. Yetişkin blanket 233x127cm +/- 10cm olmalıdır.
5. Isıtıcı cihaz üzerinde 32°C,38°Cve 43°C'lik ısı seçenek tuşu olmalıdır.
6. Isıtıcı cihaz üzerinde yüksek ısı limiti, düşük ısı limiti gösteren alarm göstergeleri olmalı, sesli ve görsel ikaz yapabilmelidir.
7. Isıtıcı cihaz seçilen sıcaklıkların birinde +/- 5°C değerinde bir sapma yaptığıında otomatik olarak çalışmasını durdurmalıdır.
8. Isıtıcı cihaz üzerinde toplam kullanılan süre ve teknik servis ihtiyacını gösteren bir panel olmalıdır.
9. Isıtıcı cihazın, hortum uzunluğu 1,8 m olmalı, hortum flexible bir yapıda olmalı ve askı aparatı bulunmalıdır.
10. Isıtıcı cihaz 220-240 V,50-60 Hz çalışabilmelidir.
11. Isıtıcı cihaz çalışma esnasında çok gürültü çıkarmamalıdır.
12. Ürünün, Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olmalıdır.
13. Yüklenici firma battaniyelerin kullanımı için hastaneye yukarıda teknik özellikleri belirtilen bir adet hasta ısıtma cihazını ücretsiz olarak verecektir.

Ümmü ZEYBEKOĞLU
Yoğun Bakım Sor.



1