

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01 - 615
KONU: 10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

14.05.2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **16.05.2019** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **16.05.2019** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.
- 11- **TÜM KALEMLER NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.NUMUNE GÖNDERMEYENLERİN FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**

Harun KARAHAN
İdari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KATATER MOUNTH	500	ADET				
2	ANTİSEPTİK TÜL GRAS 10*10 CM	100	ADET				
3	CİLT STAPLERİ	300	ADET				
4	KARACIĞER SÜTURU 40MM 1/2 NO:0	12	ADET				
5	KARACIĞER SÜTURU 40MM 1/2 NO:1	24	ADET				
6	STAPLER DAİRESEL DST ÇAPI 28-31-34 MM KARTUŞU	2	ADET				
7	DÜZ KAPATICI KESİCİ STAPLER 80-4,8 MM KARTUŞU	2	ADET				
8	DÜZ KAPATICI KESİCİ STAPLER 80-4,8 MM	2	ADET				
9	DÜZ KAPATICI KESİCİ STAPLER 80-3,8 MM KARTUŞU	2	ADET				
10	DÜZ KAPATICI KESİCİ STAPLER 80-3,8 MM	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

10 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMINI GENEL HÜKÜMLERİ

- Alımı yapılması istenilen ürünler acil ihtiyaç olup, firmalar siparişi takiben **en geç 10 gün içerisinde** ürünleri faturasıyla birlikte Tıbbi Sarf Depo-Eczane'ye teslim etmelidirler.
- Fatura üzerinde ilgili malzemenin adı, barkodu, son kullanım tarihi, Sut kodu, firma tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- Steril ambalaj içinde olan malzemeler aksi yazılmamış ise teslim tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır ancak özelliği nedeni ile 2 yıldan az miadlı üretilen malzemeler belgelendirilmesi karşılığında kabul edilecektir. Son kullanma tarihleri ambalaj üzerinde yazmalıdır.
- Ürünler ÜTS'de kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- Teknik özelliklerinde numune değerlendirilmesi yapılacak olup, malzemelerin numuneleri fiyat teklifini takriben hastaneye gönderilmelidir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Ecz. Ezgi TOPÇU OTAY
Dip Teş. No.. 40742

Ecz. Mustafa Berkant
M

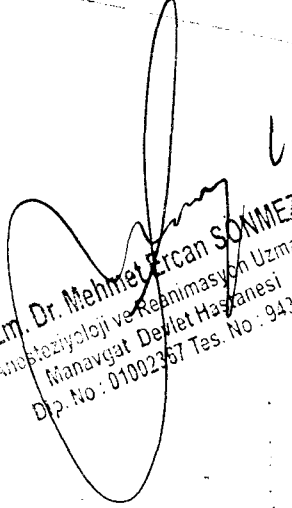
KATETER MOUNT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) 20±2 cm uzunluğunda olacaktır.
- 2) Mevcut anestezi sistemine uyumlu olmalıdır.
- 3) Tek tek steril paketlerde olmalı ve paket açılırken sterilitesi bozulacak şekilde olmamalıdır.
- 4) Teklif veren firmalar 1 adet numune vereceklerdir. Numune değerlendirildikten sonra kabulü yapılacaktır.
- 5) Ürünün ve/veya ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır.
- 6)Körüklü öner başlık tercih sebebidir.

Uzm. Dr. Mehmet Ercan SÖNMEZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Manavgat Devlet Hastanesi
Dip. No : 01002367 Tes. No : 94377

ANTİSEPTİK TL GRAS SARGI TEKNİK SARNAMESİ

- 1)Malzeme %0,5 oranında klorheksidin asetat BP ihtiva eden ve %99,5 beyaz yumuřak parafin BP ile doyrulmuř, seyrek dokunmuř bir Leno bezinden meydana gelecektir.
- 2)Sıcak mhrle paketlenmiř alminyum pořetler iinde, pařmen koruyucu varaklar arasında steril halde yer alacaktır.
- 3)2,5 megarad'da Gama radyasyon ile sterilize edilmiř olacaktır.
- 4)Beher 10 cm. bařına iplik sayısına bakıldıđında zg sayısı'74 'ten, atkı sayısı 80'den az olmayacaktır.
- 5)Sargının beher birim alan bařına ađırlıđı 42 gm⁻² den az olmayacaktır.
- 6)Eterde eriyebilir maddelerin doyrulmuř yıđın ađırlıđı 100 gm⁻² den az olmayacaktır.
- 7)Ebatları;
 - 5 cm x 5 cm (1 kutuda 50 adet)
 - 10 cm x 10 cm (1 kutuda 10 adet)
 - 15 cm x 20 cm (1 kutuda 10 adet)
 - 15 cm x 1 m olacaktır. (1 kutuda 12 adet)


Uzm. Dr. Mehmet Ercan SONMEZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Nınavgat Devlet Hastanesi
Dip. No : 01002367 Tes. No : 94377

Cilt Stapleri Teknik Şartnamesi

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Cilt Staplerinin içinde en az 35 adet titanyum veya çelik zimba bulunmalıdır.
4. Zimbaların üzeri, ciltle reaksiyona girmemesi için, Vydex™ ile kaplanmış olmalıdır.
5. Cilt Staplerinin üzerinde, kalan zimba sayısını gösteren bir gösterge olmalıdır.
6. Cilt Staplerinin attığı zimbalar, cilt üzerinde sabit durması için, dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
7. Cilt Stapleri tutulduğunda, zimba çıkış noktası rahatlıkla görülecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
8. Zimbalama esnasında insizyonun iki dudağını bir arada tutmaya yarayan, bir doku kanalı olmalıdır.
9. Cilt Stapleri herhangi bir yöne doğru bastırıldığında, zimbaların kolay çıkmasını sağlayan bir "atıcı yay mekanizması" olmalıdır.
10. Zimba telinin çapı 0.58mm, genişliği 6.9mm ve bacak uzunluğu da 3.9mm olmalıdır.
11. Zimbaların üzeri, cilde kolay giriş ve çıkışın sağlanması için Teflon ile kaplanmış olmalıdır.
12. Latex madde içermemelidir.
13. Ambalajların üzerinde sterilizasyonu ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
14. Teklif edilen ürünün üzerinde, ürünün sterilitesinin güvenliği açısından: ürünün marka adı, ürünün lot numarası, ürünün sterilite süresi (tarih olarak) vb.tanıttıcı özellikleri olmalıdır, yapıştırma etiket olmamalıdır.
15. Ürün paketleri içinde Türkçe kullanım talimatı bulunmalıdır.
16. Her 100 adet cilt stapleri için, 2 adet metal stapler sökücü verilecektir.

Sartname ihale listesinde
durmıştır.

Devlet Hastanesi
Naciye ATILAY
Kült. Yet.

Karaciğer Süturu Teknik Şartnamesi

1. Sentetik multiflaman absorbe olan cerrahi suture polyglactin veya lactomer sınıfına göre imal edilmiş olmalı ve kalıntıları, düğüm atma kabiliyetleri iğne iplik kombinasyonu U.S.P.(United States Farmakopya) ve E.P. (Avrupa Farmakopisi)' ye uygun olmalıdır.
2. Sentetik multiflaman absorbe olan cerrahi suture cerrahi iğneye takılı durumda, kıvrılmayı engelleyecek şekilde, alüminyum folyo poşette ambalajlanmış olmalıdır.
3. Sentetik multiflaman absorbe olan cerrahi suture en fazla 70 gün içinde vücutta absorbe olmalıdır.
4. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl matli olmalıdır.
5. Suture iğnesi özel alaşımlı 455 surgical alloy veya benzer özellik gösterilebilecek metaryalden yapılmış küt uçlu olmalıdır.
6. İğne boyu 10 mm' nin üzerindeki için +/- 3mm tolerans tanınmalıdır.
7. Ürüne ait CE belgesi olmalı
8. Doku destek süresi 2 hafta içerisinde % 80, üçüncü hafta içerisinde % 30 tensil kuvvetini korumalıdır.
9. Birim ambalaj kullanım anına kadar sterilizesinin korunmasını sağlayacak iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir.
10. Dış ambalajın iç yüzü şeffaf, dış yüzü etkilere dayanıklı beyaz kağıttan olmalıdır,
11. İç ambalaj suture unun kıvrılmasını engelleyecek şekilde alüminyum folyo olup açıldığında iğne görülebilir.
12. Birim ambalajın üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve anlaşılır biçimde yazılmalıdır: İmalatçı firmanın ticari adı ve / veya kısa adı ,
13. İğne cinsi, iğne adedi, iğne boyu (mm olarak)
14. İğne büyüklüğü 1/1 oranında olmalıdır.
15. Suture unun uzunluğu, rengi, iğnesiz ise suture adedi
16. Suture unun kalınlığı (E.P. ve U.S.P. olarak)
17. Üretim ve son kullanma tarihi
18. Steril ibare sterilizasyon metodu

19. Kutu Ambalaj üzerinde ürüne ait prospektüs olmalıdır.

20. Kutu Ambalaj üzerinde ;

21. Birim Ambalajından kaç adet olduğu belirtilmiş olmalıdır.

22. Sıcaktan ve ışıktan korunmasına dair yazı olmalıdır.

23. Seri ve kontrol numarası olmalıdır.

24. Numune değerlendirmesi yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Cemal MEMİŞ
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No. 41805

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Mustafa ŞAHİN
Dip. Tes. No. 7197
Genel Cerrahi Uzmanı

**STAPLER DAİRESSEL (Circular) DST EĞRİ ŞAFTLI ANVİL ÇAPI 28-31-34MM ZIMBA KAPANMA
YÜKSEKLİĞİ 1.5 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Disposable olmalıdır.
2. Açık ve Endoskopik cerrahide kullanım için uygun olmalıdır.
3. Dairesel iki sıralı titanyum zimba yerleştirerek bıçağı ile aradaki dokuyu kesip uç - uca veya uç - yana anastomoz yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Stapler; tutaç, çevirme kanadı, emniyet mandalı, eğri şaft ve ayrılabilir anvilden oluşmalıdır.
5. Stapler ateşlendikten sonra anvil kısmının anastomoz hattından güvenli biçimde zimba hattına zarar vermeden rahatlıkla geçebilmesi için anvil başının düşmesini sağlayan mekanizmaya sahip olmalıdır.
6. Tutacın uç kısmında staplerin ölçüleri yazmalıdır.
7. Tutaçtaki trokar üzerinde anvilin trokara yerleştirilebileceğini gösteren turuncu bir bant olmalıdır. Bu bant anvil tutaca doğru olarak sabitlendiğinde görülmemelidir.
8. Anvilde anvilin şaftının üzerinde bulunan delikler ve renkli bant sayesinde cerrahi aletler ile kolaylıkla tutula. özelliğine sahip olmalıdır.
9. Dokunun kalmasını engellemek için anvil kısmında purse-string çentiği bulunmalıdır.
10. Anvil üzerinde, laparoskopik el aletleri ile tutuşu kolaylaştırmak için kaymayı engelleyen renkli plastik bir tutma çentiği bulunmalıdır.
11. Tutacın ön kısmında bulunan penceresinde, staplerin doku üzerinde tam olarak kapatıldığını gösteren ve her yonden görülebilen bir indikatörü olmalıdır.
12. Anastomozun güvenliği açısından indikatör pencerede görülmediği takdirde stapler ateşleme yapmamalıdır.
13. Staplerin bıçağı 440 paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
14. Anvilin staplerdaki bıçakla karşılaşan alt yüzeyi sert bir materyalden yapılmış olmalıdır ve bu bıçağın daha güçlü kesmesini sağlamalıdır.
15. Staplerin ateşlendiğini ve ateşleme sonrası anvilin başının düştüğünü belirten sesli bir geribildirim mekanizması olmalıdır.
16. İki dokunun yaklaştırma anında oluşan basıncı elimine ederek anastomoz güvenliğinin sağlanması için anvil ve kartuş kısmında delikler bulunmalıdır.
17. Staplerin tutacında istenmeyen ateşlemeyi engelleyecek emniyet mandalı bulunmalıdır. Bu bant
18. Staplerin tutacı açık ve endoskopik ameliyatlarda parlama yapmayacak mat paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
19. Kartuş dış çapı 33.6 (± 0,5) mm , dairesel bıçak çapı 24.5 (± 0,5) mm olmalıdır.
20. Zimba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4.8mm, ateşlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
21. Kartuş içerisinde 32 (± 1) adet titanyum zimba olmalıdır.
22. Staplerin şaftının uzunluğu 22 (± 2) Cm olmalıdır.
23. Ateşleme sonrasında oluşan anastomozun dudakları 1.9 (± 0,5) mm olmalıdır.
24. Kartuş rengi staplerin zimba bacak boyu özelliğini belirten renkte olmalıdır
25. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde sabit kartuş bulunmalıdır.
26. Steril paketin içerisinde, gerekli vakalarda düşük profilli anvile takılarak kullanılabilecek künt uçlu ve sivri uçlu olmak üzere 2 ayrı çeşit plastik delici trokar bulunmalıdır.
27. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı olmalıdır.
28. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı olmalıdır.

Devlet Hastanesi
SAMI

**DISPOSABLE DÜZ KAPATICI & KESİCİ STAPLER 80-4.8MM
KARTUŞU
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1 Disposable Olmalıdır.
- 2 Çift sıralı iki hat boyunca en az 80 mm uzunluğunda kapama ve en az 75 mm kesme yapmalıdır.
- 3 Bıçak kartuşu üzerinde olmalı ve kartuşla birlikte her defasında değişmelidir.
- 4 Kartuş 80-3.8 mm ve 80-4.8 mm stapler ile kullanılabilir.
- 5 Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideal "B" formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 6 Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4.80 mm, ateşlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
- 7 Kartuşun içinde 84 adet titanyum zımba bulunmalı ve zımbaların çapları en az 0.21 mm olmalıdır.
- 8 Kartuş üzerinde zımba bacak boyunu belirten ibareler olmalıdır.
- 9 Kartuş rahat bir şekilde yüklenip çıkarılması için üzerinde tutaç gripleri olmalıdır.
- 10 Kartuştaki bıçağın koruyucu kını olmalıdır.
- 11 Kartuş ve makine birbirine uyumlu olmalıdır.
- 12 Kartuş ateşledikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
- 13 Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
- 14 Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
- 15 Ürünün ulusal bilgi bankası kodu olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Serel YILMAZ
Dip. Tes. No: 7507
Genel Cerrahi Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa S. AYILIN
Dip. Tes. No: 7107
Genel Cerrahi Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Osman MEMİŞ
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip Tes. No: 41805

DISPOSABLE DÜZ KAPATICI & KESİCİ STAPLER 80-4.8MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 Disposable Olmalıdır.
- 2 Çift sıralı iki hat boyunca en az 80 mm uzunluğunda kapama ve en az 75 mm kesme yapmalıdır.
- 3 Tek elle kullanımına uygun paralel veya makas şeklinde kapama yapmalıdır.
- 4 Staplerin kartımsuz , ateşlenmiş veya yarı ateşlenmiş kartuşla kapama yapmasını önleyecek emniyet mekanizması bulunmalıdır.
- 5 Sekiz defa ateşleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 6 Bıçak kartuşun üzerinde olmalı ve kartuşla birlikte her defasında değişmelidir.
- 7 Aynı stapler üzerinde 3.8 mm ve 4.8 mm'lik kartuşlar kullanılabilir.
- 8 Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideal "B" formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 9 Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4.8 mm, ateşlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
- 10 Kartuşun içinde 84 adet titanyum zımba bulunmalı ve zımbaların çapları en az 0.21 mm olmalıdır.
- 11 Kartuştaki bıçağın koruyucu kını olmalıdır.
- 12 Kartuş ve makine birbirine uyumlu olmalıdır.
- 13 Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet yüklenmiş kartuş bulunmalıdır.
- 14 Steril paketlenmiş malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
- 15 Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
- 16 Ürünün ulusal bilgi bankası kodu olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Serel YILMAZ
Diy. Res. No: 75067
Genel Cerrahi Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr. Mustafa SAĞLAM
Diy. Res. No: 11172
Genel Cerrahi Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Osman YEMİŞ
Diy. Res. No: 41805
Genel Cerrahi Uzmanı

DISPOSABLE DÜZ KAPATICI & KESİCİ STAPLER 80-3.8MM
KARTUŞU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 Disposable Olmalıdır.
- 2 Çift sıralı iki h... unca en az 80 mm uzunluğunda kapama ve en az 75 mm kesme yapmalıdır.
- 3 Bıçak kartuşun üzerinde olmalı ve kartuşla birlikte her defasında değişmelidir.
- 4 Kartuş 80-3.8 mm ve 80-4.8 mm stapler ile kullanılabilir.
- 5 Hemostaz ve peçikülün beslenmesi için zımbanın ideal "B" formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 6 Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 3.80 mm, ateşlemeden sonra 1.5 mm olmalıdır.
- 7 Kartuşun içinde 84 adet titanyum zımba bulunmalı ve zımbaların çapları en az 0.21 mm olmalıdır.
- 8 Kartuş üzerinde zımba bacak boyunu belirten ibareler olmalıdır.
- 9 Kartuş rahat bir şekilde yüklenip çıkarılması için üzerinde tutma gripleri olmalıdır.
- 10 Kartuş ateşledikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
- 11 Kartuştaki bıçağın koruyucu kını olmalıdır.
- 12 Kartuş ve makine birbirine uyumlu olmalıdır.
- 13 Steril paketlenmiş malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
- 14 Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
- 15 Ürünün ulusal bilgi bankası kodu olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Şeraf YILMAZ
Dip.Tes.No: 73067
Genel Cerrahi Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Mustafa SAHİN
Dip.Tes.No: 7197
Genel Cerrahi Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op. Dr. Osman MEMİS
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip Tes. No. 41805

DISPOSABLE DÜZ KAPATICI & KESİCİ STAPLER 80 MM. – 3,8 MM.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır.
2. Çift sıralı iki hat boyunca 80 mm. uzunluğunda kapama ve 75 mm. kesme yapmalıdır.
3. Tek elle kullanıma uygun paralel veya makas şeklinde kapama yapmalıdır.
4. Staplerin kartuşsuz, ateşlenmiş veya yarı ateşlenmiş kartuşla kapama yapmasını önleyecek emniyet mekanizması bulunmalıdır.
5. Sekiz defa ateşleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
6. Bıçak kartuşun üzerinde olmalı ve kartuşla birlikte her defasında değişmelidir.
7. Aynı stapler üzerinde 3,8 mm. ve 4,8 mm.' lik kartuşlar kullanılabilir.
8. Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideal 'B' formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.
9. Staplerin kartuşundaki zimba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 3,8 mm., ateşlemeden sonra 1,5 mm. olmalıdır.
10. Kartuşun içinde 84 adet titanyum zimba bulunmalı ve zimbaların çapları en az 0,21 mm. olmalıdır.
11. Kartuştaki bıçağın koruyucu kını olmalıdır.
12. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet yüklenmiş kartuş bulunmalıdır. Kartuş ve makine birbirine uyumlu olmalıdır.
13. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
14. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
15. Ürünün ulusal bilgi bankası kodu olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Serif YILMAZ
Dip.Tes.No: 41805
Genel Cerrahi Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Mustafa SAHİN
Dip.Tes.No: 41805
Genel Cerrahi Uzmanı

Manavgat Devlet Hastanesi
Op.Dr.Özkan YILMAZ
Dip.Tes.No: 41805
Genel Cerrahi Uzmanı