

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

619

KONU: 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

11/03/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **16/03/2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **16/03/2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	OTOSKOP AMPULÜ 2.5 VOLT	20	ADET				
2	OTOKLAV CİHAZI PNÖMATİK BAĞLANTI HORTUMU	30	METRE				
3	SICAK SU KOLLEKTÖR HATTI	2	ADET				
4	SİRKÜLASYON POMPASI	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ali/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

SICAK SU KOLLEKTÖR HATTI VE SİRKÜLASYON POMPA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi A blok kazan dairesinde bulunan boiler kazanı çıkışında bulunan kollektör hattının yenilenmesi (galvaniz veya krom malzeme) mevcutta bulunan hatların her birine vana ve çekvalf eklenerek kollektör hattına bağlantısının yapılması, kollektör hattının girişine aşağıda asgari özellikleri belirtilen sirkülasyon pompasının eklenmesi, her bir sirkülasyon pompasının giriş ve çıkışına küresel vana eklenmesi, pompa besleme kollektörüne boiler kazanından ve gün ısıdan gelen hatların bağlantısının yapılması ve sistemin devreye alınması iş/işlemlerini kapsar

B. MÜDAHALE EDİLECEK İŞ KALEMLERİ

1. Dn 32 metal küresel vana ve çekvalf 1 adet
2. Dn 40 metal küresel vana ve çekvalf 3 adet
3. Dn 50 metal küresel vana 7 adet
4. Dn 65 metal küresel vana ve çekvalf 1 adet
5. Krom veya galvaniz kollektör hattı 3 giriş 4 çıkış 1 adet
6. Krom veya galvaniz kollektör hattı 2 giriş 3 çıkış
7. Sirkülasyon pompası 2 adet

C. GENEL ŞARTLAR

Pompa değişimi ve kollektör hattı yapacak firmanın;

1. Firma teklif vermeden önce mahalde keşif yapmalı, teknik servis nezaretinde mevcut sistemi yerinde inceledikten sonra yer gördü belgesi düzenlemelidir
2. ISO 9001:2015 veya 14001:2015 Kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır
3. TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır
4. Yüklenici yapacağı /yaptıracağı işlemler esnasında her türlü iş ve işçi sağlığı güvenliği için emniyet tedbirlerinden sorumlu olacaktır
5. Yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliği 6331n sayılı kanun hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır
6. Yüklenici firma yapılacak işlemler sırasında oluşabilecek her türlü iş kazasından ve bunlardan meydana gelecek maddi vb. zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır

Yukarıda belirtilen maddeleri karşılaması ve belgelendirmesi gereklidir.

D. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

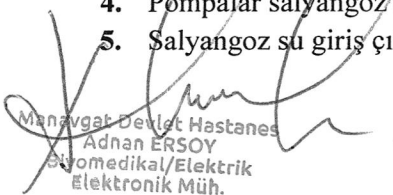
1. Firma işe başlamadan önce hastane Teknik Birimi ile irtibata geçmelidir. Yapılacak işler teknik servis sorumlusu veya teknik servis sorumlusunun görevlendirdiği teknisyen gözetiminde yapılacaktır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

2. Yapılacak planlama dâhilinde mesai saatleri veya mesai saatleri dışı çalışma için hastane idarece belirlenecek zaman diliminde çalışmalıdır.
3. Yapılacak planlama dâhilinde mesai saatleri veya mesai saatleri dışı çalışma için hastane idaresinden onay alınmalı, mesai saatleri dışında yapılacak işlemlerde de gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alınması firma yükümlülüğünde olacaktır.
4. Değişim sonrası sökülen malzemelerin belirlenen alana taşınması ve alanın temizlenmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır
5. İşlemi biten alanın temizlenmesi, kullanıma hazır hale getirilmesi devreye alınması ve pompaların amper değerleri kontrol edildikten sonra işlemin tamamlanması işleri firma sorumluluğunda olacaktır.
6. Yüklenici firma, değişim işlerinden sonra düzenleyiciyi raporları kendisi tanzim edecektir. Bu formları doldurduktan sonra refakat eden hastane teknik personelinin de imzasıyla idareye teslim edecektir.
7. İdarenin bilgisi dışında yapılan değişim işi kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. Firma mevcutta bulunan hattı tüm tedbirleri aldıktan sonra demonte etmelidir
9. Kullanılacak hatların kaynak noktaları temizlenmeli kaynak için hazır hale getirilmelidir
10. Yeni sirkülasyon pompa çıkış kollektörü hatlara bağlantısı yapılmalı, pompa bağlantıları flanşlarla eklenmeli ve pompa su alım kollektörü de sisteme bağlantısı yapılmalıdır
11. Su alım kollektörüne boiler kazanından ve gün ısı hattından gelen hatların bağlantısı yapılmalı, by pass hattı oluşturulmalıdır
12. Kollektörlerin sabit kalabilmesi için uygun askı mekanizması (metal kutu profilden) oluşturulmalı ve sabitlenmelidir
13. Kollektörler galvaniz veya krom malzemeden imal edilmiş olmalı, galvaniz kaplama olmamalıdır. Malzeme et kalınlığı en az 3 olmalıdır
14. Sistemde kullanılacak vanalar TSE 13828 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, %100 prinç malzemeden imal, CE sertifikalı olmalı ve tam geçişli olmalı, açma kapama pvc kaplı çelik kollu olmalı, ürünün markası ve standardı üzerinde mutlaka yer almalıdır ayrıca ürüne ait ebatlar metal gövde üzerinde yer almalıdır.
15. Vanalar -10 +110 derece arası çalışmaya uygun yapıda olmalıdır
16. Vanalar ve çekvalf iç dişli olmalı, arada kullanılacak tüm fittings malzemeler metal olmalı ve firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır
17. Firma mevcutta kurulu sistem üzerinde yaptığı iyileştirme çalışması sırasında sisteme vereceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır. Oluşan zararın karşılanması firmaya ait olacaktır
18. Tüm montaj işlemi tamamlandıktan sonra kaçak testi yapılmalı, test sonrası yapılan imalatlar alüminyum folyolu izocam ile kaplanmalı ve bantlanmalıdır
19. Yapılacak değişim işleri esnasında kullanılması gereken her türlü teknik, temizlik vs. malzeme araç ve gereçlerin temini firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.
20. Yüklenici firmadan temin edilmiş malzemeler, malzeme ve işçilik hatalarına karşı fatura tarihi esas alınarak en az 2 yıl garantili olacaktır.

E. ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Pompa en az 3 kademeli olmalı pompa gücü min 315 max 500 w olmalıdır
2. Pompa giriş çıkış metal flanşlı DN 50 olmalıdır
3. Pompa üzerinden ayarlanabilir 3 kademeli olmalıdır
4. Pompalar salyangoz kısmıyla beraber montajı yapılmalıdır
5. Salyangoz su giriş çıkış ebatları 50 mm olmalıdır


Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

6. Pompa TSE ve CE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
7. Pompa en az IP 54 koruma sınıfına sahip olmalıdır
8. 380v 50 Hz voltaj/frekans değerlerinde çalışmaya uygun 3 fazlı olmalıdır
9. Sistem üzerinde en az 8 bar basınç üretebilecek kapasitede olmalıdır
10. Pompa sistemi -10 +110 derece arası kullanıma uygun olmalıdır
11. İzolasyon sınıfı en az Class F olmalıdır
12. Salyangoz sfero döküm veya pik döküm olarak imal edilmiş olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektronik
Elektronik Müh.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
OTOKLAV CİHAZI PNÖMATİK BAĞLANTI HORTUMU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dış çap 6 mm. İç çap 4 mm. Orijinal yumuşaklığa sahip teflon ürün olacaktır.
2. Yüksek derece (200) sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
3. En az bir yıl garantili olmalıdır.
4. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
5. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
6. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
7. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
8. UBB'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

İlkay UZ
Sterilizasyon Sor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

OTOSKOP AMPULÜ 2.5 VOLT

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kenarları sıkmayı kolaylaştırıcı tırtıklı led ampül olacaktır. Ampülün dip kısmında siyah contası olacaktır.
2. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
3. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
4. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
5. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
UBB'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

09.03.2022
Şükran SAVAÇANDIR
Poliklinikler Sor.