

SAVİ: 98177073 / 934.01 - 632
KONU: 1 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

05.08.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **09.08.2021** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda:
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **Birim Bedel** **09.08.2021** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **üzerinden değerlendirme yapılacaktır.**
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **m-satinalma@hotmail.com 'a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.**

Ahmet DEMİRTAŞ
İ. M. H. M. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI VOLTAJ JENERATÖR ÜNİTESİ	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR
NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

RÖNTGEN CİHAZI VOLTAJ JENERATÖR ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU :

Söz konusu şartname; Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi Radyoloji ünitesinde bulunan fiji film marka 0180 SC model dijital röntgen cihazının voltaj jeneratörünün ünite olarak değiştirilmesi ve cihaza ait yeni diğer ekipmanların montajının yapılarak devreye alınması ve çalışır duruma getirilmesi işlemlerini kapsar

B. GENEL ŞARTLAR

Firmalar aşağıda belirtilen şartları sağlamak ve istenilen belgeleri hastaneye sunmakla yükümlü olacaktır.

1. İstekli firma; üretici firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesini (12426) veya kendisine ait ürünle alakalı güncel tarihli hizmet yeterlilik belgesini sunmalıdır
2. Firma üretici firmadan alınmış yetki belgesi ile güncel yetkili olduğunu belgelemelidir
3. Tüm ürünler CE belgeli olmalı ve ürün isimleri belge üzerinde açıkça yazmalıdır.
4. Yüklenici firma ürünün yerli olması durumunda yerli üretim belgesi, ithal olması durumunda gümrük belgelerini sunmalıdır
5. İstekli firma, yapacağı/yaptıracağı işlemler esnasında her türlü iş ve işçi sağlığı güvenliği için gerekli emniyet tedbirlerinden sorumlu olacaktır
6. İstekli firma iş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı kanun hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır
7. İstekli firma yapılacak işlemler sırasında oluşabilecek her türlü iş kazasından ve bunlardan meydana gelebilecek her türlü maddi vb. zarardan doğrudan sorumlu olacaktır.

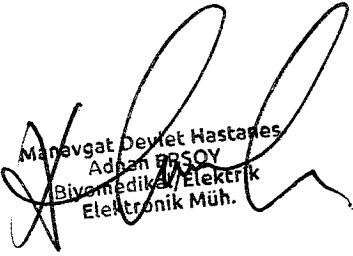
C. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Firma işe başlamadan önce hastane Teknik Birimi ile irtibata geçmelidir. Yapılacak işler teknik servis sorumlusu veya teknik servis sorumlusunun görevlendirdiği teknisyen gözetiminde yapılacaktır.
2. İşin tam olarak tamamlanamaması (yazılım- donanım- haberleşme-izlenilebilirlik vs.) durumunda tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır
3. Yapılacak planlama dâhilinde mesai saatleri veya mesai saatleri dışı çalışma için hastane idaresinden onay alınmalı, mesai saatleri dışında yapılacak işlemlerde de gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alınması firma yükümlülüğünde olacaktır.
4. Voltaj jeneratörü unite halinde olmalı, donanımsal olarak herhangi bir eksiklik olmamalıdır
5. Ürün daha önce kullanılmamış olmalı, ürün ambalajlı kapalı halde deformasyonsuz halde teslim edilmelidir
6. Voltaj jeneratör ünitesi yanında cihazın X-Ray tüp değişimi de firma tarafından yapılacak cihaz tüm sistem olarak çalışır halde teslim edilecektir.

7. Teklif öncesi keşfe binaen cihazda yapılacak ünite değişimi ve Xray tüp değişimi sonrası yaşanacak tüm aksaklıklardan veya ihtiyaç duyulacak yeni yedek parça ekipmandan firma sorumlu olacaktır
8. İşin tamamı düşünüldüğünde şartnamede belirtilmeyen fakat ihtiyaç duyulacak tüm sarf malzemeler firmaya ait olacaktır.
9. İşlemi biten alanın temizlenmesi, kullanıma hazır hale getirilmesi firma sorumluluğunda olacaktır.
10. Yüklenici firma, revizyon işlerinden sonra düzenleyiciyi raporları kendisi tanzim edecektir. Bu formları doldurduktan sonra refakat eden hastane teknik personelinin de imzasıyla idareye teslim edecektir.
11. Hastane teknik servisi bilgisi dışında yapılan revizyon/tamir işi kesinlikle kabul edilmeyecektir.
12. Yapılacak işlerde kullanılması gereken her türlü teknik, temizlik vs. malzeme araç ve gereçlerin temini firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır

D. JENERATÖRÜ ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek jeneratör kurumumuz radyoloji ünitesinde bulunan Fujifilm marka D-EVO SUITE model röntgen cihazı ile uyumlu ve sorunsuz çalışmalıdır.
2. Jeneratör Türkiye Cumhuriyeti elektrik şebekesi voltajı ve frekansına uygun çalışmalıdır.
3. Jeneratör en az 80 kW gücünde olmalı, yüksek frekans veya DC converter tekniğiyle çalışmalıdır.
4. Ürün 100 kV değerinde en az 800 mA akım değerine ulaşabilmelidir
5. Gerekli tüm kV, mA ayarları seçilen organ programına göre manuel olarak jeneratör konsolu üzerinden kontrol edilmelidir.
6. Jeneratörde otomatik doz kontrol tertibatı (AEC) bulunmalıdır.
7. Teklif edilen ürün 1 yıl üretim hatalarına karşı garantili olmalıdır.


Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan BİRSÖY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.