



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

10.04.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **15.04.2025** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9 Bu teklife davet mektubuna mutlaka **15.04.2025** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNİYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Emir ŞENBER
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	KANTRANFİZYON MERKEZİ VESTEL MARKA 18000 BTU PLATİNUMA-18 BEJ MODEL KLİMAYA UYUMLU DIŞ ÜNİTE FAN MOTORU ALIM	1	ADET			
2	KANTANFİZYON MERKEZİ VESTEL MARKA 18000 BTU PLATİNUMA-18 BEJ MODEL KLİMAYA UYUMLU İÇ ÜNİTE KARTI ALIM	1	ADET			
3	KAN TRANFİZYON MERKEZİ VESTEL 24000 BTU SPLIT KLİMA İÇİN KONTAKTÖR ALIM	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com

**KAN TRANFİZYON MERKEZİ KLİMASI İÇİN MALZEME ALIM
ŞARTNAMESİ:**

KAN TRANFİZYON MERKEZİ VESTEL MARKA 18000 BTU PLATİNUMA-18 BEJ MODEL
KLİMAYA UYUMLU DIŞ ÜNİTE FAN MOTORU ALIM (1 ADET)



KAN TRANFİZYON MERKEZİ VESTEL MARKA 18000 BTU PLATİNUMA-18 BEJ MODEL
KLİMAYA UYUMLU İÇ ÜNİTE KARTI ALIM (1 ADET)

ALINACAK MALZEMELER VESTEL MARKA 18000 BTU PLATİNUMA-18 BEJ
MODEL SPLIT KLİMAYA UYGUN OLMALI. ORJİNAL MALZEME OLMALI.

MALZEME UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM SONER GÜLMEZ, BURAK
İLİMAN VERECEKTİR.

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.

Soner Gülmez
Sorumlu
(Klima)

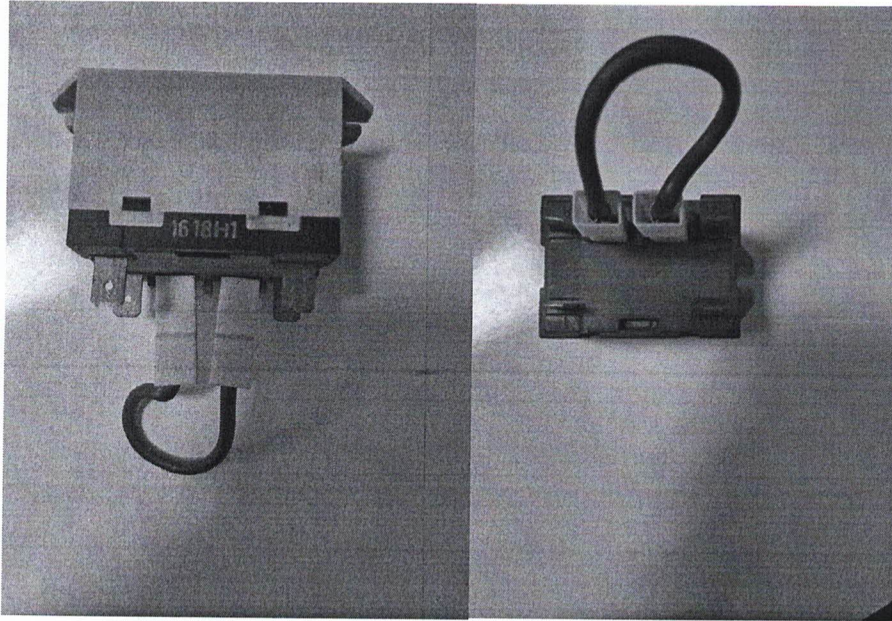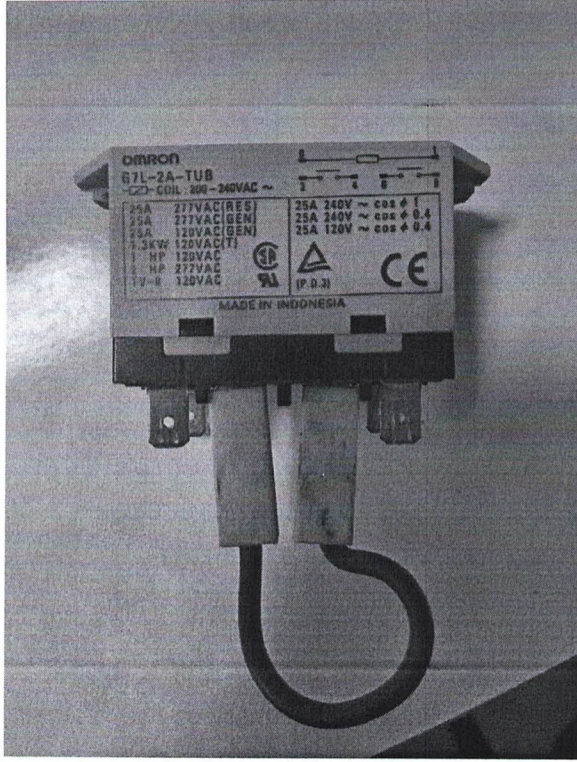

KAN TRANFİZYON MERKEZİ KLİMASI İÇİN KONTAKTÖR ALIMI(1ADET)

VESTEL 24000 BTU SPLIT KLİMAYA UYGUN OLMALI.ORJİNAL MALZEME OLMALI.

MALZEME UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM SONER GÜLMEZ,BURAK İLİMAN VERECEKTİR.

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SAKIN
Teknik Servis Sor.

Soner Gülmez
Sorumlu İSCI
[Signature]