



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 3 KALEM HASTANE VE BÜRO MEFRUŞATI ALIMI

24.03.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise 28/03/2023 saat 12:00'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 28/03/2023 tarihinde saat 12:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	HASTANE TELEFON NO 0 242 746 11 17 DAHİLİ NO : 1510
--	---

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	PANSUMAN ARABASI	4	ADET				
2	AHŞAP SOYUNMA DOLABI	3	ADET				
3	PARAVAN	4	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

PANSUMAN ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- . Paslanmaz çelikten olmalıdır.
- . Dört çekmeceli olmalıdır.
- . Dört tekerlekli olmalıdır.
- . Tekerlek çapı 75 mm olmalıdır.
- . Çöp kovası özellikli olmalıdır.
- . Çekmecelerin iç ölçüleri 397*435*95 mm olmalıdır.
- . Derinlik 585 mm , yükseklik 987 mm , genişlik 812 mm olmalıdır.
- . En az iki yıl garantisi olmalıdır.



Manavgat Devlet Hastanesi
Seher AKTEMUR
T.K.K.



Manavgat Devlet Hastanesi
Sener AKTEMUR
T.K.K.

SOYUNMA DOLABI SAĞINAME

1. ÜST TABLA, 18 mm Yonga Levha Üzeri MELAMİN Kaplı,
Kenarlar 22 x 1 mm PVC, 22 x 2 mm PVC
2. ARKALIK 18 mm Yonga Lev Üzeri MELAMİN Kaplı
3. YAN TABLALAR, 18 mm Yonga Levha Üzeri MELAMİN Kaplı
Kenarlar 22 x 1 mm PVC
4. RAFLAR, Yong Lev Üzeri MELAMİN Kaplı 22 x 1 mm PVC
5. ASKILIK BORUSU, Ø25 mm KROM KAYLI
6. ALT TABLA 18 mm Yonga Levha Üzeri MELAMİN Kaplı
Kenarlar 22 x 1 mm PVC
7. KAPAKLAR, 18 mm Yonga Levha Üzeri MELAMİN Kaplı,
Kenarlar 22 x 2 mm PVC
8. DOLAP İÇİ AYNA 310 x 210 x 4 mm KODAJLI
9. METAL AYAK h: 50 mm
10. 95 mm MERKEZLİ KULP

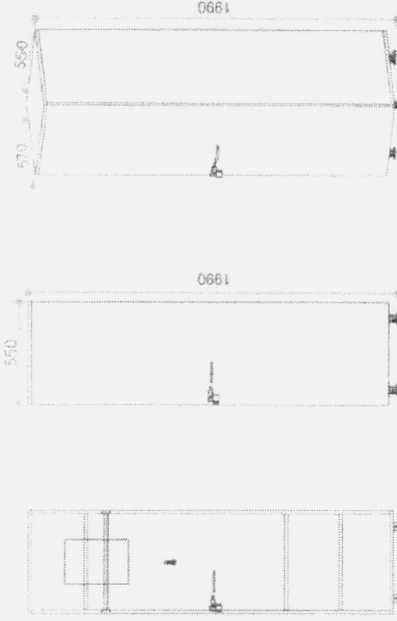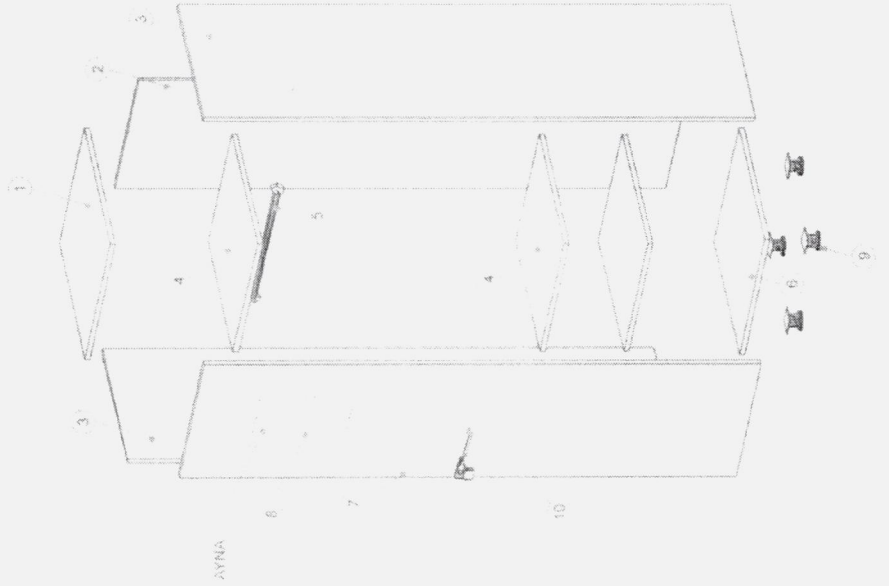

PARAVAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- . 2 kanatlı olmalıdır.
- . Kanatları katlanabilir olmalıdır.
- . Kanatlar 360 derece dönebilen tekerlek ile hareket edebilir özellikte olmalıdır.
- .Yıkanabilir kumaştan olmalıdır.
- .Gövde metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- .Ölçüleri yaklaşık: En: 50 cm – Boy: 150 cm – Yükseklik: 175 cm olmalıdır.
- .En az iki yıl garantisi olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Şener AKTEMUR
T.K.Y.