

SAYI: 98177073 / 934.01

KONU: HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN 34 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ

08/09/2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d
Firmanız tarafından temini mümkün ise 13.09.2021 saat 10:00 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştırılanların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka

m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

BİRİM BEDEL

13.09.2021 tarihinde saat ## a kadar 0242 746 45 00 nolu faks ,

10:00

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTANEMİZ KROMLUX MARKA ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İÇİN 10 KW FİLKETE REZİDANS ALIMI	4	ADET				
2	MENDA MEDEL VNT 34-45/1432PROT TERM.CL.B MODEL SOĞUK HAVA DEPOSUNA İÇ ÜNİTE FAN ALIMI	5	ADET				
3	(YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK)HASTANEMİZ A BLOK İÇİN YANGINA DAYANIKLI KAPI ALIMI	7	ADET				
4	(YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK) HATANEMİZ A BLOK POLİKNİLİKLER ARKA GİRİŞİ ALÜMİNYUM KAPI YERİNE (160*210) ÖLÇÜLERİNDE FOTOSELLİ KAPI YAPIMI (DEMONTAJ-MONTAJ-İŞÇİLİK-MALZEME DAHİL)	1	ADET				
5	TIBBİ MONİTÖR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	5	ADET				
6	HASTANEMİZ ACİL RÖNTGEN ODASI HAVALANDIRMASINDA KULLANDIRILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE 150*100 GALVANİZ REDİKSİYON ALIMI	1	ADET				
7	70*100 GALVANİZ REDİKSİYON ALIMI	1	ADET				
8	(YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK) HASTANEMİZ YOĞUN BAKIM FOTOSELLİ KAPILARI İÇİN ALT KLAVUZ ALIMI	8	ADET				
9	YOĞUN BAKIM FOTOSELLİ KAPILARI İÇİN ALT ETEK ALIMI	6	ADET				
10	HASTANEMİZ İÇİNDEKİ LİTECH MARKA FOTOSELLİ KAPILAR İÇİN ALT KLAVUZ ALIMI	6	ADET				
11	HASTANEMİZ FOTOSELLİ KAPILARINDA KULLANILMAK ÜZERE EMNİYET FOTOSELLİ ALIMI	3	ADET				
12	15 LT'LİK (BEYAZ DEMİR YAĞLI BOYASI ALIMI	1	ADET				
13	15 LT'LİK (GRİ) DEMİR YAĞLI BOYASI ALIMI	1	ADET				
14	10 LT'LİK TİNER ALIMI	1	ADET				
15	4 BARLIK REGÜLATÖR ALIMI (OR-MİDİ P1 MAX/230/PSİ/1,6 MPA P2 MAX:12 BAR/175 PSİ/1,2 MPA)	1	ADET				
16	1/2 VANA ALIMI	1	ADET				
17	1/2 OYNAR REKOR ALIMI	4	ADET				
18	22MM BAKIR BORU	4	METRE				
19	22'LİK BAKIR T	4	ADET				

20	22'LİK BAKIR DİRSEK	4	ADET				
21	(YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK)HASTANEMİZ AMELİYATHANE ASANSÖRÜ İÇİN ALT PATEN BLOKLARI ALIM	2	TAKIM				
22	SEDYE(COVİT) ASANSÖRÜ İÇİN KAPI ALT PATANI TAKIMI	8	ADET				
23	KAPI HALATI ALIM	1	ADET				
24	KAPI MAKARASI ALIM	4	ADET				
25	TEKLİ ASANSÖR İÇİN ANA KONTAKTÖR ALIM	5	ADET				
26	YARDIMCI KONTAKTÖR ALIM	5	ADET				
27	KAPI MAKARASI ALIM	4	ADET				
28	PVC KAPI 210*116	1	ADET				
29	PNÖMATİK PRİNÇ REKOR	50	ADET				
30	PNÖMATİK REKOR	35	ADET				
31	PNÖMATİK(KONNEKTÖR)	20	ADET				
32	TIBBİ GAZ NAKİL HORTUMU	50	METRE				
33	BASINÇ SENSÖRÜ	6	ADET				
34	VAKUM SENSÖRÜ	4	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA


TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com



E. PNÖMATİK PİRİNÇ REKOR TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün tamamen pirinç malzemden imal olmalı, kaynak yapılabilir özellikte ve sarı renkte olmalıdır
3. Ürün 8 mm bakır boruya kaynak yapılabilmesi için uygun çıkışı olmalı, diğer taraf ise 8 mm pnömatik hortum için uygun bağlantı çıkışı ve aparatları yer almalıdır
4. Ürünlere ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

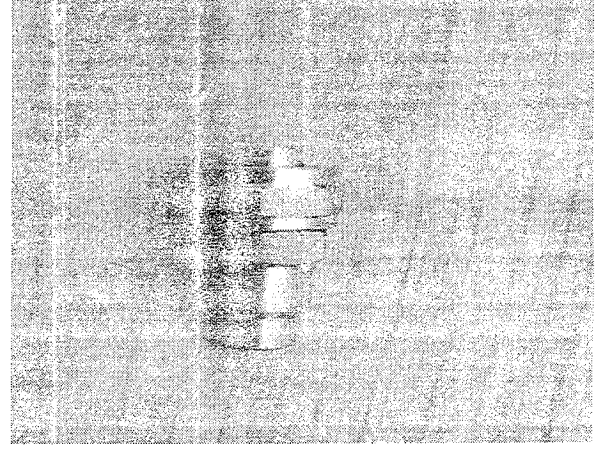

F. PNÖMATİK REKOR TEKNİK ŞARTNAMESİ (35 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün tamamen pirinç malzemden imal olmalıdır
3. Ürün ¼ dış dişli ve contalı olmalı diğer yön ise plastik, yaylı ve 4 mm pnömatik giriş için uygun yapıda olmalıdır
4. Üründe ayrıca montaj için altıgen kısım bulunmalı kolay sıkılabilir yapıda olmalıdır
5. Ürünlere ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

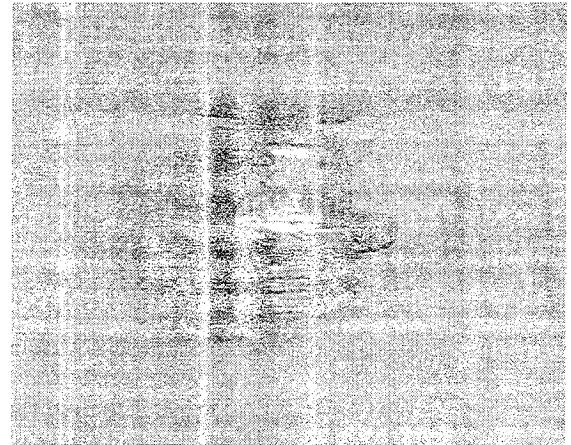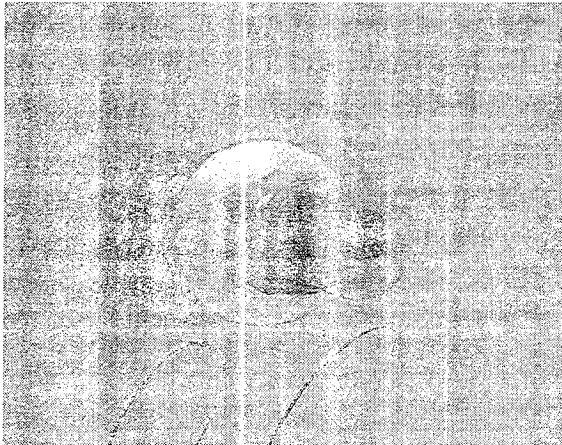

Manavgat Devlet Konağı
Adnan ERDOĞAN
Biyomedikal/Elektronik
Elektronik Müh.

G. PNÖMATİK Y (KONNEKTÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ (20 ADET)

1. Ürün TSE ve CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün bir tarafı tek diğer tarafı ise çift çıkışlı olmalıdır
3. Plastik malzemeden imal, siyah-mavi renkli olmalıdır
4. Tüm girişler 8 mm pnömatik hortum için uygun yapıda olmalıdır
5. Girişler yaylı ve sızdırmaz özellikte olmalıdır
6. Ürünlere ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.



H. PNÖMATİK HORTUM TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 METRE)

1. Ürün TSE ve CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Hortum 8mm çapında olmalı ve mavi renkte olmalıdır
3. Çalışma basıncı için min 8, test basıncı min 16 bar olmalıdır
4. Suya, yağa, kimyasallara ve bakterilere karşı yüksek dirençli olmalı, ROHS çevre koruma direktifine uygun yapıda olmalıdır
5. Ürün düz yapıda ve tek parça halinde olmalıdır

I. DİJİTAL ALARM PANELİ 2 Lİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 ADET)

1. Panel TSE veya CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Panel oksijen ve vakum değerlerini dijital olarak göstermeli, belirlenen sınırların dışında olması durumunda sesli ve görsel alarm vermelidir
3. Olası alarm durumunda istenildiği takdirde alarmları susturabilecek tuşlara sahip olmalıdır
4. Ürün dijital ekranlı olmalı ve istenilen değer aralıklarını ayarlayabilecek yapıda olmalıdır
5. Ürün tesisadaki basınç değerlerini 24 saat kesintisiz gösterebilecek yapıda olmalıdır
6. Ürüne ait katalog/numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

M. Nevzat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal Elektronik
Müh. Müh.

J. DİJİTAL ALARM PANELİ 3 LÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 ADET)

1. Panel TSE veya CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Panel oksijen, vakum ve basınçlı hava değerlerini dijital olarak göstermeli, belirlenen sınırların dışında olması durumunda sesli ve görsel alarm vermelidir
3. Olası alarm durumunda istenildiği takdirde alarmları susturabilecek tuşlara sahip olmalıdır
4. Ürün dijital ekranlı olmalı ve istenilen değer aralıklarını ayarlayabilecek yapıda olmalıdır
5. Ürün tesisatıdaki basınç değerlerini 24 saat kesintisiz gösterebilecek yapıda olmalıdır
6. Ürüne ait katalog/numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

K. BASINÇ SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ (6 ADET)

1. Ürün TSE veya CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Medikal gaz tesisatında bulunan oksijen ve basınçlı hava hattında kullanıma uygun olmalıdır
3. Ürün yüksek hassasiyette ölçüm yapabilme kabiliyetine ve kalibrasyonuna sahip olmalıdır
4. En az 0-16 bar aralığında çalışmaya uygun olmalıdır
5. 0/60 derece aralığında çalışmaya uygun yapıda olmalıdır
6. Veri akışında yukarıda yer alan alarm paneline uygun mA değerlerine sahip olmalı, dijital alarm paneline uyum sağlamadığı takdirde uygunluk verilmeyecektir.
7. Ürüne ait katalog/numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

L. VAKUM SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ (4 ADET)

1. Ürün TSE veya CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Medikal gaz tesisatında bulunan vakum hattında kullanıma uygun olmalıdır
3. Ürün yüksek hassasiyette ölçüm yapabilme kabiliyetine ve kalibrasyonuna sahip olmalıdır
4. En az 0/-600 mmhg aralığında çalışmaya uygun olmalıdır
5. 0/60 derece aralığında çalışmaya uygun yapıda olmalıdır
6. Veri akışında yukarıda yer alan alarm paneline uygun mA değerlerine sahip olmalı, dijital alarm paneline uyum sağlamadığı takdirde uygunluk verilmeyecektir.
7. Ürüne ait katalog/numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
OTOMATİK PANİK AÇILIR FOTOSELLİ KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

KONU: Hastanemiz A Blok Poliklinikler Arka Giriş kapısına kart okuyuculu güvenli şekilde seri çalışabilen çift panelli ve panelleri elle açmaması için özel kilit sistemi (Elektronik kilitli) olan otomatik kapı yapım işini kapsamaktadır.

- 1.Fiyat verecek olan firmalar öncelikle yerinde keşfi yaparak net ölçü alması zorunlu olup keşfe gelmeyenlerin teklifleri kabul edilmeyecektir.
- 3.Kapılar elle açılması mekanizma ile önlenmesi arıza durumunda kapı mekanizmaları sökmeden basit usülle açma özelliği olmalı.
4. Her iki tarafta da el sensörü olacaktır..
5. Alüminyum kapı olan yerlere yapılacağından kasalar çita v.b. malzeme ile düzlenecek.
6. Kapı paneller 2mm kalınlığında kanatları oluşturan profil sisteminde kapı kapalı durumda olduğu zaman sızdırmazlığı sağlayacak detaylar bulunacak hareketli kapı kanatları altı fırçalı, mevcut kapı rengine uyumlu olacak.
- 7.Kapı kanatlar elle açma uğraşıldığında alüminyum profil çerçeve bükülmemesi için kalın malzemeden yapılmalı aksi halde kabul edilmeyecek.
8. Panellerin camları ŞEFFAF LAMİNELİ CAM olacak ve ortasına kırmızı kuşak yapıştırılacak.

MEKANİZMA VE MOTOR GRUBU:

1. Kapıların hareketini sağlayan kayış sistemi, tek motor ile çalışmalıdır. Motorların garantisi 5 yıl olacaktır.
2. Motor 24-12 volt çalışmaya uygun(Dunker motor) olmalıdır. Kapının sessiz çalışması için motorların üzerinde redüktör olmamalıdır.
3. Mekanizmanın çalışma gerilimi 230 V. (A.C.), 50 Hz. olmalı ve voltaj değişmelerine karşı en az % 10 tolerans göstermelidir.
4. Mekanizma -20 oC ile 65 oC ortam sıcaklığında çalışmaya uygun olmalıdır.
5. Mekanizmanın enerjisi 150 W olmalıdır. Kanat kapanma gücü 150 N olmalıdır. Mekanizmanın en az 1.000.000 kez açılım ve kapanım yaptığına dair sertifikası olmalıdır.
6. Kapıların kapalı ve elektronik kilitli kalması dijital selektör vasıtasıyla sağlanarak, kapalı (Devre Dışı), otomatik (bütün sistem devrede) , açık (kapı açık durumda), tek yönlü (hareket ünitesi tek yönlü devrede), gece (dışarıdan kilitli, içeriden düğme ile açılabilir durumda) fonksiyonlarını içermelidir.
7. Mikroprosesör ünitesi arızası , radar ve fotosel arızası kayış gevşeme ve kopma hali ile aşırı yük ve kanatların açılırken ve kapanırken herhangi bir engelle karşılaşması halinde mekanizma üzerinde bulunan dijital selektör göstergesi ile arızayı ve yerini belirtecektir. Mekanizma devreye girdiğinden otomatik olarak açma kapama mesafelerini tayin edecektir.
8. Kapı açık kalma süresi, kanat açılma ve kapanma hızı dijital selektör vasıtasıyla ayarlanabilir olmalıdır. Ayarlanan açık kalma süresi 0-30 sn. arasında olmalıdır.
9. Mekanizmalarda ayarlanabilinir minimum beş değişik açılım aralığı olmalı ve giriş trafik sıklığına göre istenen aralık seçilebilmelidir.
10. Çift kanat kapılarda kapının açılma hızı 1400 mm/sn, tek kanat kapılarda 700 mm/sn olmalıdır.
11. Güvenlik amacı ile kapıların açılma hızı kapanma hızına göre daha hızlı olmalıdır.

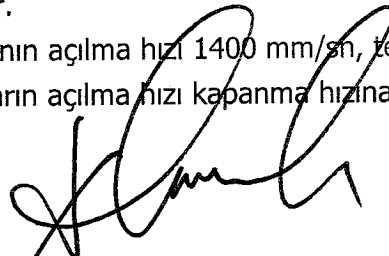

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
TIBBİ MONİTÖR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TMS marka FX1 model hastabaşı monitör cihazına (dışarıdan takılabilir) uyumlu olmalıdır.
2. Yeni üretim tarihli olmalıdır.
3. Lithium polymer, 14.8 V, 2200 mAh olmalıdır.
4. En az bir yıl garantili olmalıdır.
5. Alım yapılan malzemenin numune üzerinden (talebi yapan birim-muayene komisyonu tarafından) denemesi yapılarak uygunluk verilecektir. Hastanemiz bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir
6. Malzemenin ve faturanın teslim yeri Biyomedikal depodur.
Telefon: 0.242.746 11 17, dahili – 1511. e-posta: klinikmuhendislikmanavgat@gmail.com
7. Teklifler ile birlikte Satış yeri yeterlilik belgesi ve TİTUBB/ÜTS kayıtları; Malzemenin üretici, marka, model bilgileri yazılı olarak verilmelidir.
8. Fatura içeriğinde ürün isimleri yapılan talep ile birebir aynı olacaktır.
9. UBB'ye tabi ürünlerin barkod numarası faturada yazılacaktır.

Ümmü ZEYBEKOĞLU
Yoğun Bakım Şefi

