



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

7692

KONU : 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

20.08.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **25.08.2025** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **25.08.2025** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TEKNİK SERVİS
	DAHİLİ : 1407 - 1406

E. Batuhan ŞEN
İdari ve Mali İşler Müdür V.

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	HAT FİLTRESİ (MESSA MDI 150 CİHAZ UYUMLU)	1	ADET			
2	EKSOZ FİLTRESİ (MESSA MD 150 CİHAZ UYUMLU)	2	ADET			
3	SELENOİD VALF (MESSA MD 150 CİHAZ UYUMLU)	2	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışındaki kaşe imza ve diğer teklifler değerlendirilmez.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağı: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com

MESSA MARKA MD.150 MODEL KİMYASAL KURUTUCU İÇİN MALZEME TALEBİ ŞARTNAME

1. Servis formuna istinaden MESSA marka MD 150 model 2312799 seri numaralı kimyasal kurutucuya uyumlu;
 - Hat filtresi(1adet)
 - Eksoz filtresi(2adet)
 - Selenoid valf (2adet)


Malzeme uygunluk onayını teknik birim verecek olup, malzemeler yukarıda marka modeli belirtilen cihaza birebir uyumlu olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Samet SATIN
Teknik Servis Sor.




Muzaffer ÇINAR
Elektrik Teknisyeni




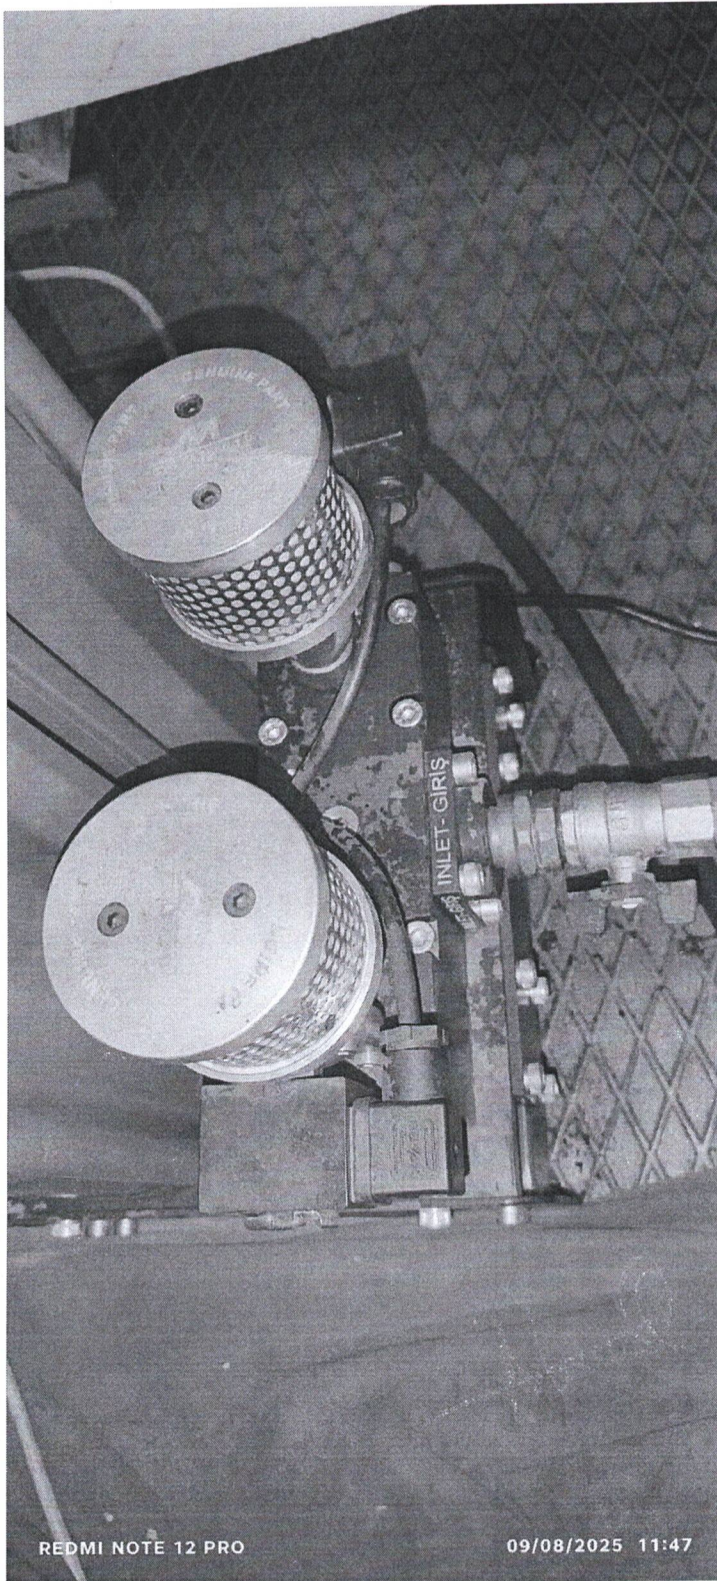

REDMI NOTE 12 PRO

09/08/2025 11:47

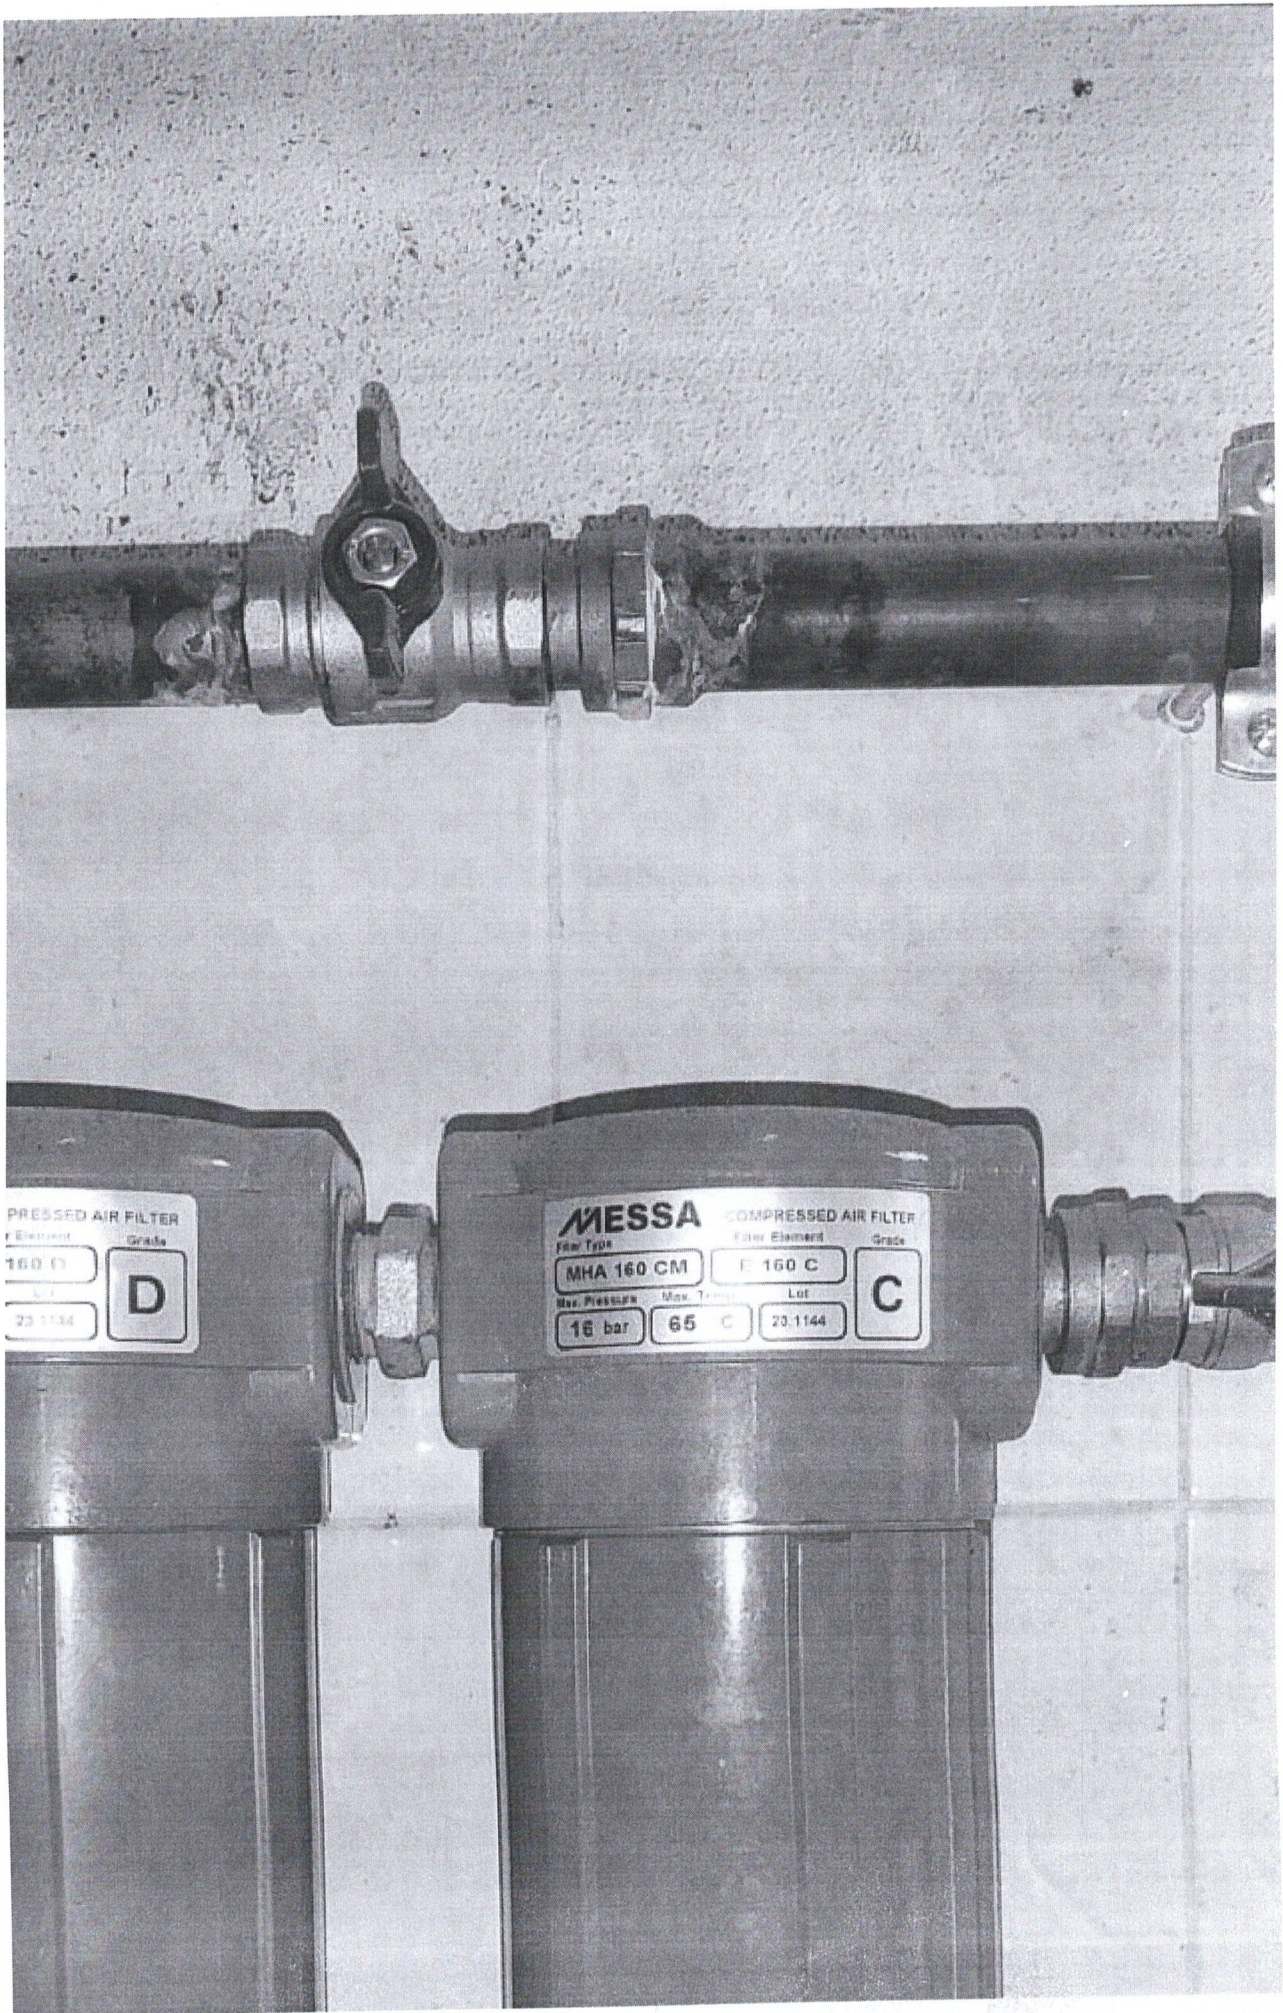

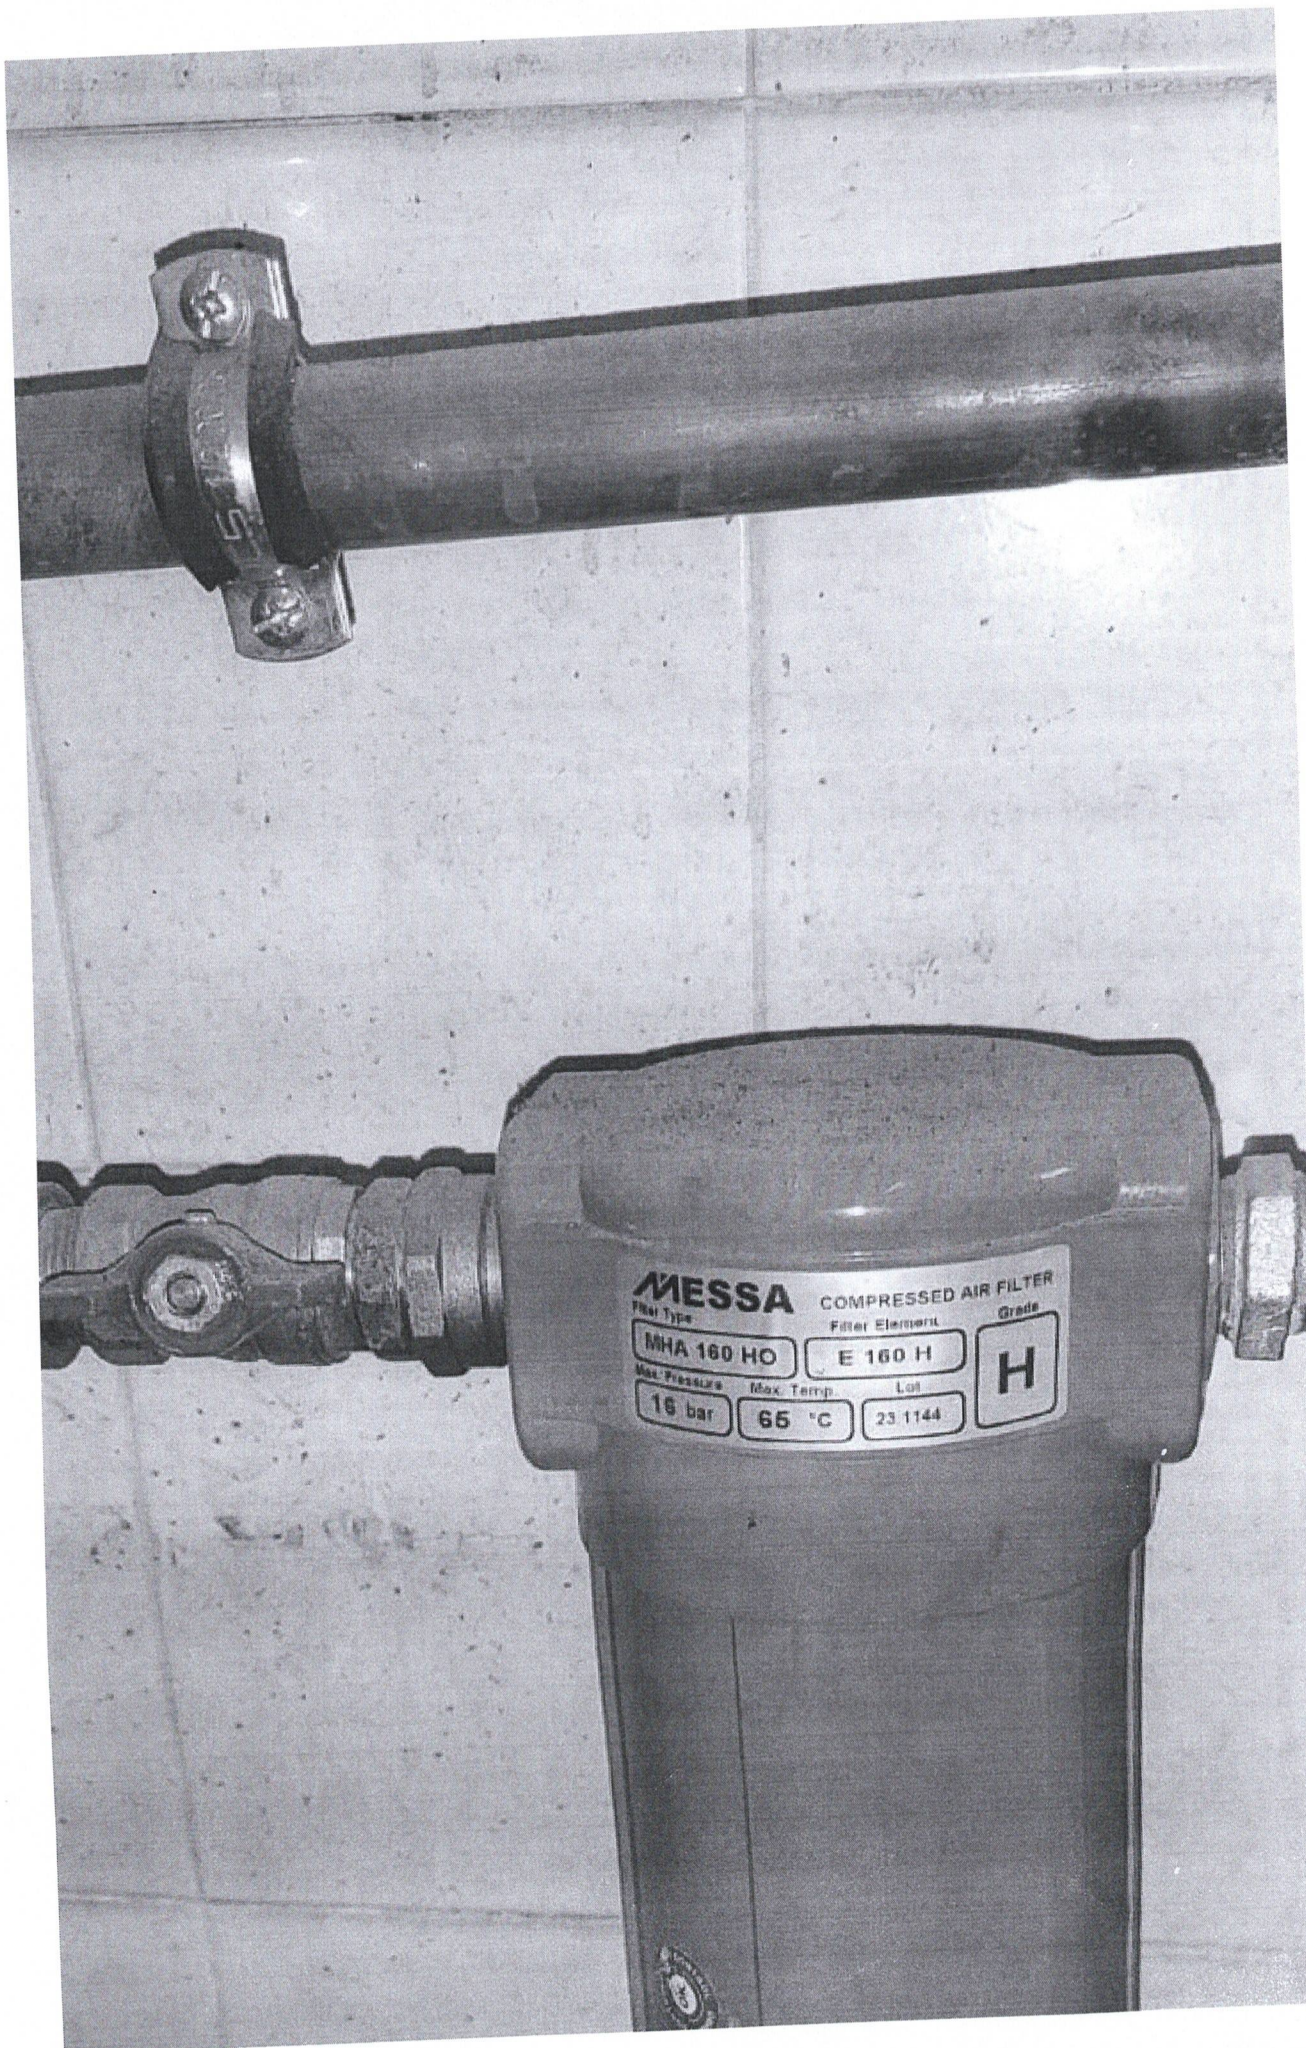

MESSA COMPRESSED AIR FILTER

Filter Type	Filter Element	Grade
MHA 160 HO	E 160 H	H
Max. Pressure	Max. Temp.	Lot
16 bar	65 °C	23 1144

MESSA

MADE IN TURKEY

CE

Model

MD 150

Serial Nr.

2312799

Voltage/ Frequency/ Power

220 VAC/50Hz/60W

Max. Working Pressure

12 bar

Max. Working Temp.

50 °C

Year

2023

**UYARI
CAUTION**

Kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.


Read and understand operator's
manual before using this unit.

**Basınçlı Hava**

Servis işleminden önce basınçlı
havayı boşaltınız.

Compressed Air

Release air pressure before
servicing.


**Elektrik Çarpma
Riski**


Servis işleminden önce elektrik
enerjisini kesiniz.
Sadece yetkili personel müdahale
edebilir.

Electrical Hazard

Turn off power before servicing.
Authorized personel only.

BAKIM VE KONTROL

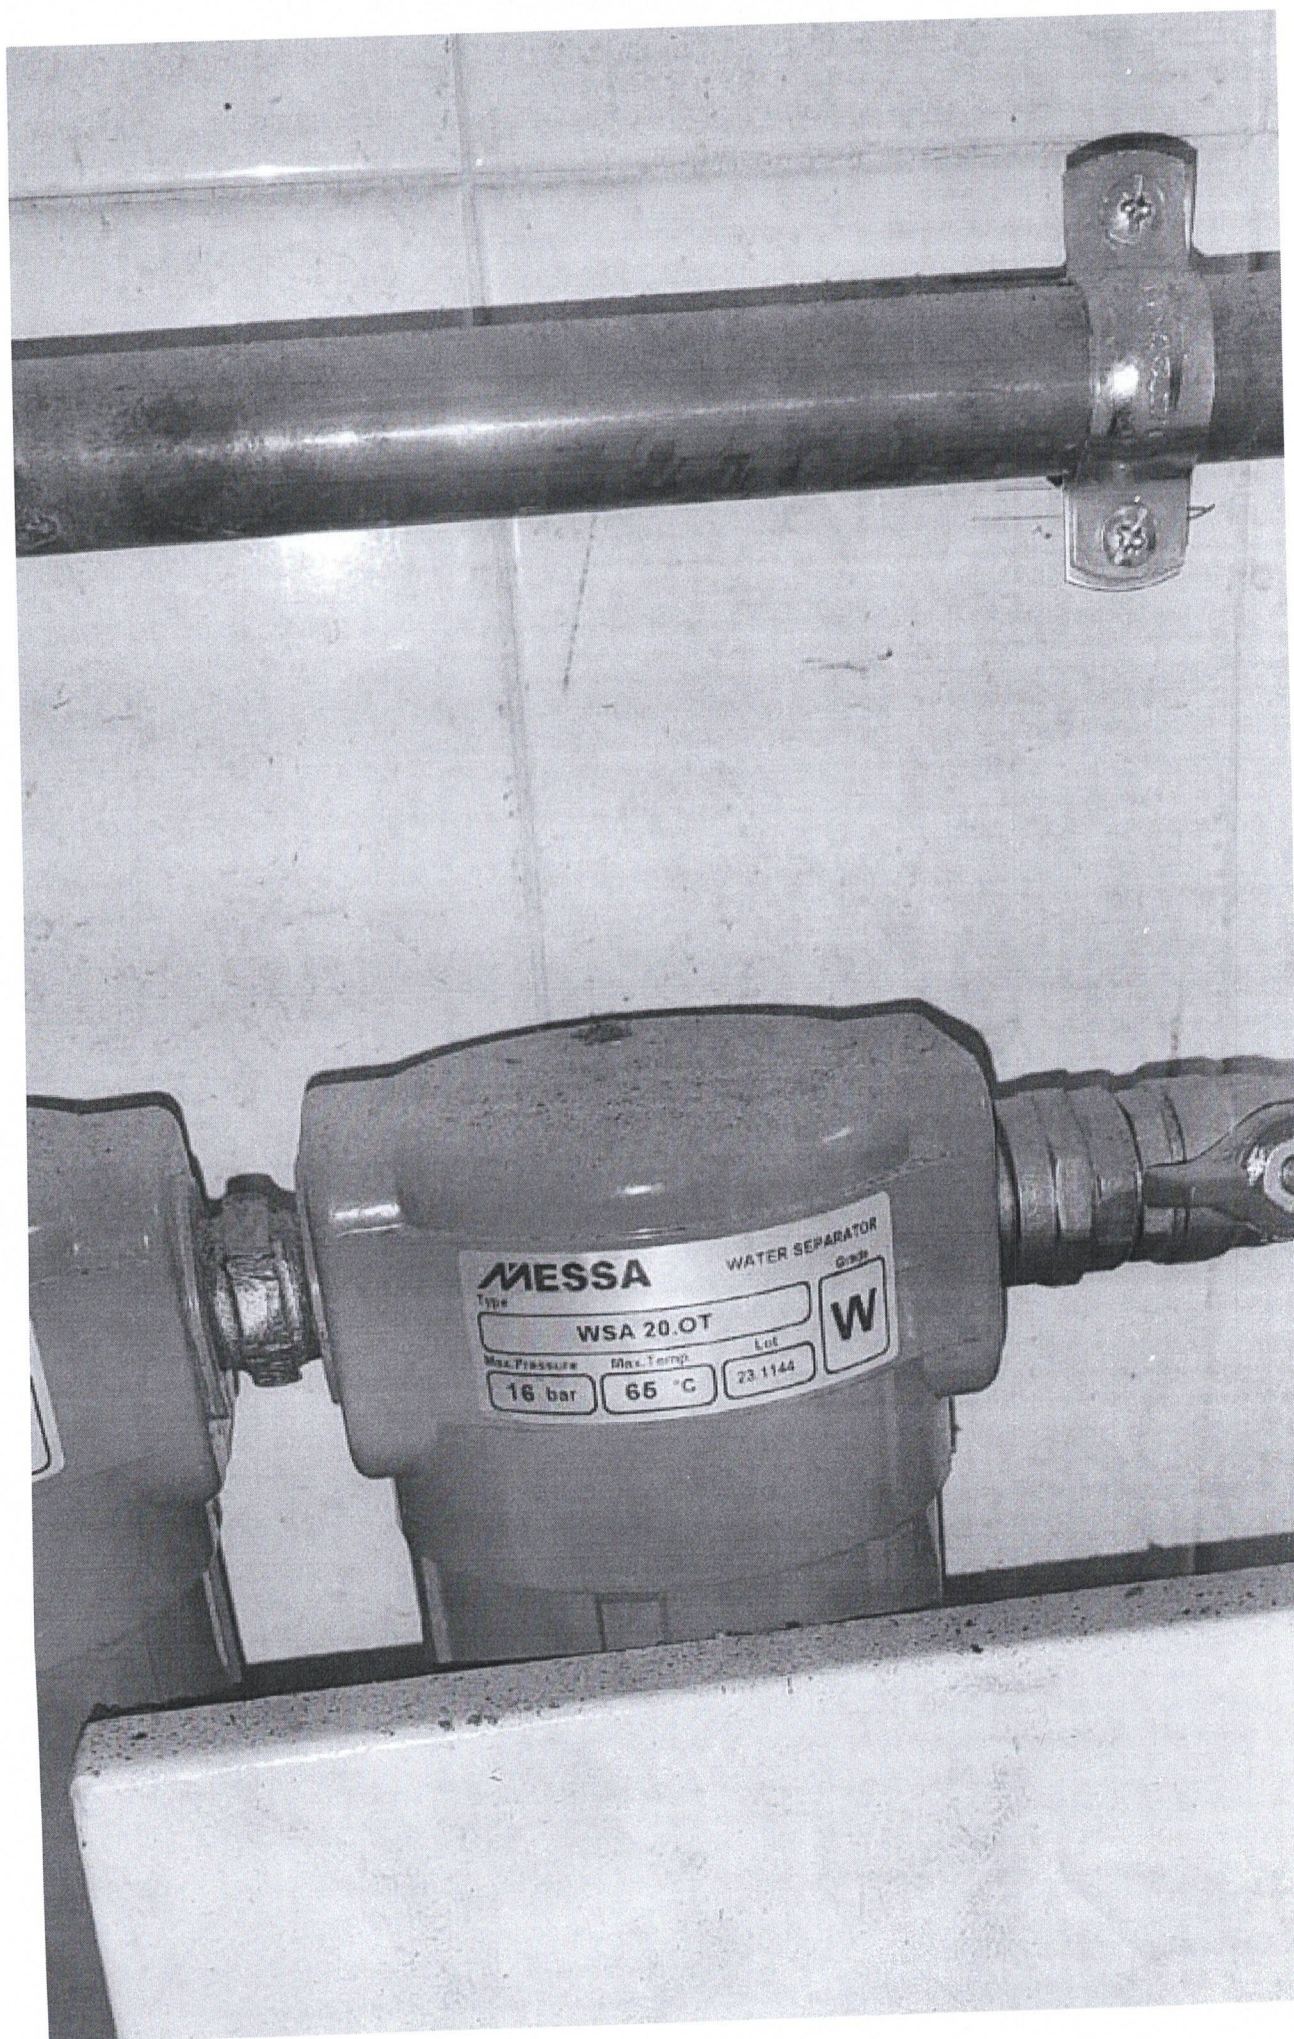

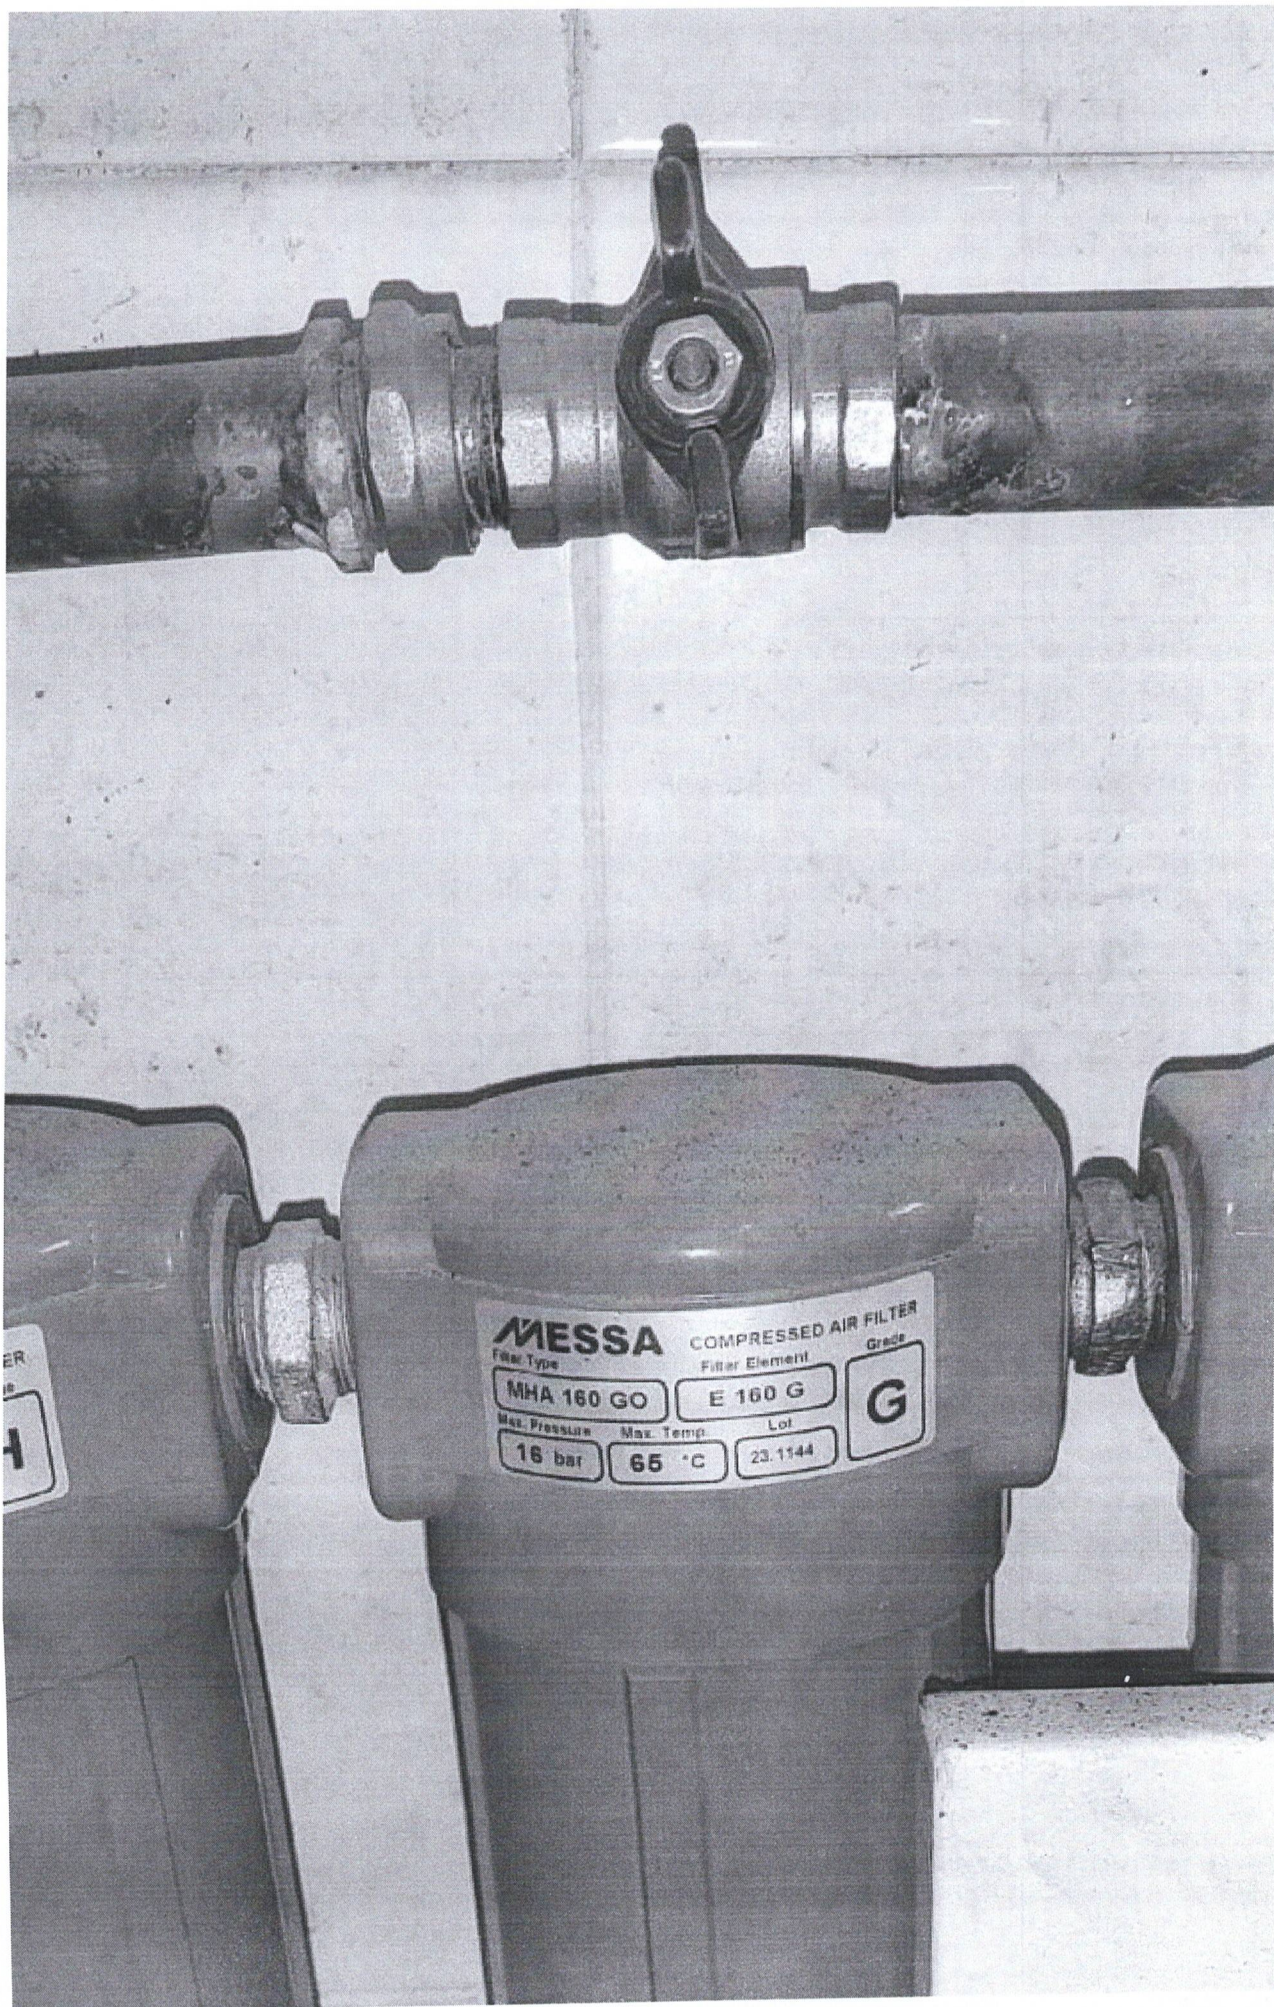



Selend volf

