



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 6 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

14/04/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **18/04/2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **18/04/2023** tarihinde saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNİYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TRAFO KORUMA FANİ ALIM	2	ADET				
2	AKÜ REDRESÖR CİHAZI	1	ADET				
3	AKSİYEL FAN	2	ADET				
4	GADA (110/90 MM UYGUN)	10	ADET				
5	GADA (50 MM)	10	ADET				
6	ÇEKMECE RAYI ALIM (1 ADETİ 2 Lİ SET ŞEKLİNDE TAKIM HALİNDE OLMALIDIR.)	5	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalysm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemlerin teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.
KAŞE - İMZA

A. TRAFO KORUMA FANI TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 ADET)

1. Ürün hastanede kurulu 700 Kva kuru tip trafoda bulunan ARES marka 82-370 model ile aynı ölçülerde ve özellikte olmalıdır
2. Ürün ISO 1940-1'e göre G6.3 sınıfında yer almalı, vibrasyonsuz tasarıma sahip olmalı ve 2620 rpm kanat hızına sahip olmalıdır
3. Ürün -25°C ~+60°C. ortam sıcaklığında çalışmaya uygun yapıda olmalıdır
4. H sınıfı motor sargı izolasyonuna sahip 230V/50 Hz çalışmaya uygun tek fazlı sargı yapısına sahip olmalıdır
5. Ürün üzerinde klemens kutusu bulunmalıdır
6. Ürün üzerinde dahili 140°C sınırlı termik ile yüksek sıcaklık koruması bulunmalıdır
7. Ürün üzerinde motor koruma menfezi bulunmalı bu sayede olası temasta koruma sağlamalıdır

B. AKÜ REDRESÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 ADET)

1. Ürün IEC 61204-7:2006 61204-3:2011 EMC ve 60146-1-1:2009 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Mikrodenetleyici bazlı thyristör kontrollü olmalıdır
3. Soft start özellikli ve DC çıkışta elektronik kısa devre koruması bulunmalıdır
4. VRLA tipi en az 5 yıl ömür beklentili en az 40 amper aküler bulunmalıdır
5. Kontrol ünitesi üzerinden çıkış gerilimi ve akımı ayarlanabilmelidir
6. Gerilim çıkışı ve akım çıkışı kontrol ünitesi üzerinden izlenebilmelidir
7. 220 V_{AC} (±%20), 47.5 - 62.5 Hz arası giriş voltaj ve herzinde çalışmaya uygun olmalıdır
8. Giriş akımı max 1.5 A olmalıdır
9. Güç faktörü min 0.63 olmalıdır
10. Çıkış gerilimi 20 – 30 volt DC olmalı 0.1 V adımlarla ayarlanabilir olmalı nominalde 27.6 V dc ayarlı olmalıdır
11. Çıkış gerilim ripple %5 ten küçük olmalıdır
12. Çıkış akımı sürekli 1-5A aralığında ve 0.1 A adımlarla ayarlanabilir olmalıdır
13. Çıkış akımı kısa süreli olarak 15 A sağlayabilmelidir
14. Çıkış gücü sürekli olarak min 140W sağlayabilmelidir
15. Çıkış tarafında L-C filtre bulunmalıdır
16. Ürün verimi en az %70 olmalıdır
17. -25 +55 derece arasında çalışmaya uygun olmalıdır
18. Duvara monte edilebilir yapıda olmalıdır
19. İhbar kontak çıkışı 1 adet NO kuru kontak bulunmalıdır
20. Ürüne ait katalog teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

C. AKSİYEL FAN TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 ADET)

1. Fan atmosferik polimer dayanıklı çelik kaplama kasa ve pervanelere sahip olmalıdır
2. Motor ve fan pervanesi ana gövdeye çelik taşıyıcılarla bağlı olmalıdır
3. Hava giriş tarafı koruyucu tel kafesli olmalıdır
4. Ürün çapı en az 450 mm olmalıdır
5. Ürün motor devri en az 1500 d/d olmalıdır n

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

6. Ürün hava debisi en az 2000 m3/saat olmalıdır
7. Delikli kare montaj plakası ve duvar montajını kolaylaştırmak için bir yuvarlak flanşlı olmalıdır
8. Fan 220V AC ve 50 Hz şebeke elektriğinde çalışmalı ve güç şebekesine bağlantı için bir terminal klemens bulunmalıdır
9. Üzerinde bulunan harici motor rulman motor olmalıdır
10. Otomatik yeniden başlatma Entegre termal korumaya sahip olmalıdır
11. Ürün koruma sınıfı en az Ip 24 olmalıdır
12. Ürüne ait görsel veya katalog teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

A. KADA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün çapı 110/90 mm pis su boruları uygun olmalıdır
3. Ürün rengi siyah olmalıdır
4. Ürün uzunluğu 30 cm olmalıdır
5. Ürün klozet girişi kauçuk contalı olmalıdır
6. Ürüne ait görsel aşağıda olup isteklinin sunacağı numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

B. KADA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün çapı 50 mm olmalı ve gömme rezervuar klozet arası bağlantıya uygun olmalıdır
3. Ürün rengi siyah veya beyaz olmalıdır
4. Ürün uzunluğu 30 cm olmalıdır
5. Ürün klozet girişi kauçuk contalı olmalıdır
6. Ürüne ait görsel aşağıda olup isteklinin sunacağı numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir




Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmüş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

ÇEKMECE RAYI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün 450 mm uzunluğunda olmalıdır
3. Ürün rengi beyaz olmalı ve 2 li set halinde olmalıdır
4. Ürünler montaj için farklı aralıklarla delikli yapıda olmalıdır
5. Ürünlerin her birinde rulmanlı beyaz pvc malzemedan imal teker bulunmalıdır
6. Ürüne ait görsel aşağıdaki gibi olup ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

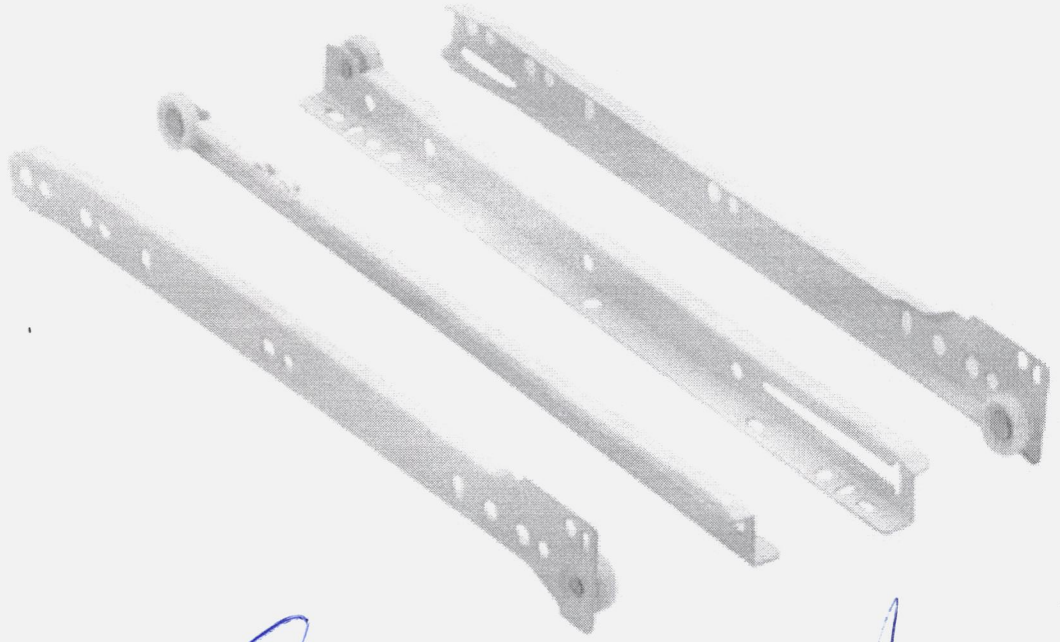

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmüş KURT
Teknik Birim Sorumlusu